




8315
K=0.01 cm⁻¹

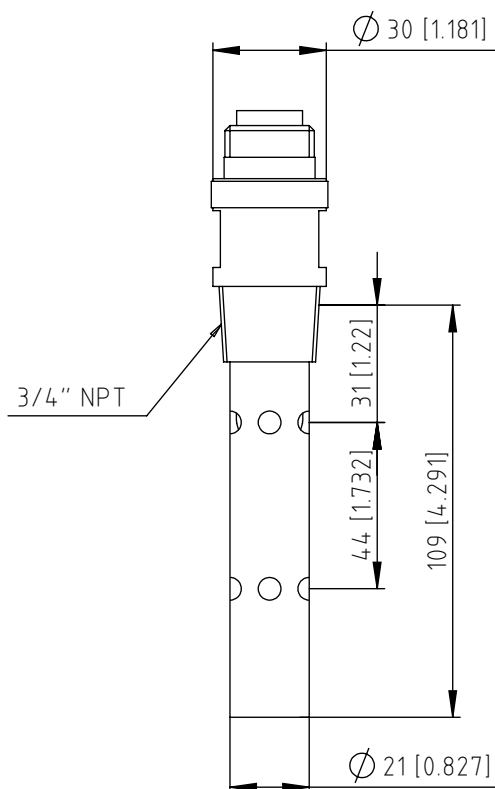

8316
K=0.1 cm⁻¹

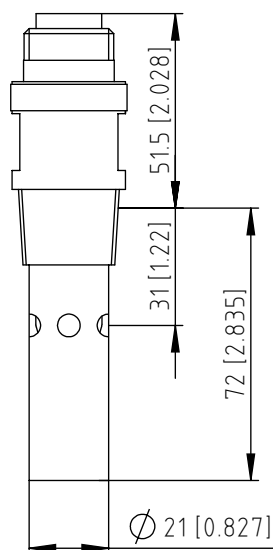

8317
K=1 cm⁻¹

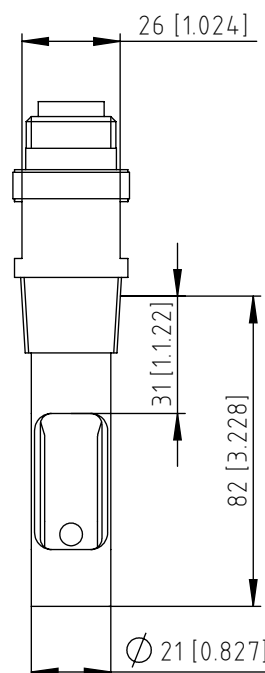


316L STAINLESS STEEL PROBES

T Max: 150°C (302°F) / P Max: 25 bar (362 psi)

All dimensions are in mm[inches].

Cotes sans tolérance/Tolerance scale				Remarques/Notes:			
...	> 100	> 300	> 600				
< 100	...300	...600	...1000				
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 1.0				
Echelle Scale 1:2		Installation drawing (Conductivity probes 8315/16/17)			Création du document/Document creation		
					01.01.1999		S.F.
					Fichier/File: 8001318.SLDDRW		
		Code d'entrée Entry code	Immatriculation Registration	Code matière Material code	Modification	Validation	Revision
		V	8001318	00	B	Date: 04.07.2013	a
						Visa: S. Fouassier	
Tout emploi illicite de ce document sera poursuivi par voie judiciaire				Unauthorized use of this document may result in legal proceedings			

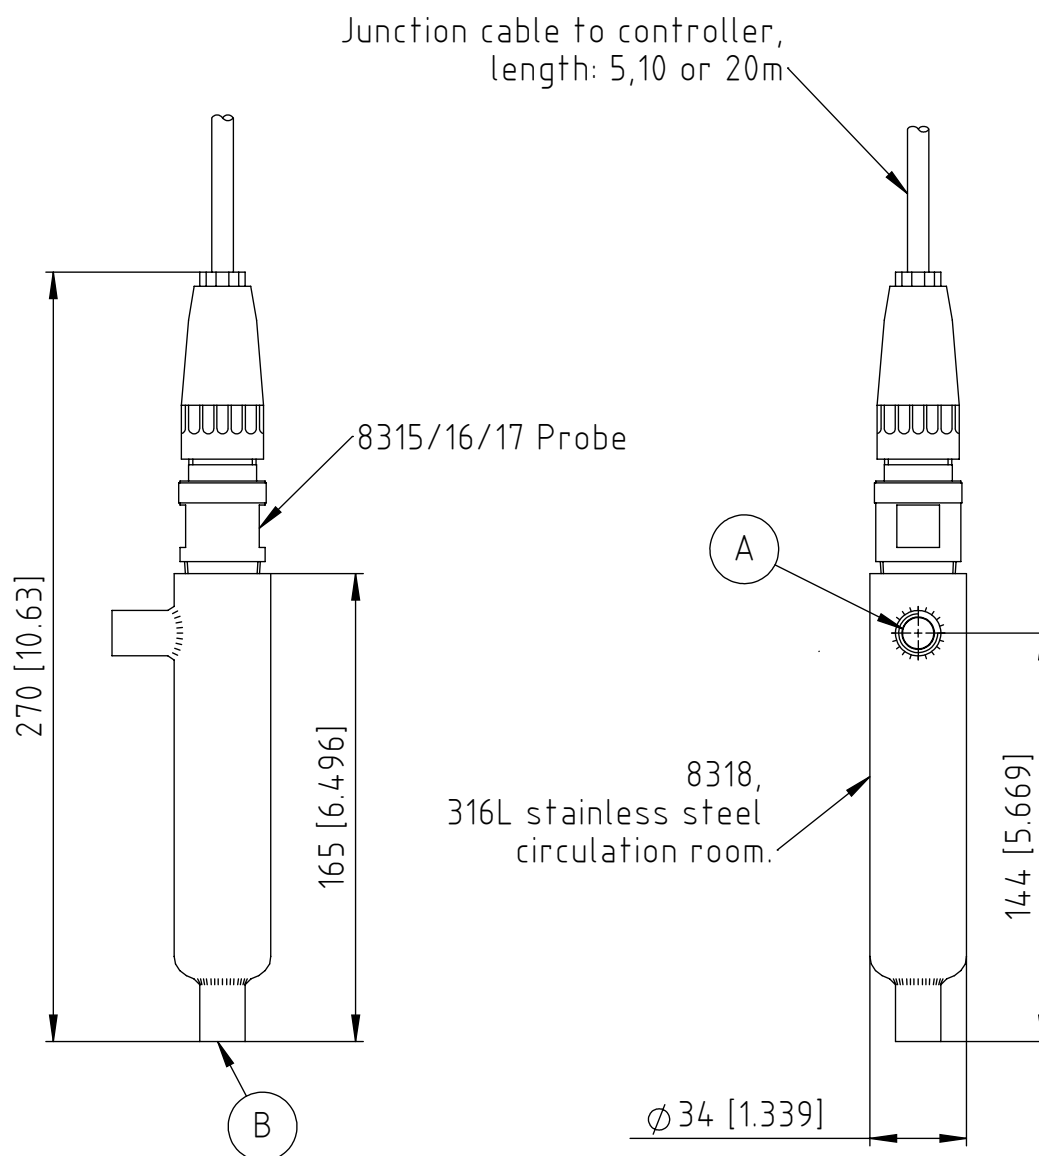

A



SAMPLE OUTLET: Female NPT 1/4".

B



SAMPLE INLET: Female NPT 1/4",
0° to 150°C (32° to 302°F), P: 25 bar max. (362 psi)

All dimensions are in mm[inches].

Cotes sans tolérance/Tolerance scale				Remarques/Notes:			
...	> 100	> 300	> 600				
< 100	...300	...600	..1000				
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 1.0				
Echelle Scale 3:8		Installation drawing (Conductivity probes 8315/16/17)			Création du document/Document creation		
					01.01.1999		S.F.
					Fichier/File: 8001318.SLDDRW		
 UNITED FOR WATER QUALITY		Code d'entrée Entry code	Immatriculation Registration	Code matière Material code	Modification	Validation	Revision
		V	8001318	00	B	Date: 04.07.2013	a
						Visa: S. Fouassier	
Tout emploi illicite de ce document sera poursuivi par voie judiciaire				Unauthorized use of this document may result in legal proceedings			