




DOC023.97.90789

Ultrapure Amperometry Module

03/2024, Edition 3

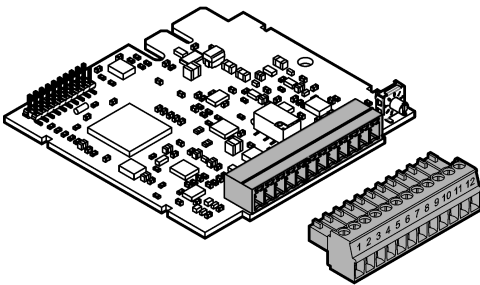

User Instructions
Instructions d'utilisation
Instrucciones para el usuario
Instruções do Usuário
使用说明
取扱説明書
사용 설명서
คำแนะนำในการใช้งาน
إرشادات المستخدم

Table of Contents

English.....	3
Français.....	14
Español.....	25
Português.....	36
中文.....	47
日本語.....	58
한국어.....	69
ไทย.....	80
العربية.....	91

Table of Contents

- | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|---|---------------|------------|
| 1 | Specifications | on page 3 | 4 | Installation | on page 5 |
| 2 | General information | on page 3 | 5 | Configuration | on page 13 |
| 3 | Modbus registers | on page 5 | | | |

Section 1 Specifications

Specifications are subject to change without notice.

1.1 Dissolved oxygen sensors

Specification	Details
Measuring range	0 to 2 ppm
Sensitivity	< 0.5 ppb
Repeatability	± 0.5 ppb or ± 2% of measurement, whichever is the greater
Detection limit	≤ 1 ppb
Response time	1 to 40 ppb: < 30 seconds
Sample temperature measurement range	0 to 45 °C (32 to 113 °F)

1.2 Oxygen scavenger electrodes

Specification	Details
Measuring range	0 to 500 ppb hydrazine; 0 to 100 ppb carbohydrazide
Sensitivity	< 0.2 ppb
Repeatability	1 ppb or ± 2% of measurement, whichever is the greater
Detection limit	≤ 1 ppb
Response time	< 60 seconds
Sample temperature measurement range	5 to 45 °C (41 to 113 °F)

Section 2 General information

In no event will the manufacturer be liable for damages resulting from any improper use of product or failure to comply with the instructions in the manual. The manufacturer reserves the right to make changes in this manual and the products it describes at any time, without notice or obligation. Revised editions are found on the manufacturer's website.

2.1 Safety information

The manufacturer is not responsible for any damages due to misapplication or misuse of this product including, without limitation, direct, incidental and consequential damages, and disclaims such damages to the full extent permitted under applicable law. The user is solely responsible to identify critical application risks and install appropriate mechanisms to protect processes during a possible equipment malfunction.

Please read this entire manual before unpacking, setting up or operating this equipment. Pay attention to all danger and caution statements. Failure to do so could result in serious injury to the operator or damage to the equipment.

Make sure that the protection provided by this equipment is not impaired. Do not use or install this equipment in any manner other than that specified in this manual.

2.1.1 Use of hazard information


▲ DANGER
Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
▲ WARNING
Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
▲ CAUTION
Indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury.
NOTICE
Indicates a situation which, if not avoided, may cause damage to the instrument. Information that requires special emphasis.

2.1.2 Precautionary labels

Read all labels and tags attached to the instrument. Personal injury or damage to the instrument could occur if not observed. A symbol on the instrument is referenced in the manual with a precautionary statement.

	This is the safety alert symbol. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid potential injury. If on the instrument, refer to the instruction manual for operation or safety information.
	This symbol indicates that a risk of electrical shock and/or electrocution exists.
	This symbol indicates the presence of devices sensitive to Electro-static Discharge (ESD) and indicates that care must be taken to prevent damage with the equipment.
	This symbol indicates that the marked item requires a protective earth connection. If the instrument is not supplied with a ground plug on a cord, make the protective earth connection to the protective conductor terminal.
	This symbol, when noted on a product, indicates the instrument is connected to alternate current.
	Electrical equipment marked with this symbol may not be disposed of in European domestic or public disposal systems. Return old or end-of-life equipment to the manufacturer for disposal at no charge to the user.
	Products marked with this symbol indicates that the product contains toxic or hazardous substances or elements. The number inside the symbol indicates the environmental protection use period in years.

2.2 Icons used in illustrations

				
Manufacturer supplied parts	User supplied parts	Look	Listen	Do one of these options

2.3 Product overview


The ultrapure amperometry module lets the SC4500 Controller connect to an analog sensor. The module connects to slot 3 in the controller.

For calibration and operation of the sensor, refer to the instrument user manual and the SC Controller documentation.

2.4 Product components

Make sure that all components have been received. Refer to [Figure 1](#). If any items are missing or damaged, contact the manufacturer or a sales representative immediately.

Figure 1 Product components

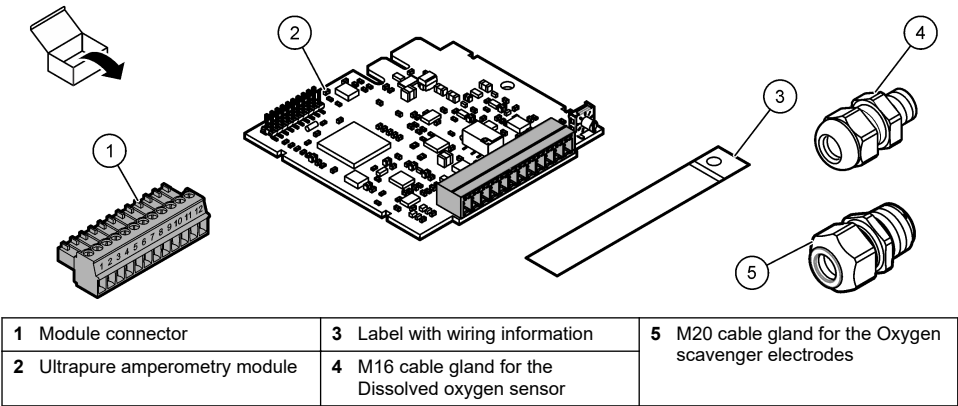

Section 3 Modbus registers

A list of Modbus registers is available for network communication. Refer to the manufacturer's website for more information.

Section 4 Installation



⚠ DANGER

Multiple hazards. Only qualified personnel must conduct the tasks described in this section of the document.

⚠ DANGER



Electrocution hazard. Remove power from the instrument before this procedure is started.

⚠ DANGER



Electrocution hazard. High voltage wiring for the controller is conducted behind the high voltage barrier in the controller enclosure. The barrier must remain in place unless a qualified installation technician is installing wiring for power, alarms, or relays.

⚠ WARNING



Electrical shock hazard. Externally connected equipment must have an applicable country safety standard assessment.

NOTICE

Make sure that the equipment is connected to the instrument in accordance with local, regional and national requirements.

4.1 Electrostatic discharge (ESD) considerations

NOTICE



Potential Instrument Damage. Delicate internal electronic components can be damaged by static electricity, resulting in degraded performance or eventual failure.

Refer to the steps in this procedure to prevent ESD damage to the instrument:

- Touch an earth-grounded metal surface such as the chassis of an instrument, a metal conduit or pipe to discharge static electricity from the body.
- Avoid excessive movement. Transport static-sensitive components in anti-static containers or packages.
- Wear a wrist strap connected by a wire to earth ground.
- Work in a static-safe area with anti-static floor pads and work bench pads.

4.2 Install the module

To install the module and connect the sensor, refer to the illustrated steps that follow, [Figure 2](#) and [Table 2](#).

Notes:

- Make sure that the controller is compatible with the amperometry module. Contact technical support.
- Make sure that the routing of the sensor cable prevents exposure to high electromagnetic fields (e.g., transmitters, motors and switching equipment). Exposure to these fields can cause inaccurate results.
- To keep the enclosure rating, make sure that all unused electrical access holes are sealed with an access hole cover.
- To maintain the enclosure rating of the instrument, unused cable glands must be plugged.
- Connect the module to slot 3. Refer to [Figure 2](#). The controller has two analog module slots (3 and 4). The analog module slots are internally connected to the sensor channel. Make sure that the analog module and the digital sensor are not connected to the same channel.


Note: Make sure that only two sensors are connected to the controller. Although two analog module ports are available, if a digital sensor and two modules are installed, only two of the three devices will be seen by the controller.

- Keep the removed digital connector for possible future use.


- Make sure to connect all sensor ground/shield wires to the controller enclosure grounding screws.



Note: If the sensor cable is too short to connect to the controller, use a connecting cable and junction box to extend the distance.


Figure 2 Amperometry module slot

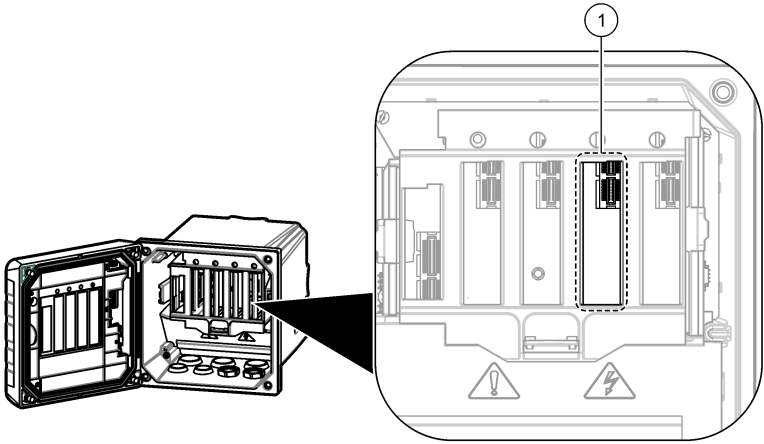

1 Analog module slot—Channel 1

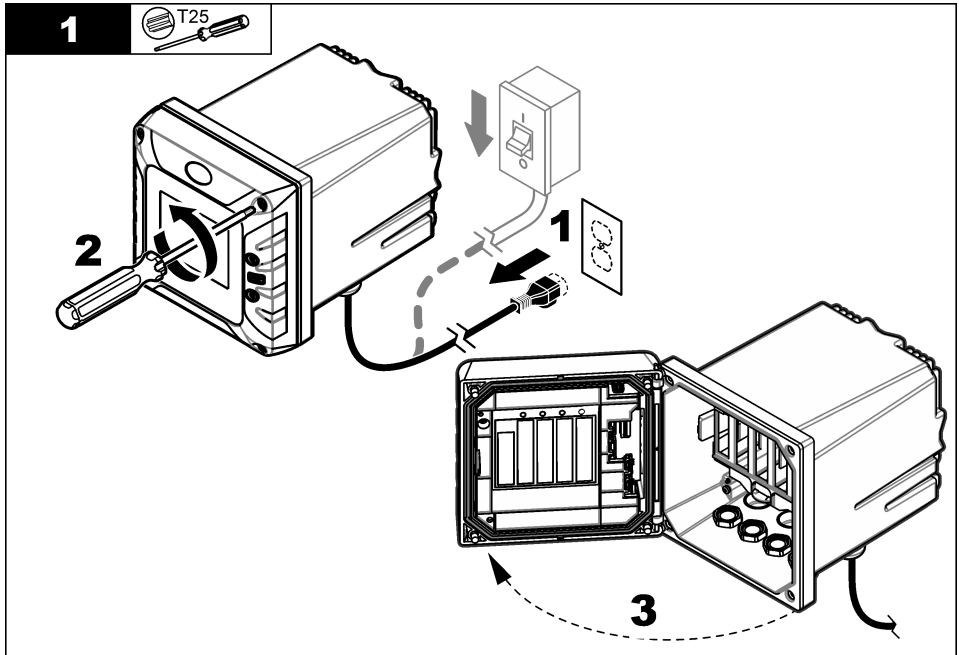

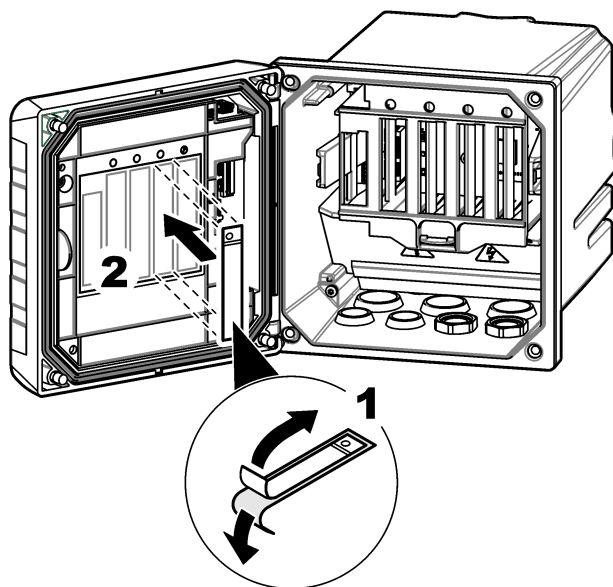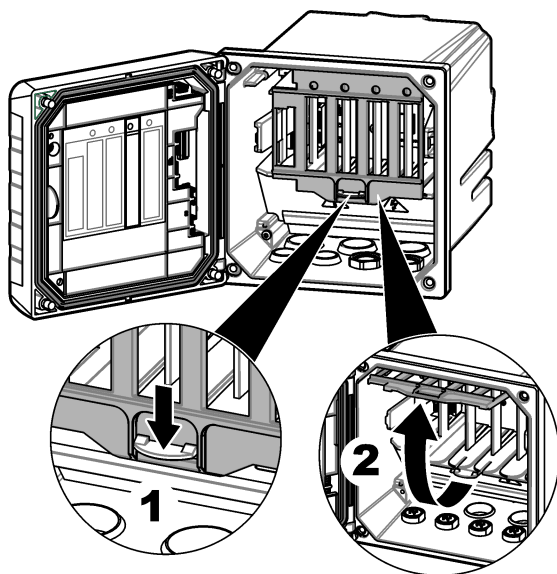
2**3**


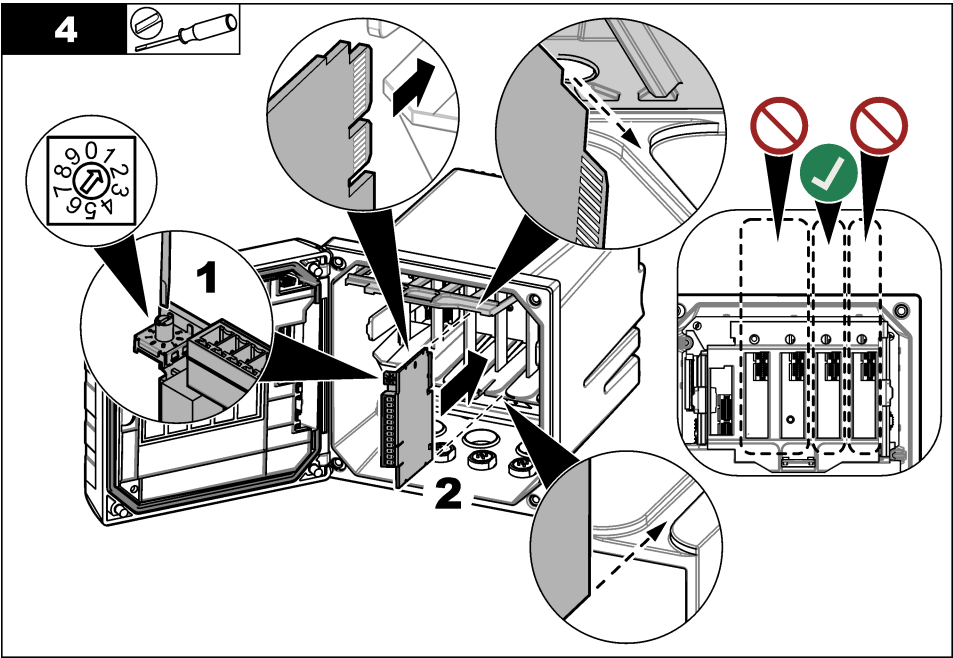


Turn the rotatory switch of the module to configure the module based on the applicable sensor. Refer to [Table 1](#).


Table 1 Module configuration

Switch position	Sensor type
1	Dissolved oxygen sensor
2	Oxygen scavenger electrodes

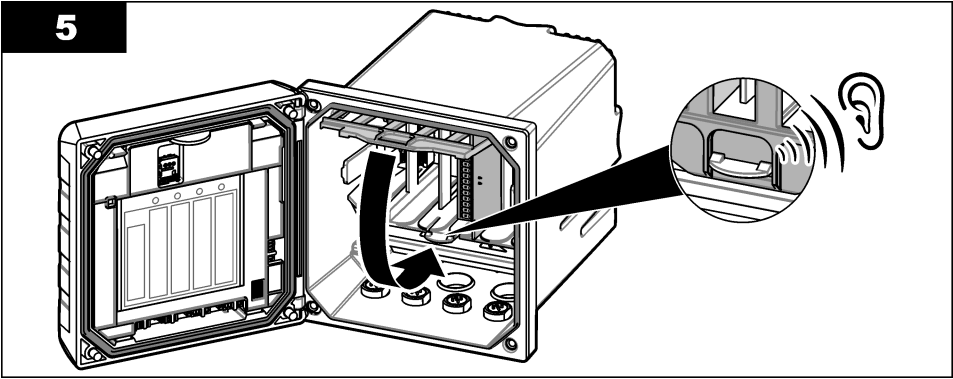

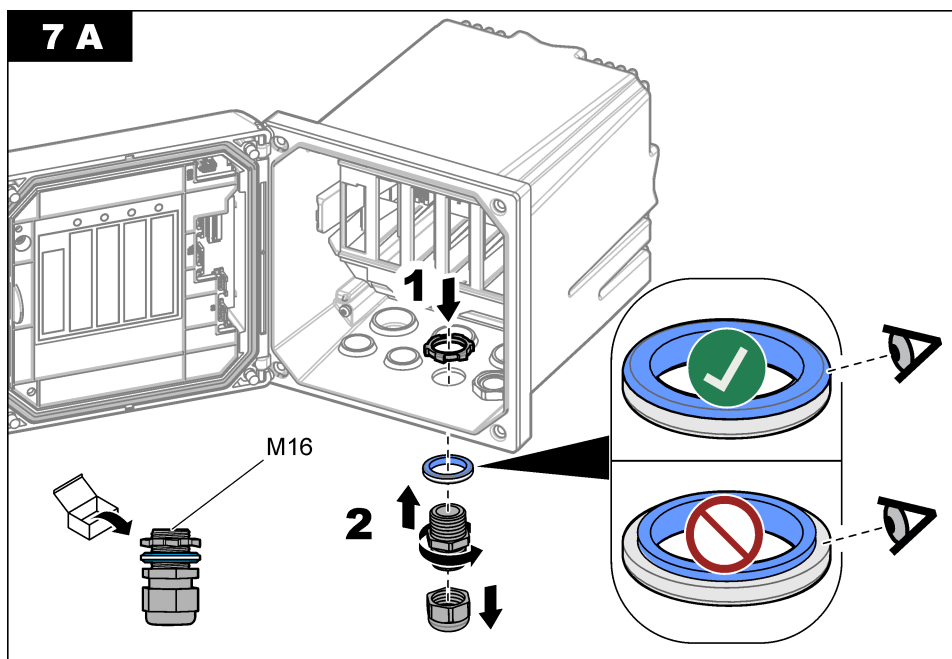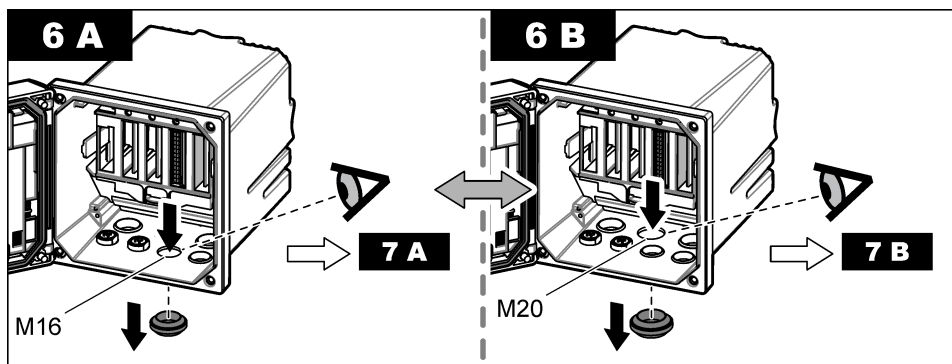

7 B

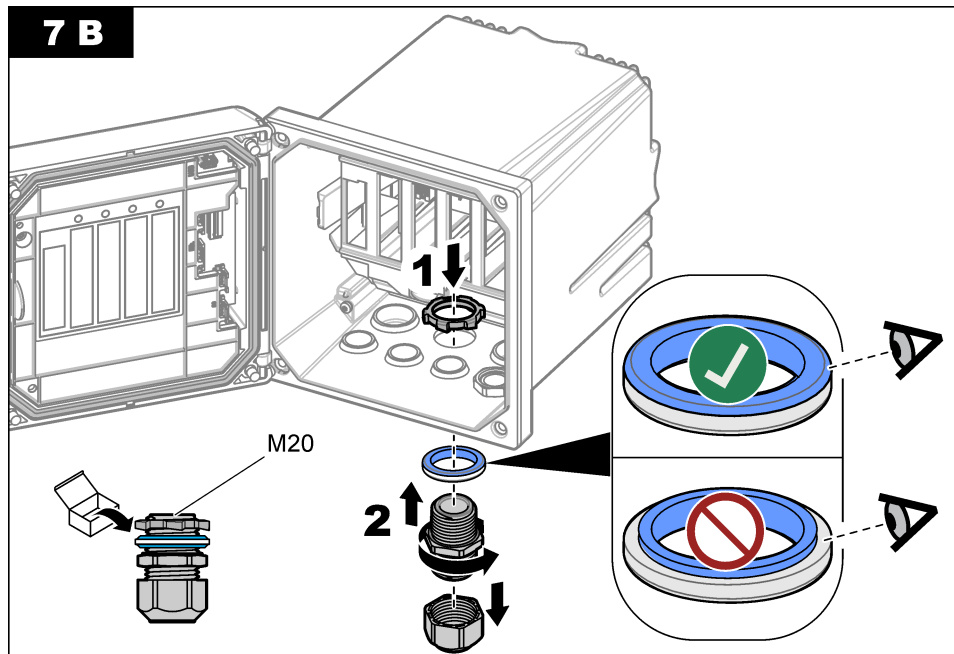

8



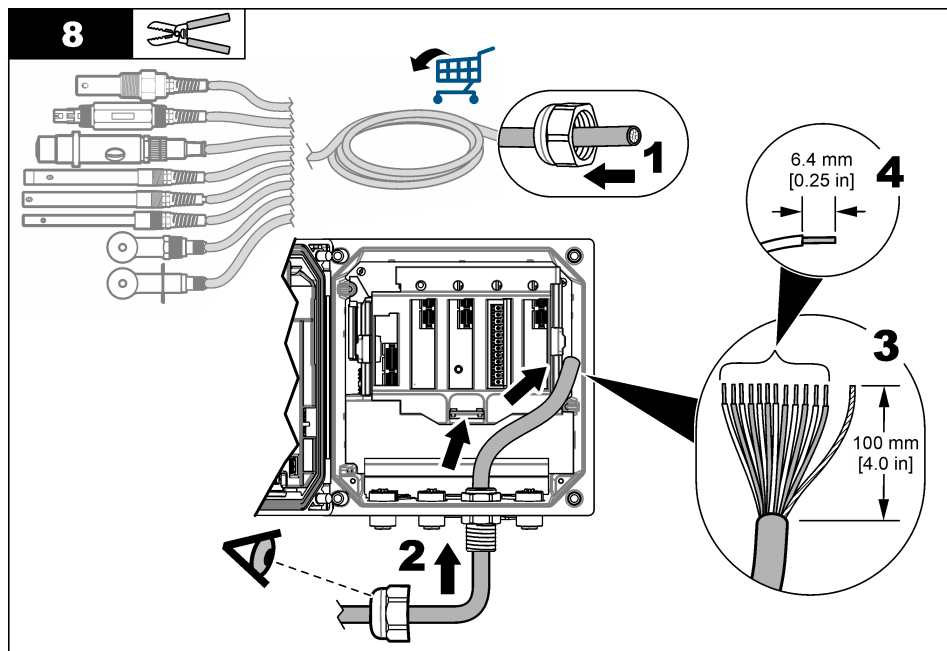




Table 2 Dissolved oxygen sensor and oxygen scavenger electrodes wiring

Terminal	Description	Dissolved oxygen	Oxygen scavenger
1	Temp +	Black	Black
2	Temp -	Blue	Blue
3	—	—	—
4	—	—	—
5	Ground	Green	Green
6	Earth	Yellow	Yellow
7	—	—	—
8	—	—	—
9	Working electrode	White	White
10	Counter electrode	Red	Gray
11	—	—	Transparent
12	—	—	—

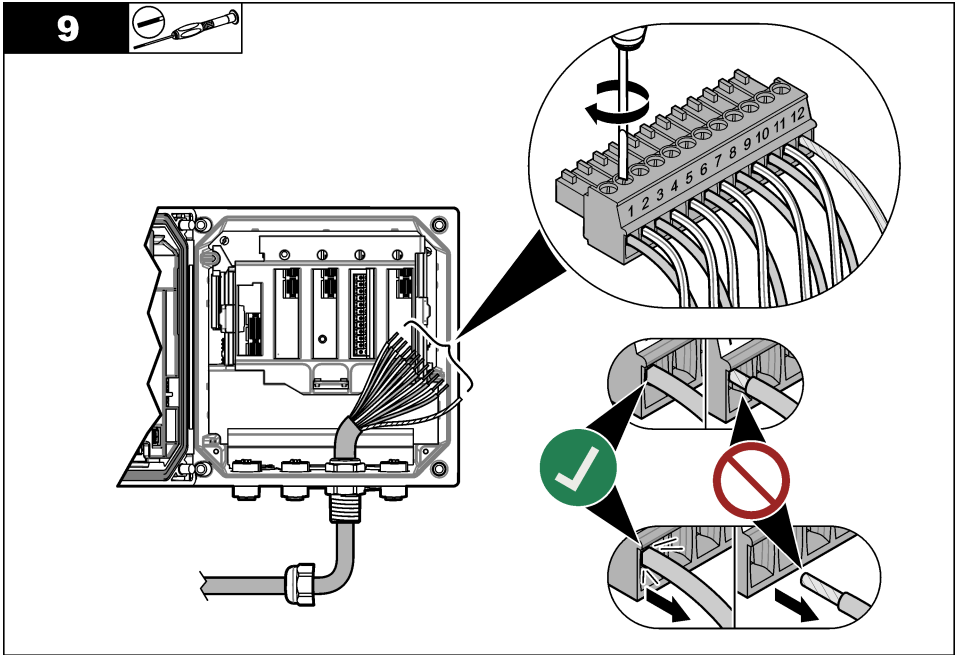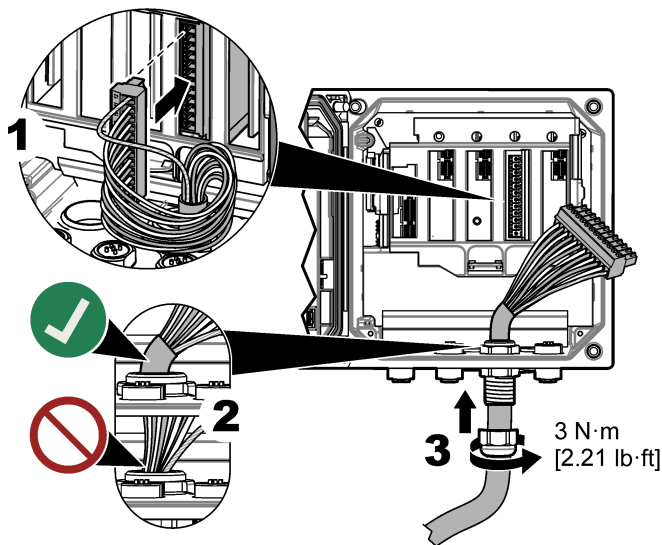

10**11**

T25

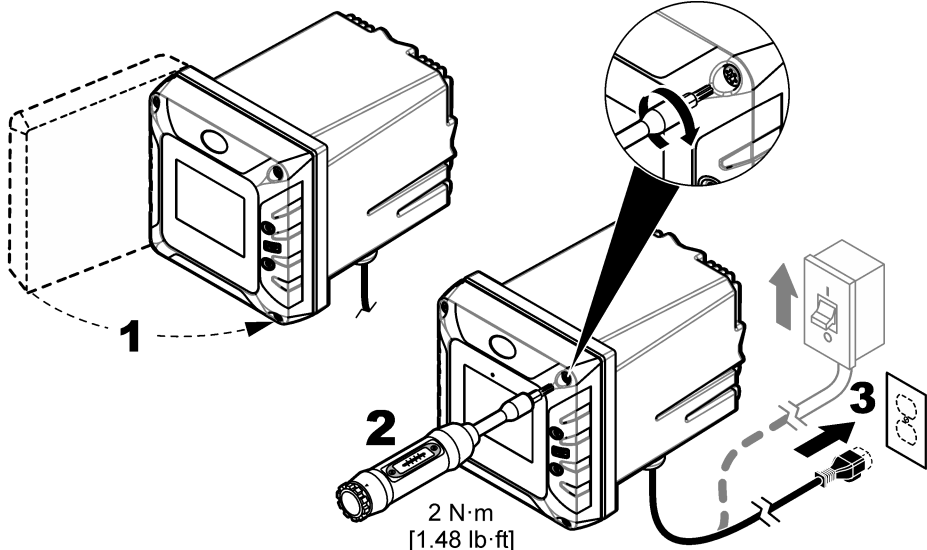

Section 5 Configuration

Refer to the instrument and/or controller documentation for instructions.

Table des matières

1

Caractéristiques à la page 14

2

Généralités à la page 14

3

Registres Modbus à la page 16

4

Installation à la page 16

5

Configuration à la page 24

Section 1 Caractéristiques

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

1.1 Capteurs d'oxygène dissout

Spécification	Détails
Plage de mesures	0 à 2 ppm
Sensibilité	< 0,5 ppb
Répétabilité	± 0,5 ppb ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Limite de détection	≤ 1 ppb
Temps de réponse	1 à 40 ppb : < 30 secondes
Plage de mesure de température de l'échantillon	0 à 45 °C (32 à 113 °F)

1.2 Électrodes de piégeage de l'oxygène

Spécification	Détails
Plage de mesures	0 à 500 ppb d'hydrazine ; 0 à 100 ppb de carbohydrazide
Sensibilité	< 0,2 ppb
Répétabilité	1 ppb ou ± 2% de la mesure (le plus grand des deux)
Limite de détection	≤ 1 ppb
Temps de réponse	< 60 secondes
Plage de mesure de température de l'échantillon	5 à 45 °C (41 à 113 °F)

Section 2 Généralités

En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions du manuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel et aux produits décrits, à tout moment, sans avertissement ni obligation. Les éditions révisées se trouvent sur le site Internet du fabricant.

2.1 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dégâts liés à une application ou un usage inappropriés de ce produit, y compris, sans toutefois s'y limiter, des dommages directs ou indirects, ainsi que des dommages consécutifs, et rejette toute responsabilité quant à ces dommages dans la mesure où la loi applicable le permet. L'utilisateur est seul responsable de la vérification des risques d'application critiques et de la mise en place de mécanismes de protection des processus en cas de défaillance de l'équipement.

Veuillez lire l'ensemble du manuel avant le déballage, la configuration ou la mise en fonctionnement de cet appareil. Respectez toutes les déclarations de prudence et d'attention. Le non-respect de cette procédure peut conduire à des blessures graves de l'opérateur ou à des dégâts sur le matériel. Assurez-vous que la protection fournie par cet équipement n'est pas compromise. Ne pas utiliser ou installer cet équipement autrement qu'indiqué dans le présent manuel.

2.1.1 Informations sur les risques d'utilisation

⚠ DANGER	
Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des blessures graves, voire mortelles.	
⚠ AVERTISSEMENT	
Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.	
⚠ ATTENTION	
Indique une situation de danger potentiel qui peut entraîner des blessures mineures ou légères.	
A V I S	
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner l'endommagement du matériel. Informations nécessitant une attention particulière.	

2.1.2 Etiquettes de mise en garde

Lisez toutes les informations et toutes les étiquettes apposées sur l'appareil. Des personnes peuvent se blesser et le matériel peut être endommagé si ces instructions ne sont pas respectées. Tout symbole sur l'appareil renvoie à une instruction de mise en garde dans le manuel.

	Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure. S'ils sont apposés sur l'appareil, se référer au manuel d'utilisation pour connaître le fonctionnement ou les informations de sécurité.
	Ce symbole indique qu'il existe un risque de choc électrique et/ou d'électrocution.
	Ce symbole indique la présence d'appareils sensibles aux décharges électrostatiques et indique que des précautions doivent être prises afin d'éviter d'endommager l'équipement.
	Ce symbole indique que l'élément marqué nécessite une connexion de protection à la terre. Si l'appareil n'est pas fourni avec une mise à la terre sur un cordon, effectuez la mise à la terre de protection sur la borne de conducteur de protection.
	Ce symbole, apposé sur un produit, indique que l'instrument est raccordé au courant alternatif.
	Le matériel électrique portant ce symbole ne doit pas être mis au rebut dans les réseaux domestiques ou publics européens. Retournez le matériel usé ou en fin de vie au fabricant pour une mise au rebut sans frais pour l'utilisateur.
	Ce symbole, apposé sur les produits, indique que le produit contient des substances ou éléments toxiques ou dangereux. Le numéro à l'intérieur du symbole indique la période d'utilisation en années pour la protection de l'environnement.

2.2 Icônes utilisées dans les images

				
Pièces fournies par le fabricant	Pièces fournies par l'utilisateur	Regarder	Ecouter	Choisir l'une de ces options

2.3 Présentation du produit


Le module ampèremètre Ultrapure permet de connecter le contrôleur SC4500 à un capteur analogique. Le module se connecte à l'emplacement 3 dans le contrôleur.

Pour l'étalonnage et le fonctionnement du capteur, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'instrument et à la documentation du contrôleur SC.

2.4 Composants du produit

Assurez-vous d'avoir bien reçu tous les composants. Reportez-vous à la section [Figure 1](#). Si un élément est absent ou endommagé, contactez immédiatement le fabricant ou un représentant commercial.

Figure 1 Composants du produit

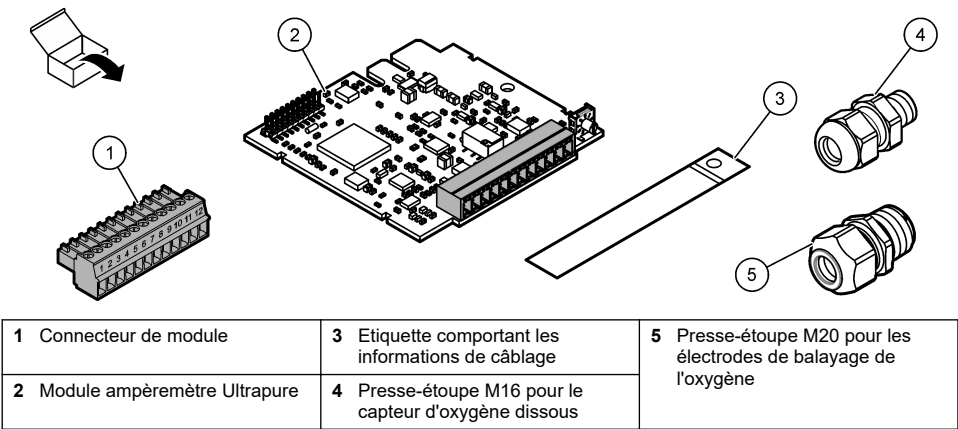

Section 3 Registres Modbus

Une liste de registres Modbus est disponible pour la communication réseau. Consultez le site Internet du fabricant de l'instrument pour plus d'informations.

Section 4 Installation



⚠ DANGER

Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les tâches détaillées dans cette section du document.

⚠ DANGER



Risque d'électrocution. Débranchez l'alimentation de l'appareil avant le début de la procédure.

⚠ DANGER



Risque d'électrocution. Le câblage à haute tension du transmetteur est effectué derrière l'écran de protection à haute tension du boîtier du transmetteur. La barrière doit rester en place, à moins qu'un technicien qualifié d'installation installe le câblage pour l'alimentation, les alarmes ou les relais.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution. Tout équipement externe relié doit avoir fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément aux normes nationales applicables.

AVIS

L'équipement doit être branché sur l'instrument conformément aux exigences locales, régionales et nationales.

4.1 Remarques relatives aux décharges électrostatiques (ESD)

AVIS



Dégât potentiel sur l'appareil. Les composants électroniques internes de l'appareil peuvent être endommagés par l'électricité statique, qui risque d'altérer ses performances et son fonctionnement.

Reportez-vous aux étapes décrites dans cette procédure pour éviter d'endommager l'appareil par des décharges électrostatiques.

- Touchez une surface métallique reliée à la terre (par exemple, le châssis d'un appareil, un conduit ou un tuyau métallique) pour décharger l'électricité statique de votre corps.
- Évitez tout mouvement excessif. Transportez les composants sensibles à l'électricité statique dans des conteneurs ou des emballages antistatiques.
- Portez un bracelet spécial relié à la terre par un fil.
- Travaillez dans une zone à protection antistatique avec des tapis de sol et des sous-mains antistatiques.

4.2 Installation du module

Pour installer le module et brancher le capteur, consultez les étapes illustrées suivantes, [Figure 2](#) et [Tableau 2](#).

Remarques :


- Assurez-vous que le contrôleur est compatible avec le module ampèremètre. Contactez l'assistance technique.
- Assurez-vous que le tracé du câble du capteur évite l'exposition à des champs électromagnétiques importants (ex. : émetteurs, moteurs et équipement de commutation). Une exposition à ces champs peut entraîner des résultats inexacts.
- Pour respecter l'indice de protection du boîtier, vérifiez que tous les trous d'accès électriques inutilisés sont scellés avec un cache.
- Pour respecter l'indice de protection de l'instrument, les passe-câbles inutilisés doivent être branchés.
- Connectez le module au port 3. Reportez-vous à la [Figure 2](#). Le contrôleur dispose de deux ports de module analogique (3 et 4). Les ports de module analogique sont connectés en interne au canal du capteur. Assurez-vous que le module analogique et le capteur numérique ne sont pas connectés au même canal.

Remarque : Assurez-vous que seulement deux capteurs sont connectés au contrôleur. Bien que deux ports de module analogique soient disponibles, si un capteur numérique et deux modules sont installés, seuls deux des trois appareils sont détectés par le contrôleur.


- Conservez le connecteur numérique déposé pour une potentielle utilisation ultérieure.
- Assurez-vous de connecter tous les câbles de masse/blindés du capteur aux vis de mise à la masse du boîtier du contrôleur.



Remarque : Si le câble du capteur est trop court pour être connecté au contrôleur, utilisez un câble de connexion et un boîtier de jonction pour le prolonger.

Figure 2 Emplacement de module ampèremètre

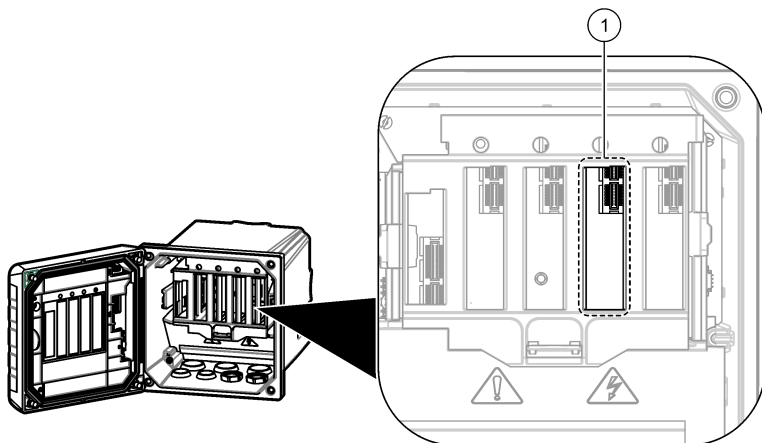


1 Emplacement de module analogique — Canal 1

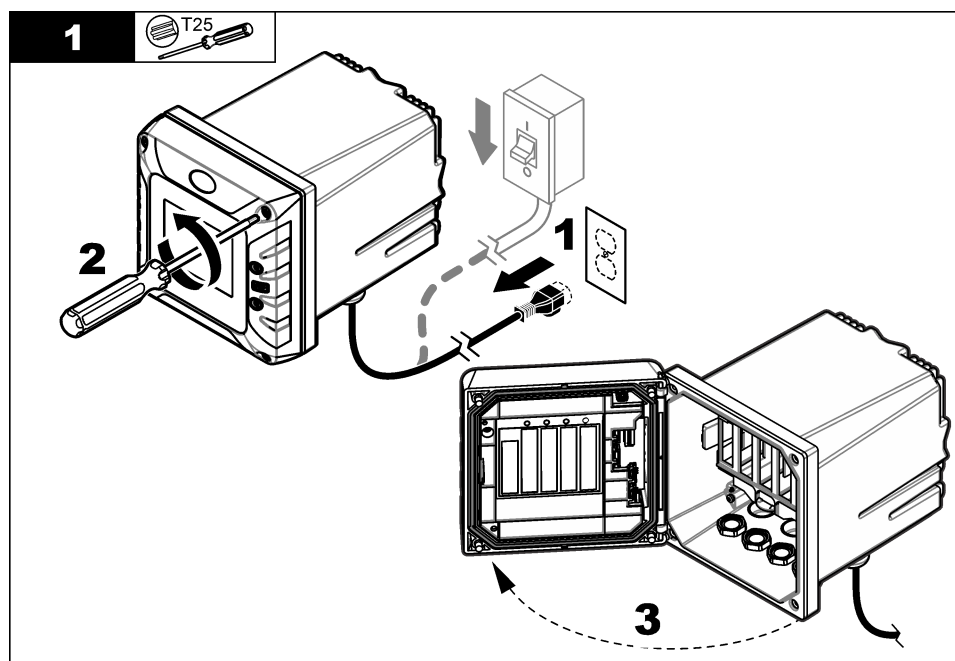

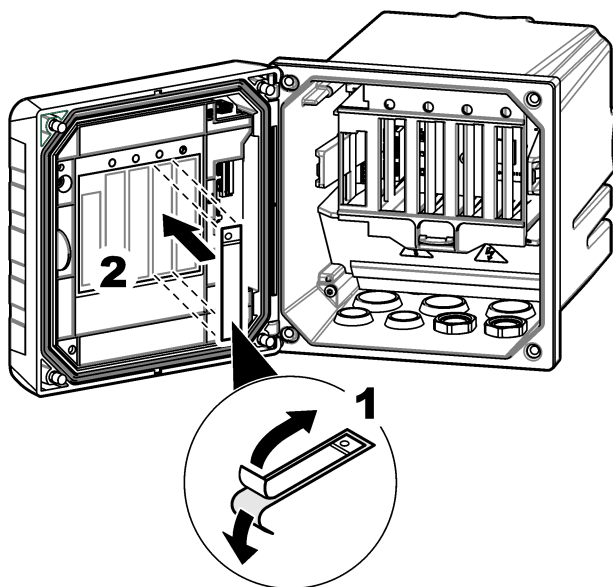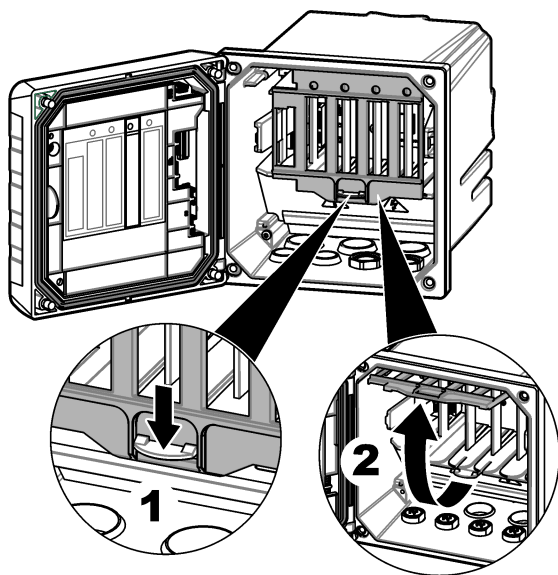2**3**

4

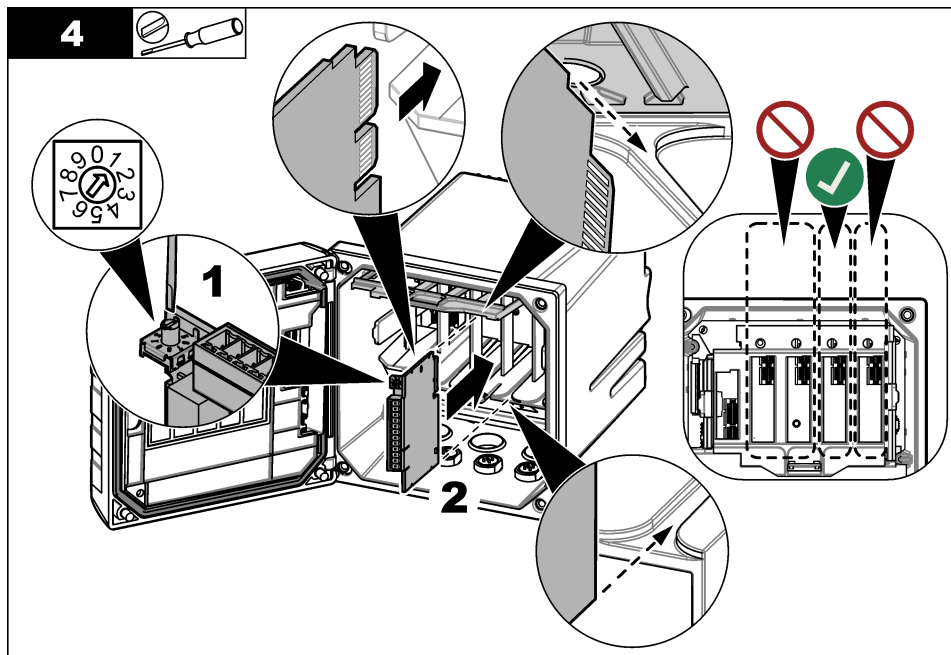




Tournez le commutateur rotatif du module pour configurer ce dernier en fonction du capteur applicable. Reportez-vous à la section [Tableau 1](#).

Tableau 1 Configuration du module


Position du commutateur	Type de capteur
1	Capteur d'oxygène dissous
2	Électrodes de piégeage de l'oxygène

5

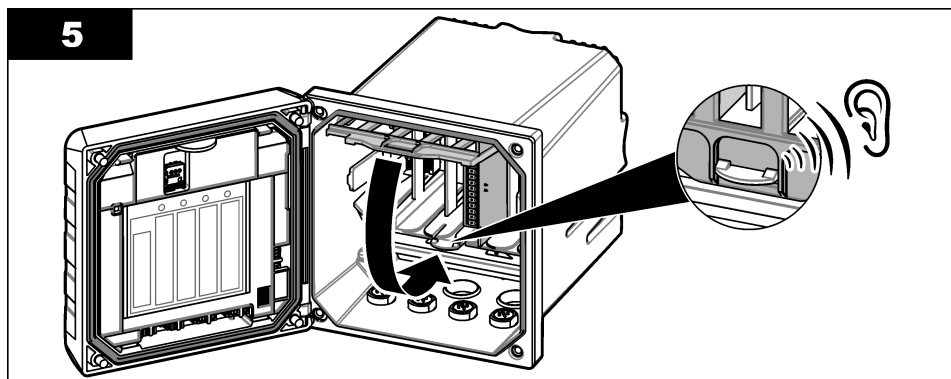

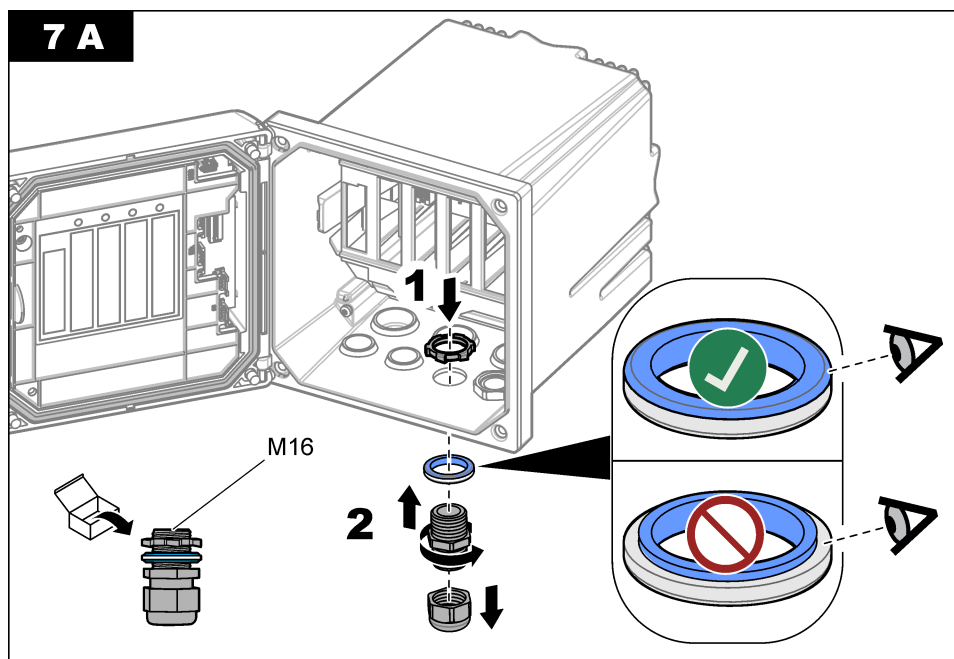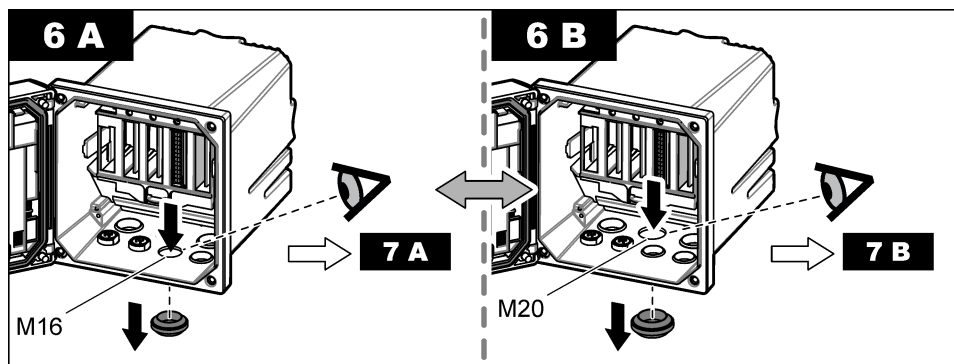

7 B

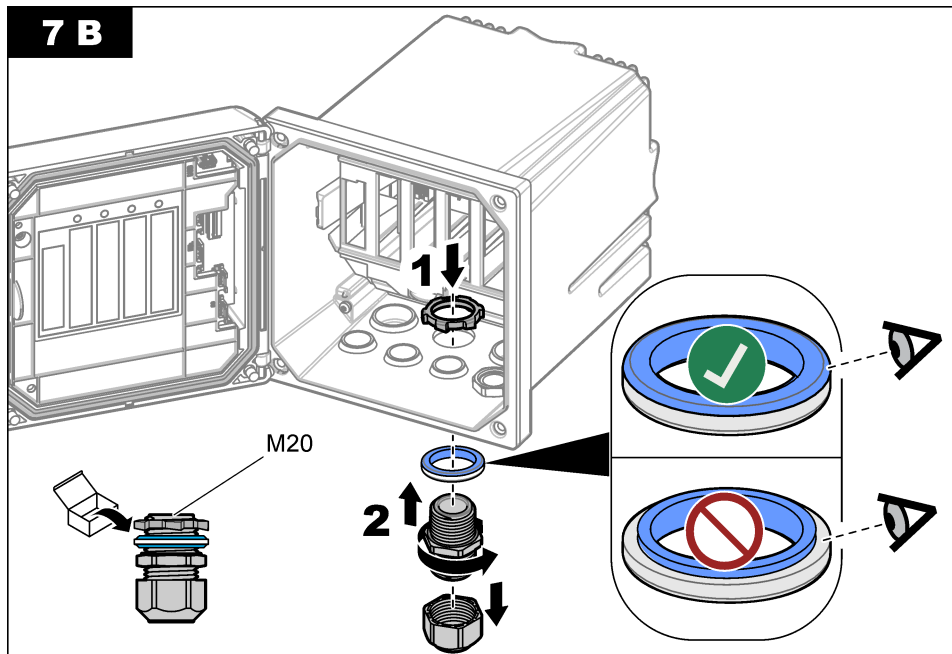

8



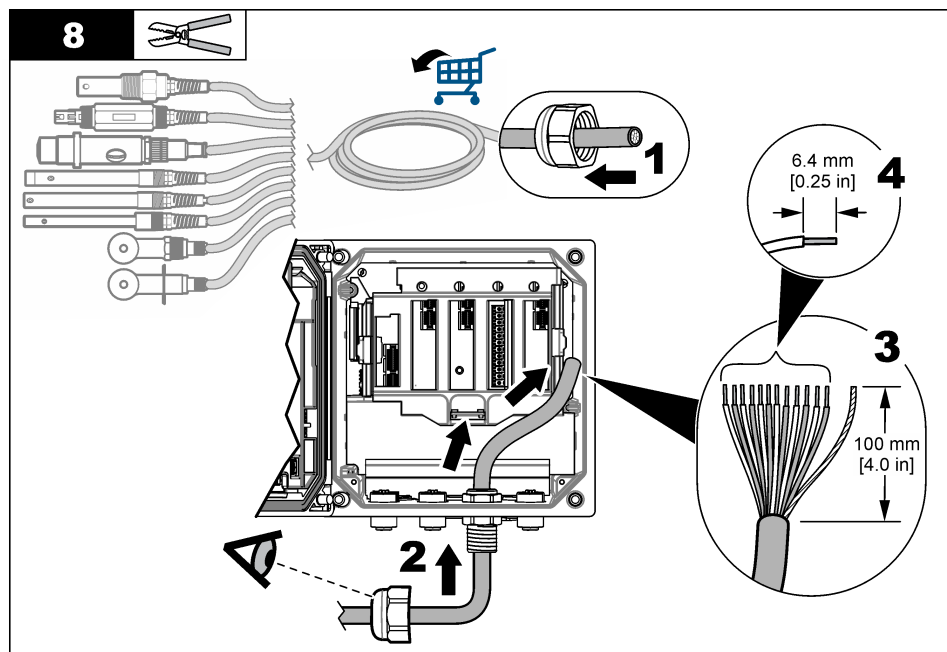



Tableau 2 Câblage du capteur d'oxygène dissous et des électrodes du capteur d'oxygène

Borne	Description	Oxygène dissout	Fixation d'oxygène
1	Temp +	Noir	Noir
2	Temp -	Bleu	Bleu
3	—	—	—
4	—	—	—
5	Terre	Vert	Vert
6	Terre	Jaune	Jaune
7	—	—	—
8	—	—	—
9	Electrode de travail	Blanc	Blanc
10	Electrode du compteur	Rouge	Gris
11	—	—	Transparent
12	—	—	—

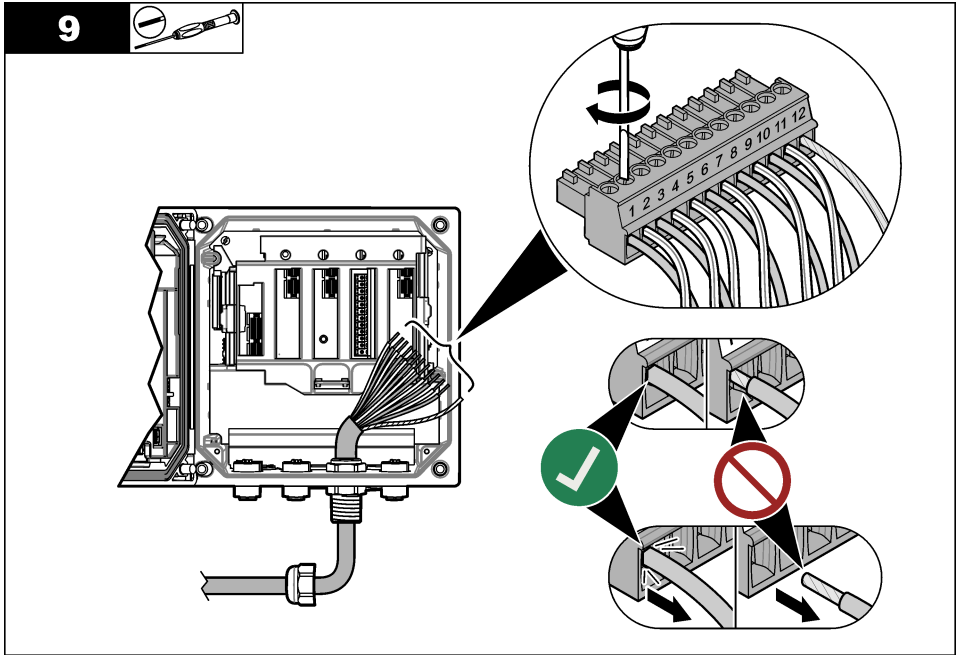

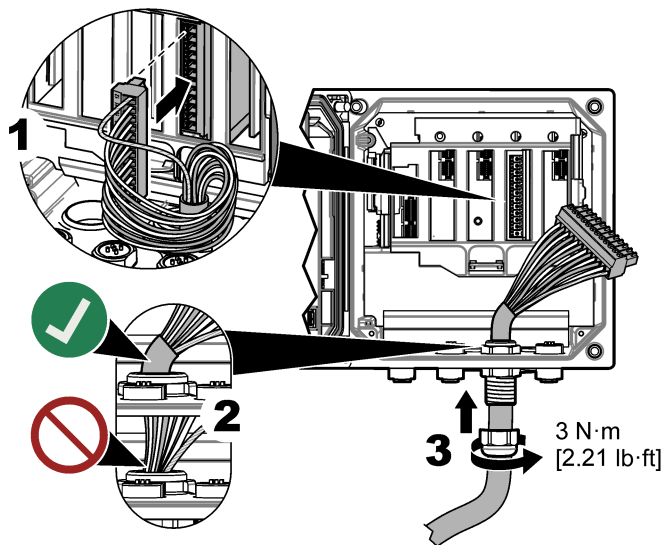

T25

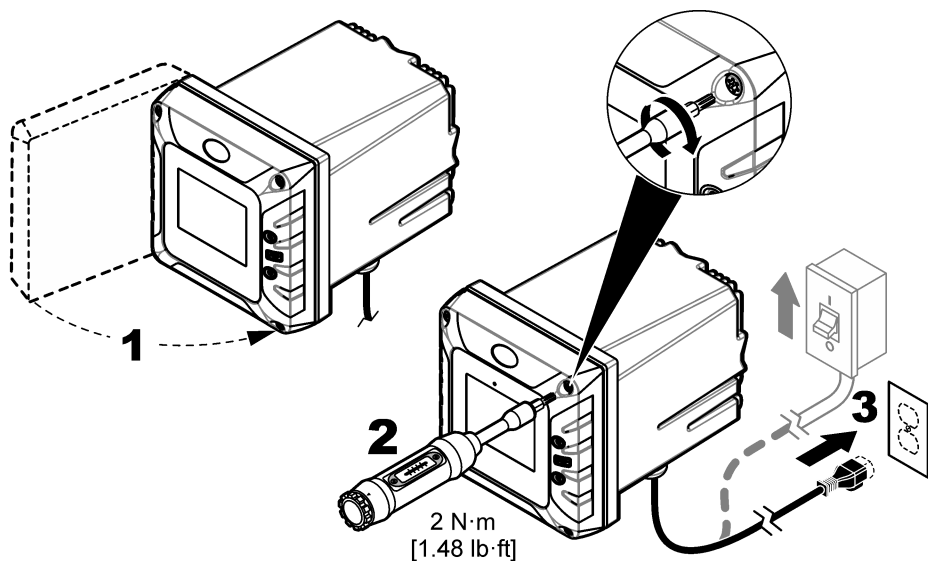

Section 5 Configuration

Reportez-vous à la documentation de l'instrument et/ou du contrôleur pour obtenir des instructions.

Tabla de contenidos

- 1

Especificaciones en la página 25
- 2

Información general en la página 25
- 3

Registros de Modbus en la página 27
- 4

Instalación en la página 27
- 5

Configuración en la página 35

Sección 1 Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1.1 Sensores de oxígeno disuelto

Especificación	Datos
Rango de medición	De 0 a 2 ppm
Sensibilidad	< 0,5 ppb
Repetibilidad	± 0,5 ppb o ± 2 % de la medición, lo que sea mayor
Límite de detección	≤ 1 ppb
Tiempo de respuesta	De 0 a 40 ppb: < 30 segundos
Rango de medición de temperatura de la muestra	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)

1.2 Electroodos de atrapadores de oxígeno

Especificación	Datos
Rango de medición	Hidracina 0 a 500 ppb; carbohidrazida 0 a 100 ppb
Sensibilidad	< 0.2 ppb
Repetibilidad	1 ppb o ± 2% de medición, el valor que sea superior
Límite de detección	≤ 1 ppb
Tiempo de respuesta	< 60 segundos
Intervalo de medición de temperatura de la muestra	De 5 a 45 °C (41 a 113 °F)

Sección 2 Información general

El fabricante no será responsable en ningún caso de los daños resultantes de un uso inadecuado del producto o del incumplimiento de las instrucciones del manual. El fabricante se reserva el derecho a modificar este manual y los productos que describen en cualquier momento, sin aviso ni obligación. Las ediciones revisadas se encuentran en la página web del fabricante.

2.1 Información de seguridad

El fabricante no es responsable de ningún daño debido a un mal uso de este producto incluyendo, sin limitación, daños directos, fortuitos o circunstanciales y reclamaciones sobre los daños que no estén recogidos en la legislación vigente. El usuario es el responsable de la identificación de los riesgos críticos y de tener los mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de un posible mal funcionamiento del equipo.

Sírvase leer todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Ponga atención a todas las advertencias y avisos de peligro. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o daños al equipo.

Asegúrese de que la protección proporcionada por este equipo no se vea afectada. No use o instale este equipo de una manera diferente a la explicada en este manual.

2.1.1 Uso de la información relativa a riesgos


⚠ PELIGRO
Indica una situación potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.
⚠ ADVERTENCIA
Indica una situación potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.
⚠ PRECAUCIÓN
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar una lesión menor o moderada.
A VISO
Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en el instrumento. Información que requiere especial énfasis.

2.1.2 Etiquetas de precaución

Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían producirse heridas personales o daños en el instrumento. El símbolo que aparezca en el instrumento se comentará en el manual con una declaración de precaución.

	Este es un símbolo de alerta de seguridad. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se muestran junto con este símbolo para evitar posibles lesiones. Si se encuentran sobre el instrumento, consulte el manual de instrucciones para obtener información de funcionamiento o seguridad.
	Este símbolo indica que hay riesgo de descarga eléctrica y/o electrocución.
	Este símbolo indica la presencia de dispositivos susceptibles a descargas electrostáticas. Asimismo, indica que se debe tener cuidado para evitar que el equipo sufra daño.
	Este símbolo indica que el objeto marcado requiere una toma a tierra de seguridad. Si el instrumento no se suministra con un cable con enchufe de toma a tierra, realice la conexión a tierra de protección al terminal conductor de seguridad.
	Este símbolo, cuando aparece en un producto, indica que el instrumento está conectado a corriente alterna.
	En Europa, el equipo eléctrico marcado con este símbolo no se debe desechar mediante el servicio de recogida de basura doméstica o pública. Devuelva los equipos viejos o que hayan alcanzado el término de su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario.
	Los productos marcados con este símbolo contienen sustancias o elementos tóxicos o peligrosos. El número dentro del símbolo especifica el período de uso con protección medioambiental en años.

2.2 Iconos usados en las ilustraciones

				
Piezas suministradas por el fabricante	Piezas suministradas por el usuario	Observe	Escuche	Realice una de estas opciones

2.3 Descripción general del producto


El módulo amperométrico de agua ultrapura permite conectar el controlador SC4500 a un sensor analógico. El módulo se conecta al zócalo 3 del controlador.

Para la calibración y utilización del sensor, consulte el manual del usuario del instrumento y la documentación del controlador SC.

2.4 Componentes del producto

Asegúrese de que ha recibido todos los componentes. Consulte la [Figura 1](#). Si faltasen artículos o estuvieran dañados, póngase en contacto con el fabricante o un representante de ventas inmediatamente.

Figura 1 Componentes del producto

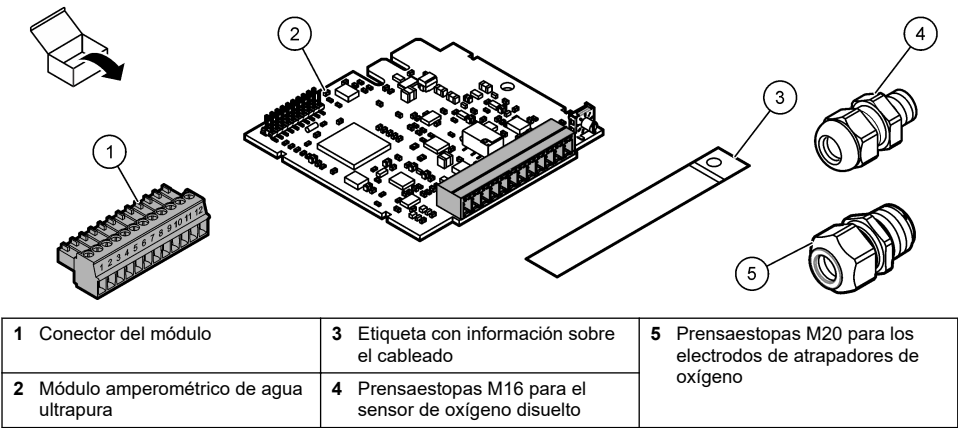

Sección 3 Registros de Modbus

Está disponible una lista de registros Modbus para comunicación en red. Consulte la página web del fabricante para obtener más información.

Sección 4 Instalación



⚠ PELIGRO

Peligros diversos. Solo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta sección del documento.

⚠ PELIGRO	
	Peligro de electrocución. Desconecte el instrumento de la alimentación eléctrica antes de iniciar este procedimiento.

⚠ PELIGRO	
	Peligro de electrocución. El cableado de alta tensión para el controlador se realiza detrás de la barrera de alta tensión en la carcasa del controlador. La barrera debe permanecer en su lugar a menos que un técnico de instalación cualificado esté instalando el cableado para la potencia, las alarmas o los relés.

⚠ ADVERTENCIA	
	Peligro de descarga eléctrica. El equipo conectado de forma externa debe someterse a una evaluación estándar de seguridad aplicable.

A V I S O	
Compruebe que el equipo está conectado al instrumento según las regulaciones locales, regionales y nacionales.	

4.1 Indicaciones para la descarga electrostática

A V I S O	
	Daño potencial al instrumento. Los delicados componentes electrónicos internos pueden sufrir daños debido a la electricidad estática, lo que acarrearía una disminución del rendimiento del instrumento y posibles fallos.

Consulte los pasos en este procedimiento para evitar daños de descarga electrostática en el instrumento:

- Toque una superficie metálica a tierra como el chasis de un instrumento, un conducto metálico o un tubo para descargar la electricidad estática del cuerpo.
- Evite el movimiento excesivo. Transporte los componentes sensibles a la electricidad estática en envases o paquetes anti-estáticos.
- Utilice una muñequera conectada a tierra mediante un alambre.
- Trabaje en una zona sin electricidad estática con alfombras antiestáticas y tapetes antiestáticos para mesas de trabajo.

4.2 Instalación del módulo

Para instalar el módulo y conectar el sensor, consulte los pasos ilustrados siguientes, [Figura 2](#) y [Tabla 2](#).

Notas:


- Asegúrese de que el controlador sea compatible con el módulo amperométrico. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- Asegúrese de que el cable del sensor está conectado de forma que se evite la exposición a campos con elevada carga electromagnética (p. ej., transmisores, motores y equipos de conmutación). La exposición a estos campos pueden provocar resultados imprecisos.
- Para mantener el valor nominal de protección de la carcasa, asegúrese de que todos los orificios de acceso que no estén en uso estén cubiertos con su tapa correspondiente.
- Para mantener el grado de protección del instrumento, hay que tapar los prensaestopas de cables que no se utilicen.
- Conecte el módulo al zócalo 3. Consulte [Figura 2](#). El controlador tiene dos zócalos para módulos analógicos (3 y 4). Los zócalos del módulo analógico están conectados internamente con el canal del sensor. Asegúrese de que el módulo analógico y un sensor digital no estén conectados al mismo canal.

Nota: Asegúrese de que solo haya dos sensores conectados al controlador. Aunque hay dos puertos de módulo analógico disponibles, si hay un sensor digital y dos módulos instalados, el controlador solo detectará dos de los tres dispositivos.


- Guarde el conector digital retirado para un posible uso futuro.
- Asegúrese de conectar todos los cables apantallados/de tierra del sensor a los tornillos de tierra de la carcasa del controlador.



Nota: Si el cable del sensor es demasiado corto para conectar el controlador, utilice un cable de conexión y una caja de conexiones para extender la distancia.



Figura 2 Zócalo para módulo amperométrico

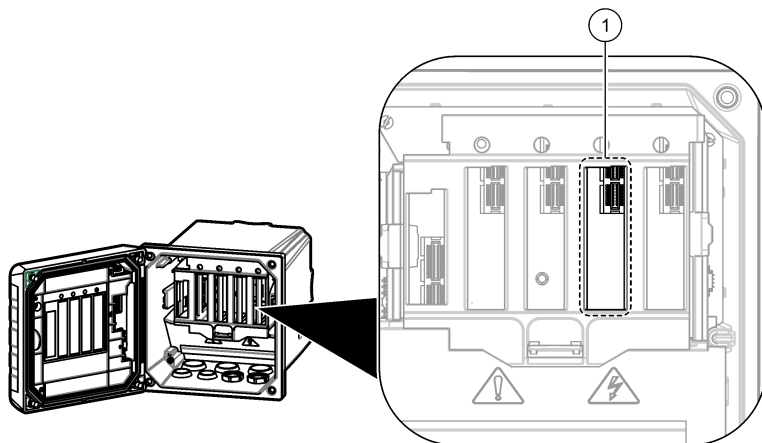


1 Zócalo para módulo analógico — Canal 1

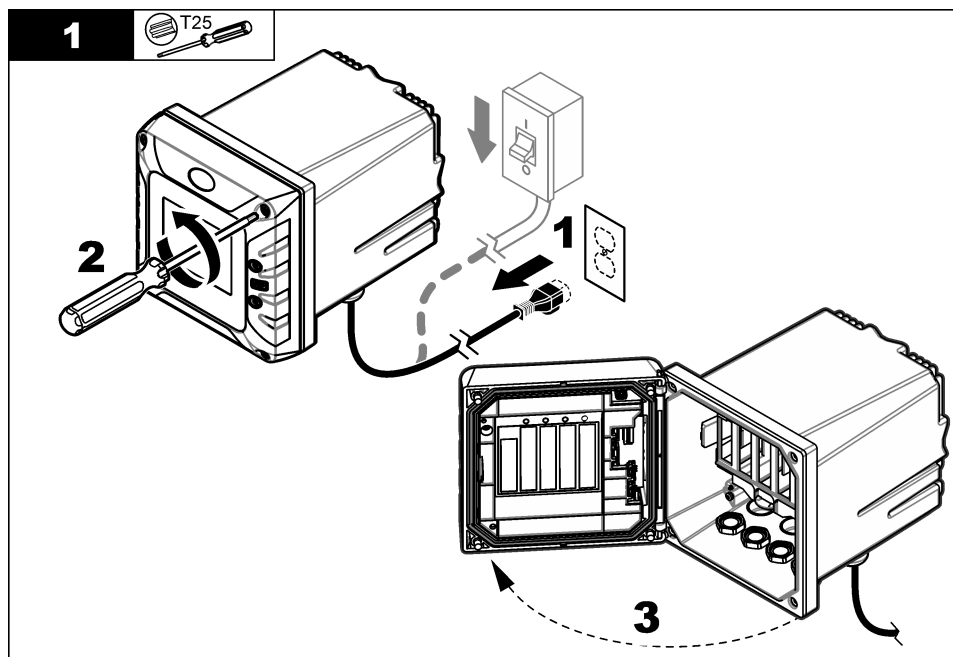

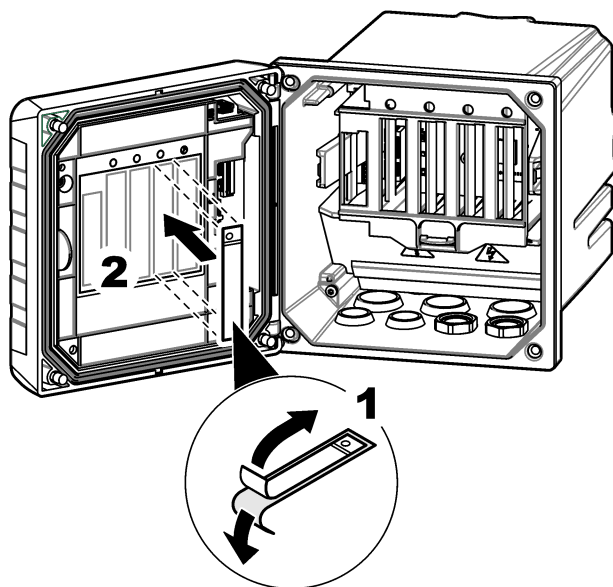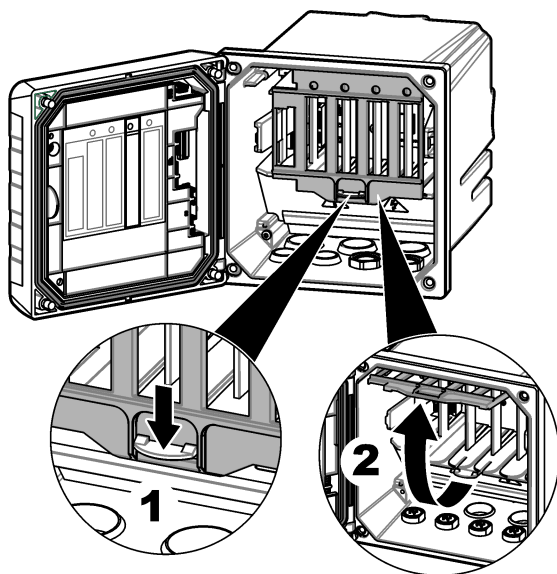2**3**

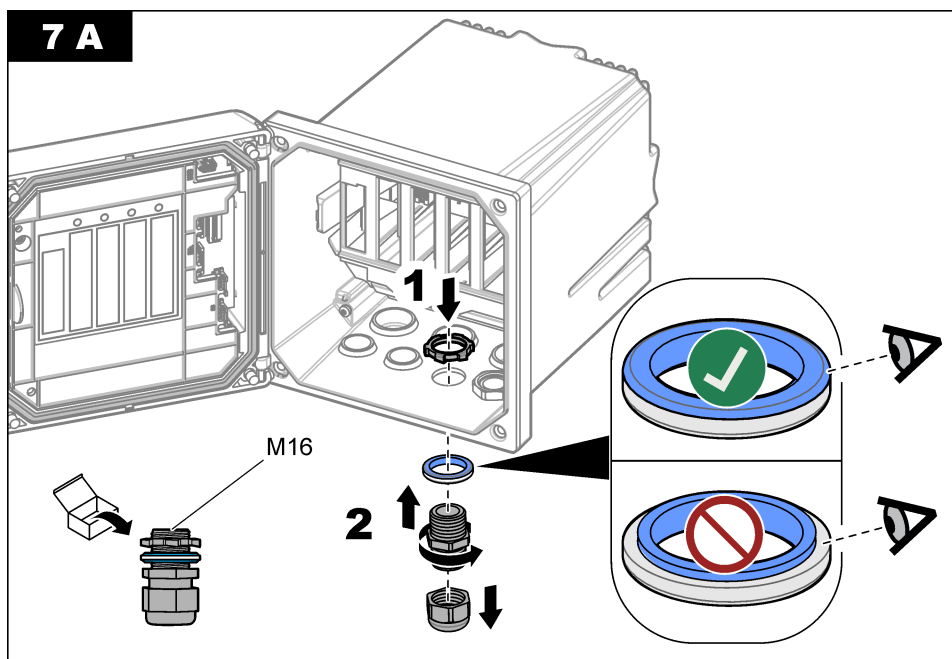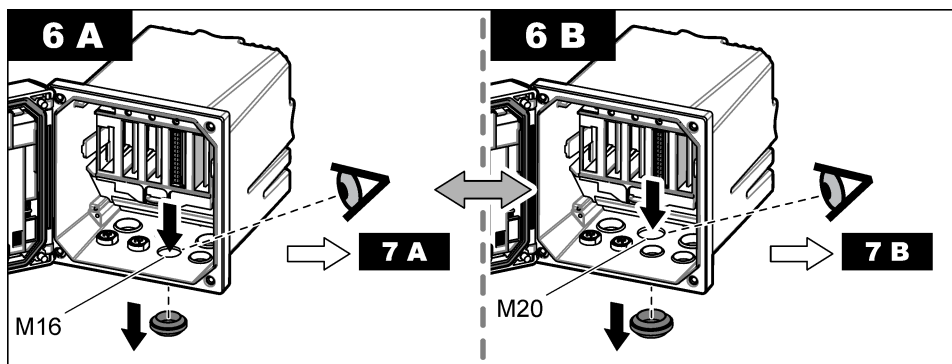

7 B

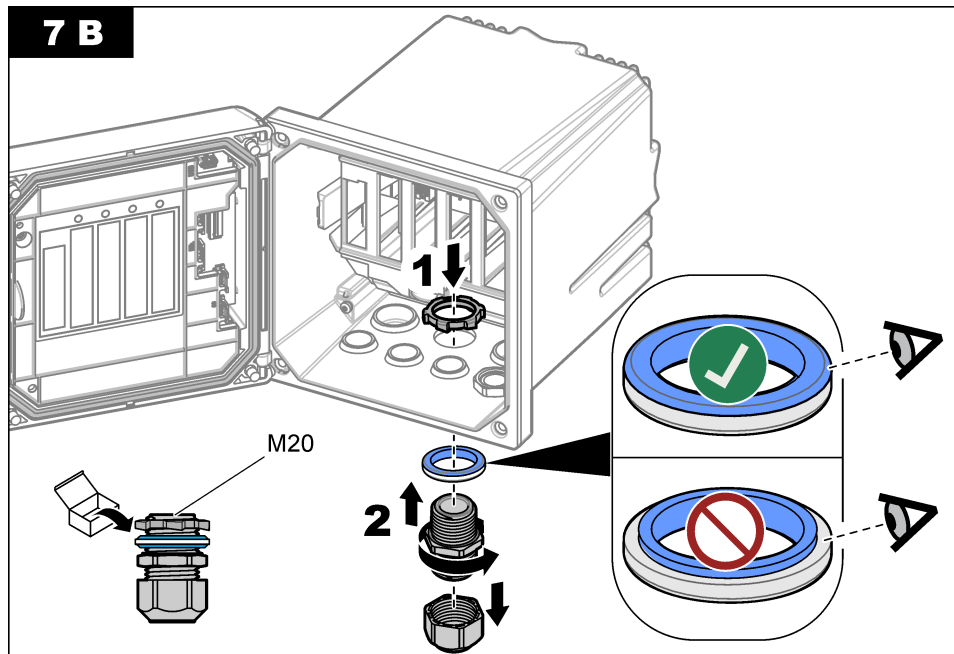

8



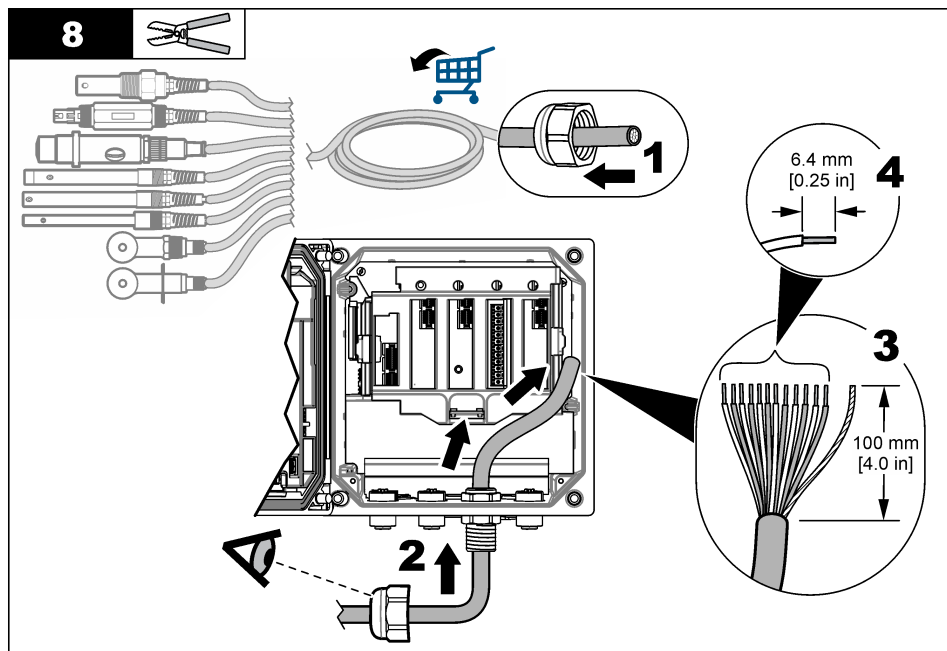




Tabla 2 Cableado del sensor de oxígeno disuelto y de los electrodos de atrapadores de oxígeno

Terminal	Descripción	Oxígeno disuelto	Atrapador de oxígeno
1	Temp +	Negro	Negro
2	Temp -	Azul	Azul
3	—	—	—
4	—	—	—
5	Conexión a tierra	Verde	Verde
6	Tierra	Amarillo	Amarillo
7	—	—	—
8	—	—	—
9	Electrodo de trabajo	Blanco	Blanco
10	Contraelectrodo	Rojo	Gris
11	—	—	Transparente
12	—	—	—

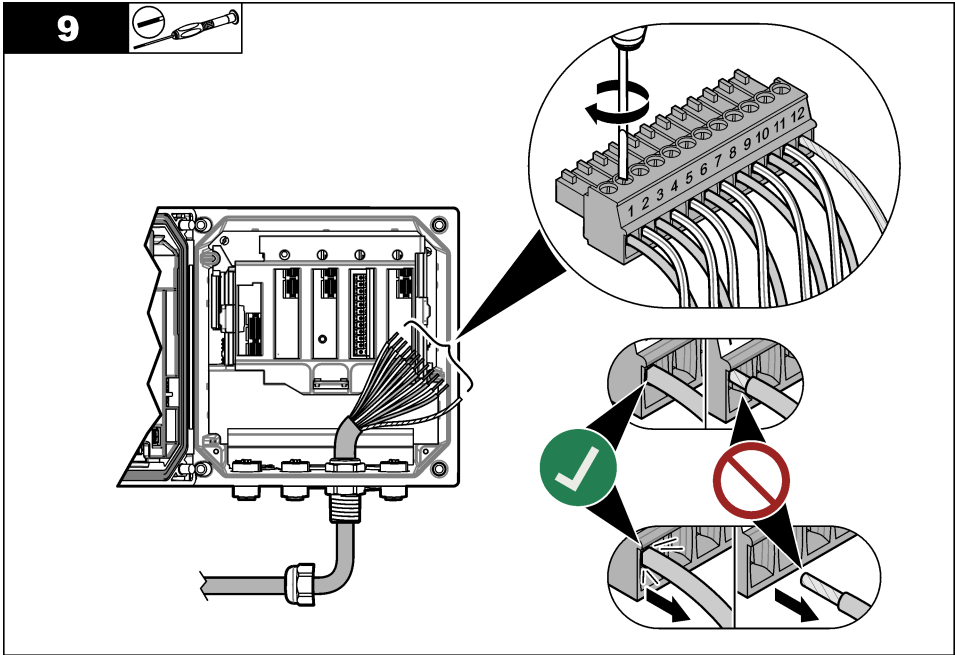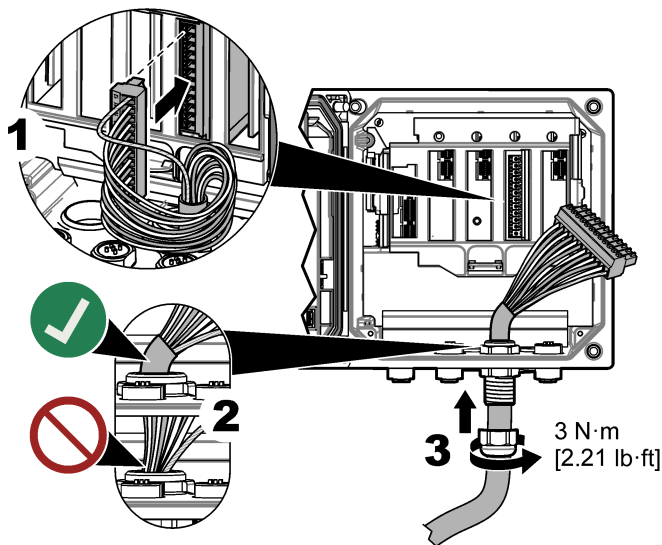

10**11**

T25

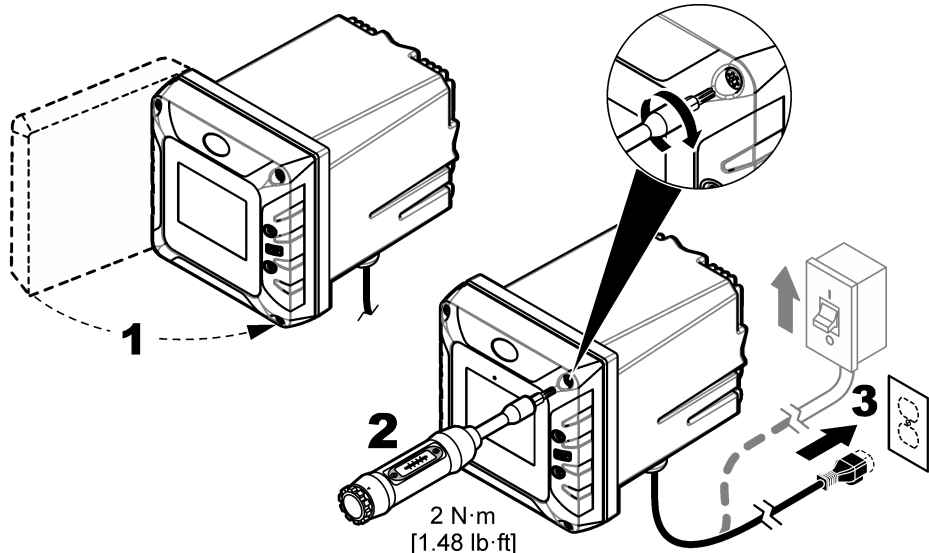

Sección 5 Configuración

Consulte la documentación del instrumento y/o del controlador para obtener instrucciones.

Índice

- 1

Especificações

na página 36
- 2

Informações gerais

na página 36
- 3

Registradores Modbus

na página 38
- 4

Instalação

na página 38
- 5

Configuração

na página 46

Seção 1 Especificações

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

1.1 Sensores de oxigênio dissolvido

Especificação	Detalhes
Faixa de medição	0 a 2 ppm
Sensibilidade	< 0,5 ppb
Repetibilidade	± 0,5 ppb ou ± 2% de medição, o que for maior
Limite de detecção	≤ 1 ppb
Tempo de resposta	31 a 40 ppb: < 30 segundos
Intervalo de medição de temperatura da amostra	0 a 45 °C (32 a 113 °F)

1.2 Eletrodos removedores de oxigênio

Especificação	Detalhes
Faixa de medição	0 a 500 ppb de hidrazina; 0 a 100 ppb de carboidrazida
Sensibilidade	< 0.2 ppb
Repetibilidade	± 1 ppb ou ± 2% de medição, o que for maior
Limite de detecção	≤ 1 ppb
Tempo de resposta	< 60 segundos
Intervalo de medição de temperatura da amostra	5 a 45°C (41 a 113°F)

Seção 2 Informações gerais

Em hipótese alguma o fabricante será responsável por danos resultantes de qualquer uso inadequado do produto ou não cumprimento das instruções contidas no manual. O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações neste manual e nos produtos aqui descritos a qualquer momento, sem aviso ou obrigação. As edições revisadas podem ser encontradas no site do fabricante.

2.1 Informações de segurança

O fabricante não é responsável por quaisquer danos devido ao uso ou aplicação incorreta deste produto, incluindo, sem limitação, danos diretos, acidentais ou consequenciais, e se isenta desses danos à extensão total permitida pela lei aplicável. O usuário é unicamente responsável por identificar riscos críticos de aplicação e por instalar os mecanismos apropriados para proteger os processos durante um possível mau funcionamento do equipamento.

Leia todo o manual antes de tirar da embalagem, montar ou operar esse equipamento. Preste atenção a todos os avisos de perigo e advertência. Caso contrário, o operador poderá sofrer ferimentos graves ou o equipamento poderá ser danificado.

Certifique-se de que a proteção fornecida por este equipamento não seja prejudicada. Não use ou instale este equipamento de qualquer modo diferente do especificado neste manual.

2.1.1 Uso de informações de risco

⚠ PERIGO
Indica uma situação potencial ou iminentemente perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.
⚠ ADVERTÊNCIA
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimento grave.
⚠ CUIDADO
Indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em ferimento leve a moderado.
AVISO
Indica uma situação que, se não evitada, pode causar danos ao instrumento. Informações que necessitam de uma ênfase especial.

2.1.2 Avisos de precaução

Leia todas as etiquetas e rótulos fixados no instrumento. Caso não sejam observados, podem ocorrer lesões pessoais ou danos ao instrumento. Um símbolo no instrumento tem sua referência no manual com uma medida preventiva.

	Este é o símbolo de alerta de segurança. Acate todas as mensagens de segurança que seguem este símbolo a fim de evitar lesões potenciais. Se o símbolo estiver no instrumento, consulte o manual de instruções para obter informações sobre a operação ou segurança.
	Este símbolo indica que existe um risco de choque elétrico ou de eletrocussão.
	Este símbolo identifica a presença de dispositivos sensíveis a Descargas eletrostáticas (ESD) e indica que se deve tomar cuidado para evitar dano ao equipamento.
	Este símbolo indica que o item marcado exige uma conexão terra de proteção. Se o instrumento não for fornecido com um conector ou cabo aterrado, faça o aterramento de proteção na conexão com o terminal condutor de proteção.
	Quando um produto exibir este símbolo, ele indica que o instrumento está conectado a uma corrente alternada.
	O equipamento elétrico marcado com este símbolo não pode ser descartado em sistemas de descarte público ou doméstico europeus. Devolva equipamentos antigos ou no final da vida útil para o fabricante para descarte, sem custo adicional para o usuário.
	Produtos marcados com este símbolo indicam que o produto contém substâncias ou elementos nocivos ou tóxicos. O número dentro do símbolo indica o período de uso de proteção ambiental em anos.

2.2 Ícones usados nas ilustrações

				
Peças fornecidas pelo fabricante	Peças fornecidas pelo usuário	Olhe	Escute	Faça uma destas opções

2.3 Visão geral do produto


O módulo de amperometria ultrapura permite que o controlador SC4500 se conecte a um sensor analógico. O módulo se conecta ao slot 3 no controlador.

Para calibração e operação do sensor, consulte o manual do usuário do instrumento e a documentação do Controlador SC.

2.4 Componentes do produto

Certifique-se de que todos os componentes foram recebidos. Consulte a [Figura 1](#). Se houver itens ausentes ou danificados, entre em contato imediatamente com o fabricante ou com um representante de vendas.

Figura 1 Componentes do produto

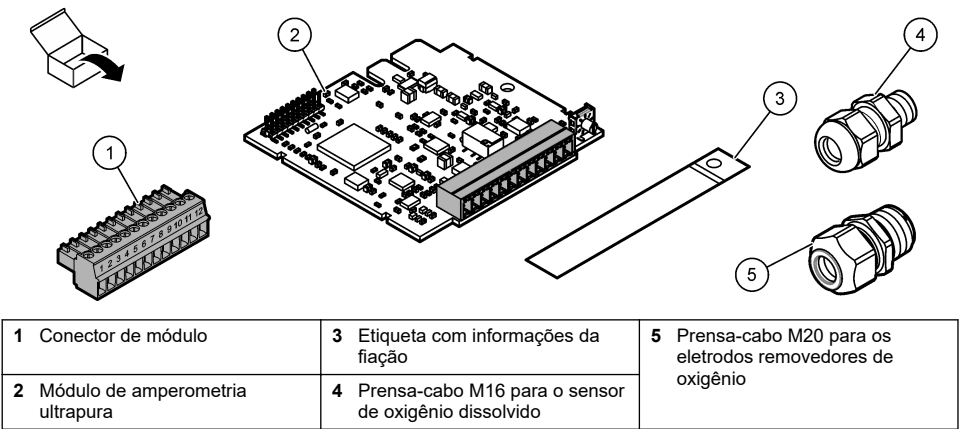

Seção 3 Registradores Modbus

Uma lista de registradores Modbus está disponível para comunicação em rede. Consulte o website do fabricante para obter mais informações.

Seção 4 Instalação

⚠ PERIGO



Vários perigos. Somente pessoal qualificado deve realizar as tarefas descritas nesta seção do manual.

⚠ PERIGO	
	Risco de choque elétrico. Remova a alimentação do instrumento antes deste procedimento começar.

⚠ PERIGO	
	Risco de choque elétrico. Os fios de alta voltagem para o controlador são conduzidos por trás da barreira de alta voltagem no compartimento do controlador. A barreira deve permanecer no local a não ser que um técnico qualificado de instalação esteja instalando os fios de energia, alarmes ou relés.

⚠ ADVERTÊNCIA	
	Risco de choque elétrico. Equipamento conectado externamente deve ter uma avaliação apropriada do padrão de segurança do país.

AVISO	
Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao instrumento de acordo com as exigências locais, regionais e nacionais.	

4.1 Considerações da descarga eletrostática (ESD)

AVISO	
	Dano potencial do instrumento. Componentes eletrônicos internos delicados podem ser danificados devido à eletricidade estática, podendo resultar em degradação do desempenho ou em uma eventual falha.

Consulte as etapas deste procedimento para evitar que a ESD danifique o instrumento:

- Encoste em uma superfície metálica aterrada, como o chassi de um instrumento, um conduíte ou tubo metálico, para descarregar a eletricidade estática do corpo.
- Evite movimentação excessiva. Transporte componentes sensíveis a estática em recipientes ou embalagens antiestáticas.
- Use uma pulseira conectada a um cabo aterrado.
- Trabalhe em uma área protegida de estática com revestimento antiestático no piso e na bancada.

4.2 Instalação do módulo

Para instalar o módulo e conectar o sensor, consulte as etapas ilustradas a seguir: [Figura 2](#) e [Tabela 2](#).

Observações:


- Certifique-se de que o controlador seja compatível com o módulo de amperometria. Entre em contato com o suporte técnico.
- Certifique-se de que o direcionamento do cabo do sensor não fique exposto a altos campos eletromagnéticos (por exemplo, transmissores, motores e equipamento de comutação). A exposição a esses campos pode causar imprecisão nos resultados.
- Para manter a classificação do invólucro, certifique-se de que todos os orifícios de acesso elétrico não utilizados estejam vedados com uma tampa para orifício de acesso.
- Para manter a classificação do invólucro do instrumento, as prensas cabos não utilizadas devem ser conectadas.
- Conecte o módulo ao slot 3. Consulte [Figura 2](#). O controlador tem dois slots de módulo analógico (3 e 4). Os slots do módulo analógico são conectados internamente ao canal do sensor. Certifique-se de que o módulo analógico e o sensor digital não estejam conectados ao mesmo canal.

Observação: Certifique-se de que apenas dois conectores sejam conectados ao controlador. Apensar de haver portas disponíveis para dois módulos analógicos, se um sensor digital e dois módulos analógicos forem instalados, apenas dois dos três dispositivos serão identificados pelo controlador.


- Guarde o conector digital removido para possível uso futuro.
- Certifique-se de conectar todos os fios de blindagem/aterramento do sensor aos parafusos de aterramento da carcaça do controlador.



Observação: Se o cabo do sensor for muito curto para conectar ao controlador, use o cabo de conexão e uma caixa de junção para aumentar a distância.

Figura 2 Slot do módulo de amperometria

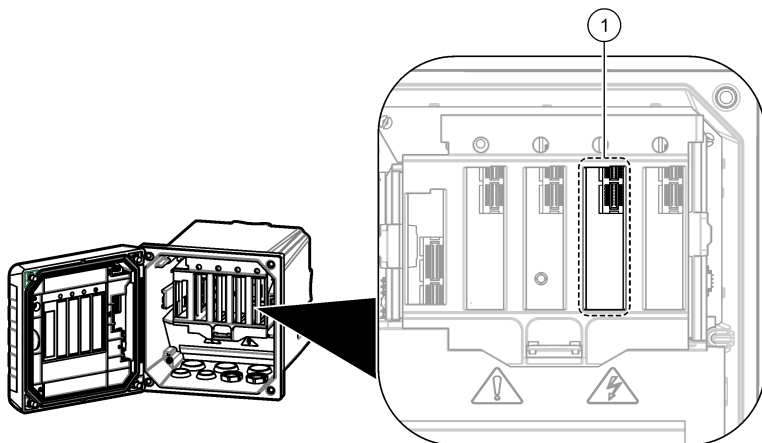


1 Slot do módulo analógico – Canal 1

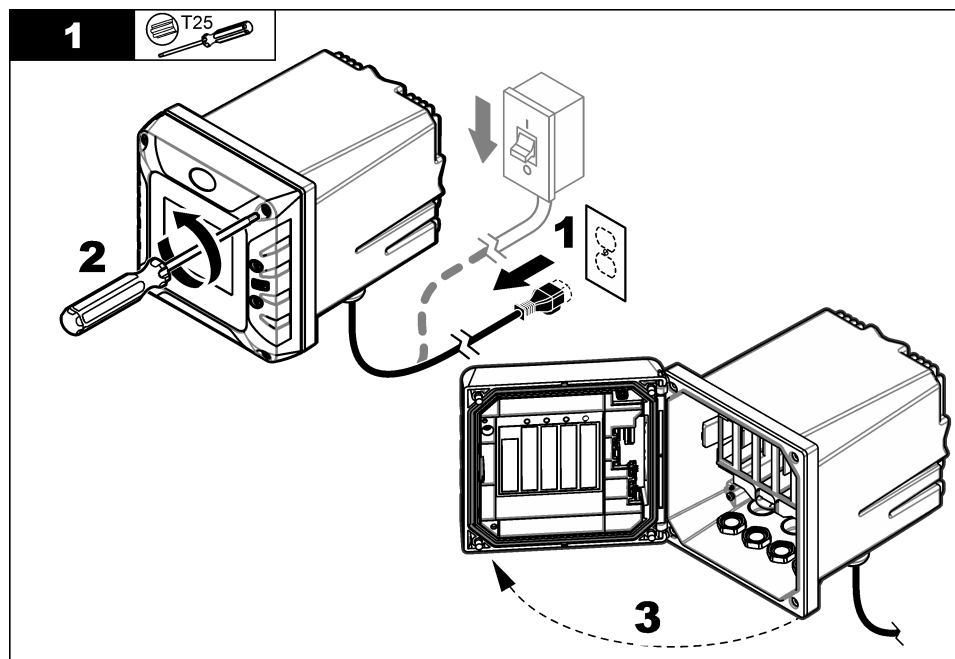

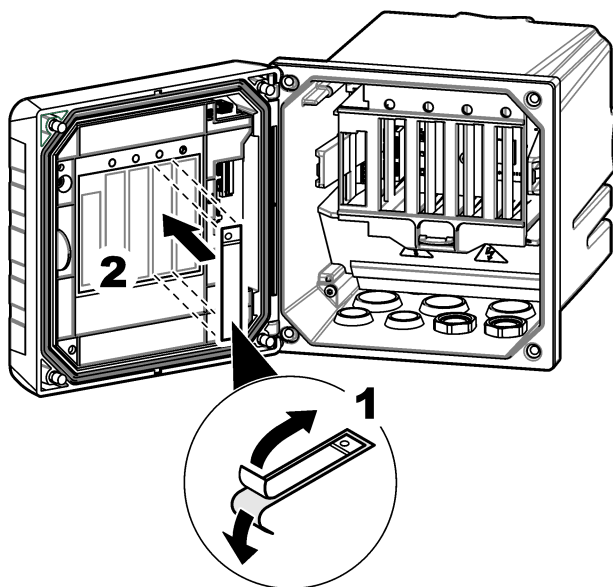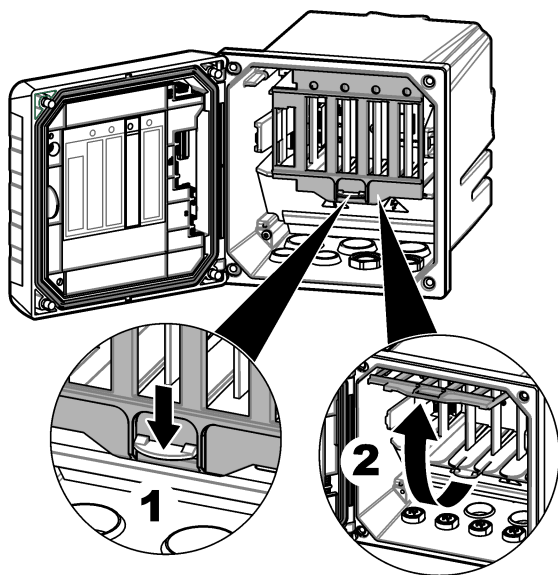2**3**

4

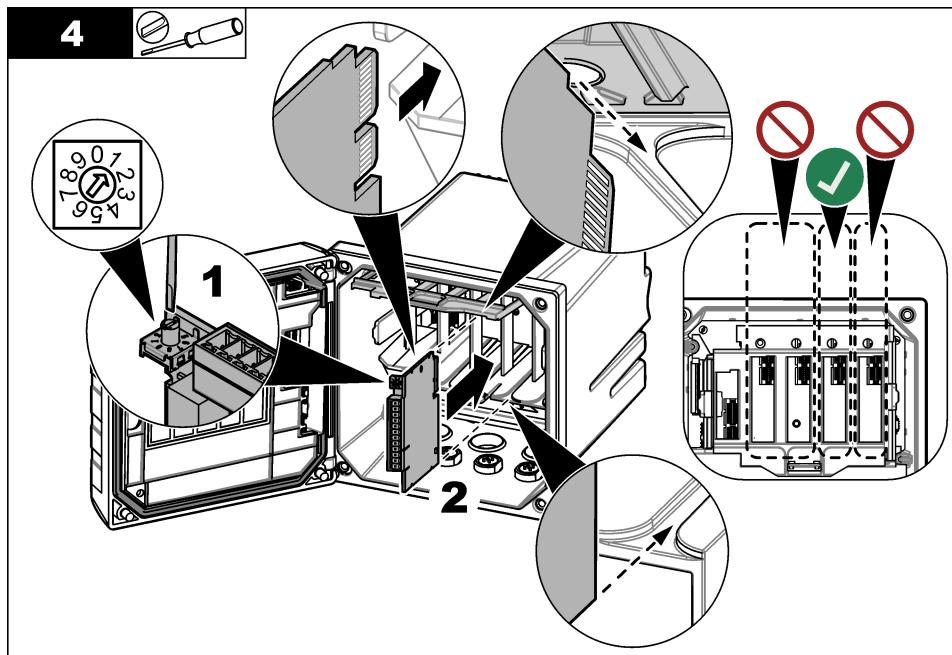




Gire a chave rotativa do módulo para configurar o módulo com base no sensor aplicável. Consulte a [Tabela 1](#).

Tabela 1 Configuração do módulo


Posição da chave rotativa	Tipo de sensor
1	Sensor de oxigênio dissolvido
2	Eletrodos removedores de oxigênio

5

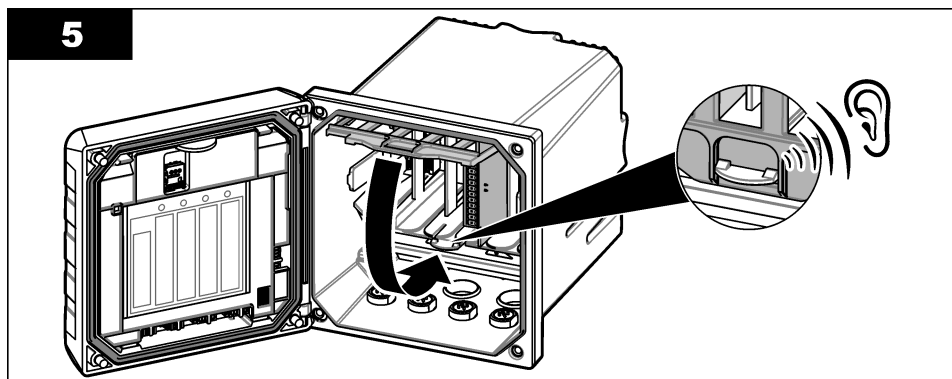

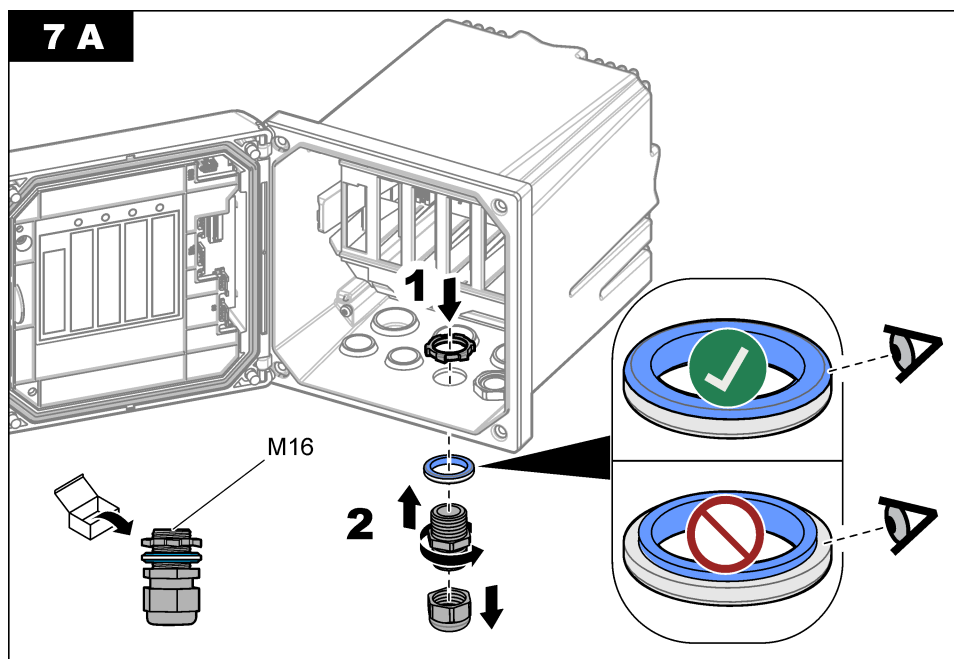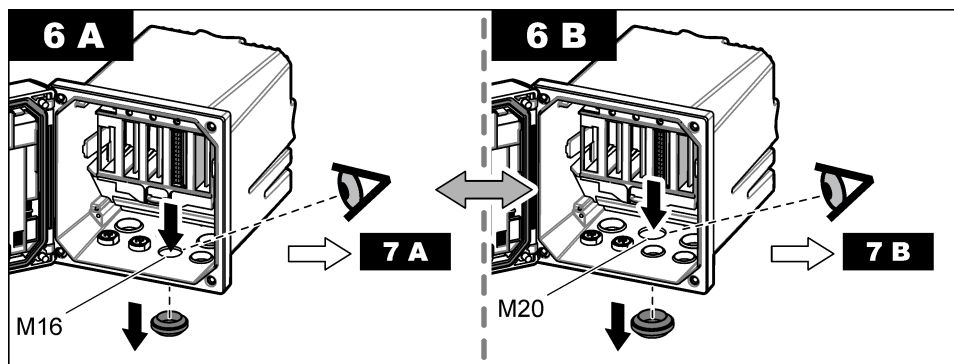

7 B

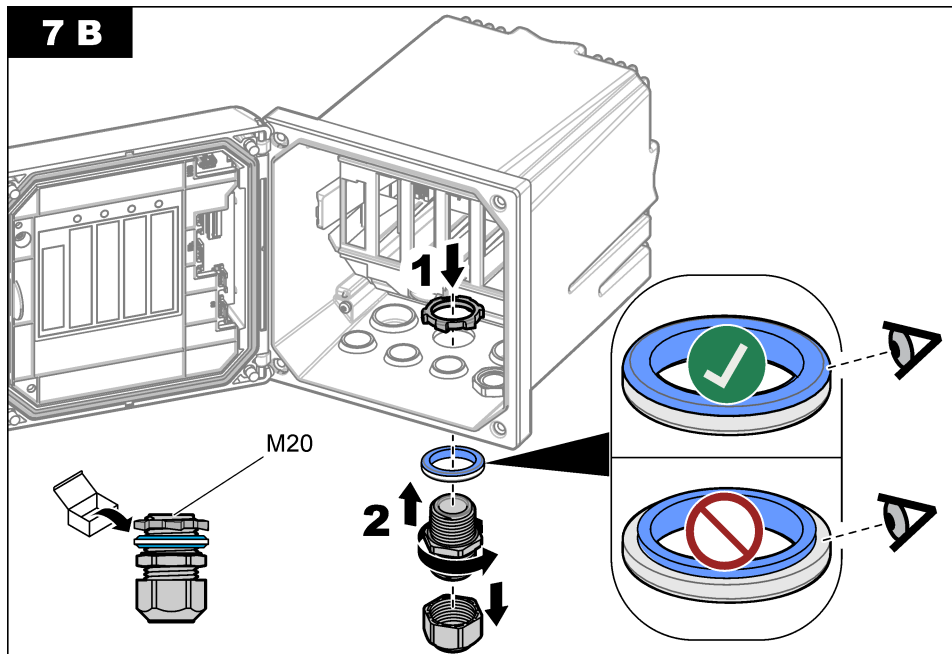

8



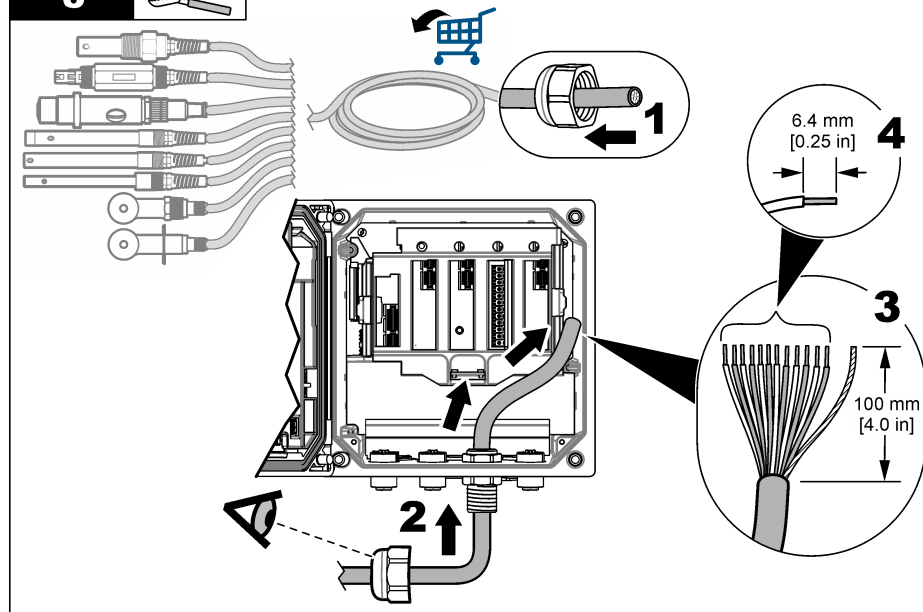


Tabela 2 Fiação dos eletrodos do sensor de oxigênio dissolvido e do absorvedor de oxigênio

Terminal	Descrição	Oxigênio dissolvido	Absorvedor de oxigênio
1	Temp +	Preto	Preto
2	Temp -	Azul	Azul
3	—	—	—
4	—	—	—
5	Aterramento	Verde	Verde
6	Terra	Amarelo	Amarelo
7	—	—	—
8	—	—	—
9	Eletrodo em funcionamento	Branco	Branco
10	Eletrodo do contador	Vermelho	Cinza
11	—	—	Transparente
12	—	—	—

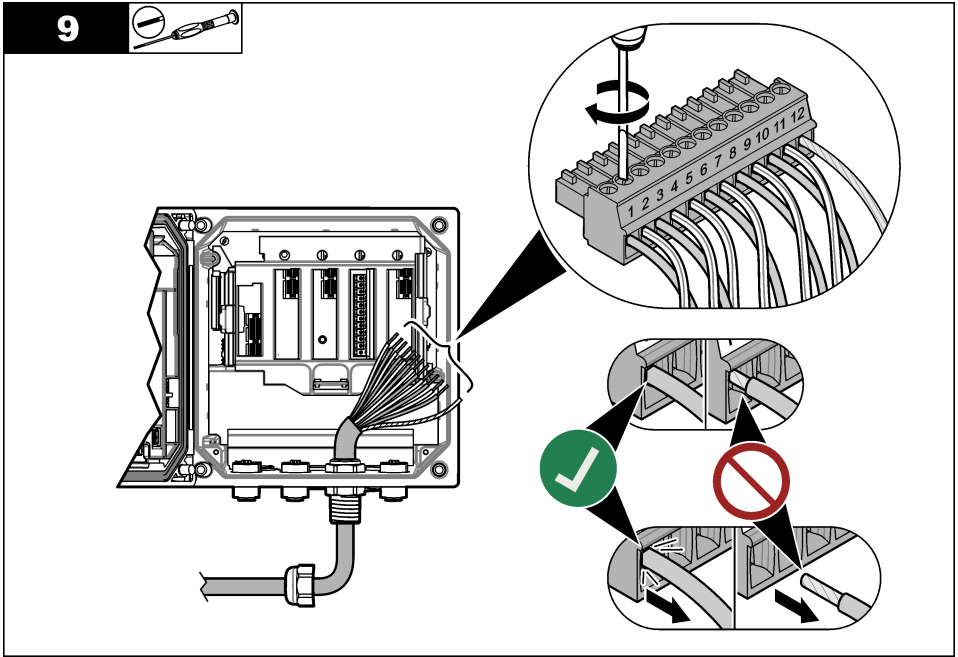

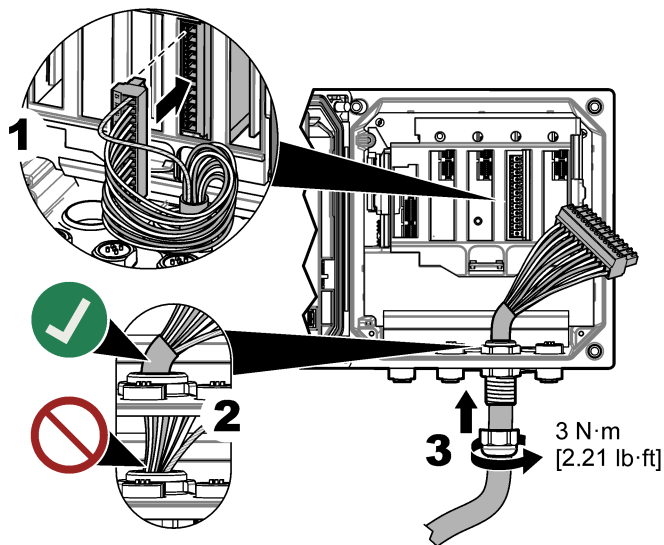

T25



Seção 5 Configuração

Consulte a documentação do instrumento e/ou do controlador para obter instruções.

目录

1 规格	第 47 页	4 安装	第 49 页
2 基本信息	第 47 页	5 配置	第 57 页
3 Modbus 寄存器	第 49 页		

第 1 节 规格

规格如有更改，恕不另行通知。

1.1 溶解氧传感器

规格	详细信息
测量范围	0 至 2 ppm
灵敏度	< 0.5 ppb
重复性	± 0.5 ppb 或测量值的 ± 2%，取二者中较大的数值
检测限值	≤ 1 ppb
响应时间	1 至 40 ppb: < 30 秒
样品温度测量范围	0 至 45 °C (32 至 113 °F)

1.2 氧气清除剂电极

规格	详细信息
测量范围	0—500 ppb 联胺；0—100 ppb 碳酸肼
灵敏度	< 0.2 ppb
重复性	1 ppb 或测量值的 ± 2%，取二者中较大数值
检测限值	≤ 1 ppb
响应时间	< 60 秒
水样温度范围	5 至 45 °C (41 至 113 °F)

第 2 节 基本信息

在任何情况下，对于因产品使用不当或未能遵守手册中的说明而造成的损害，制造商概不负责。制造商保留随时更改本手册和手册中描述的产品的权利，如有更改恕不另行通知或承担有关责任。修订版可在制造商的网站上找到。

2.1 安全信息

对于误用或滥用本产品造成的任何损坏，包括但不限于直接、附带和从属损害，制造商概不负责，并且在适用法律允许的最大范围内拒绝承认这些损害。用户独自负责识别重大应用风险并安装适当的保护装置，以在设备可能出现故障时保护工艺流程。

请在拆开本设备包装、安装或使用前，完整阅读本手册。特别要注意所有的危险警告和注意事项。否则，可能导致操作员受到严重伤害或设备受到损坏。

请确保产品拆开时的完整无损。请勿以本手册指定方式之外的其它方式使用或安装本设备。

2.1.1 危害指示标识说明

▲ 危险
表示潜在的或紧急的危险情况，如果不加以避免，将会导致死亡或严重伤害。


⚠ 警告
表示潜在的或紧急的危险情况，如果不加以避免，将会导致死亡或严重伤害。
⚠ 警告
表示潜在的危险情形，可能导致轻度或中度人身伤害。
注意
表明如不加以避免可能会导致仪器损坏的情况。此信息需要特别强调。

2.1.2 警示标签

请阅读贴在仪器上的所有标签和标记。如未遵照这些安全标签的指示操作，则可能造成人身伤害或仪器损坏。仪器上的符号在手册中通过警告说明参考。

	这是安全警报标志。请遵守此标志后面的所有安全信息，以避免可能造成的伤害。如果仪器上有此标志，则请参见仪器手册，了解操作或安全信息。
	此标志指示存在电击和/或触电死亡危险。
	此标志指示存在静电释放（ESD）敏感的设备，且必须小心谨慎以避免设备损坏。
	此标志指示标记的项目需要保护性接地连接。如果仪器的电绳没有随附接地式插头，需确保保护导体端子连接了保护接地连接。
	产品上出现该符号时，表明仪器已连接交流电。
	标有此符号的电气设备在欧洲不能通过家庭或公共垃圾系统进行处理。请将老旧或报废设备寄回至制造商处进行处置，用户无需承担费用。
	带有该符号的产品表明该产品包含有毒或危险的物质或成分。该符号内的数字表明环保使用期限(年)。

2.2 插图中使用的图标

				
制造商 提供的零件	用户提供的零件	查看	聆听	请选择其中一个 选项


2.3 产品概述

超纯电流分析模块允许 SC4500 控制器连接至模拟模块。模块连接至控制器中的插槽 3。
关于传感器的校准和操作，请参阅仪器用户手册和 SC 控制器文件。

2.4 产品部件

确保已收到所有部件。请参见图 1。如有任何物品缺失或损坏，请立即联系制造商或销售代表。

图 1 产品部件

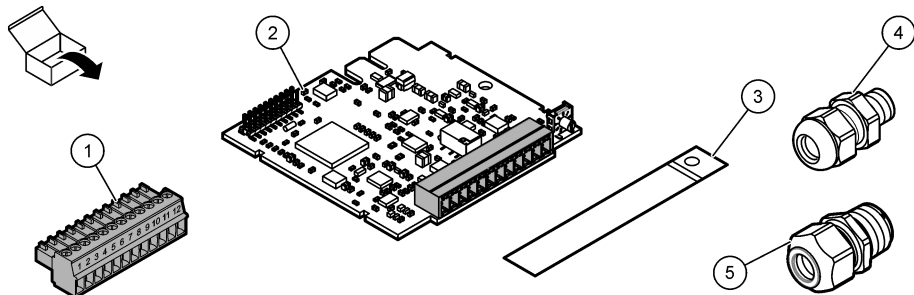

1 模块连接器	3 包含接线信息的标签	5 氧气清除剂电极 M20 电缆接头
2 超纯电流分析模块	4 用于溶解氧传感器的 M16 电缆接头	

第 3 节 Modbus 寄存器

Modbus 寄存器列表可供网络通信使用。请参阅制造商的网站了解更多信息。

第 4 节 安装

⚠ 危险



多重危险。只有符合资质的专业人员才能从事文档本部分所述的任务。

⚠ 危险



电击致命危险。开始本步骤之前，断开仪器的电源。

⚠ 危险



电击致命危险。控制器的高压线引至控制器外壳内高压防护层的后面。除非具备资格的安装人员正在进行电源、警报器或继电器接线，否则高压防护层必须保持在位。

⚠ 警告



电击危险。外部连接的设备必须通过适用的国家安全标准评估。

注意

确保按照当地、地区及国家的要求将设备连接到仪器。

4.1 静电放电 (ESD) 注意事项

注意



可能导致仪器损坏。静电会损害精密的内部电子元件，从而导致仪器性能降低或最终出现故障。

请参阅此流程中的步骤以防止 ESD 损坏仪器：

- 触摸接地金属表面（如仪器外壳、金属导管或管道），泄放人体静电。
- 避免过度移动。运送静电敏感的元件时，请使用抗静电容器或包装。
- 配戴连接到接地线缆的腕带。
- 使用抗静电地板垫和工作台垫，以使工作区具备静电安全性。

4.2 安装模块


要安装模块并连接传感器，请参阅下文图示步骤图 2 和表 2。

注意：



- 确保控制器与电流分析模块兼容。请联系技术支持部门。
- 确保传感器电缆的布线避开高频电磁场（例如发射器、电机和交换机）。如果线路经过这些地方可能引起结果不准确。
- 为了保持外壳防护等级，确保用检修孔盖封住所有未使用的电气检修孔。
- 为了保持仪器的外壳防护等级，必须塞住未使用的电缆封套。
- 将模块连接至插槽 3，请参阅图 2。控制器有两个模拟模块插槽（3 和 4）。模拟模块插槽在内部连接到传感器通道。确保模拟模块和数字传感器未连接到同一通道。
注： 确保仅有两个传感器连接至控制器。尽管有两个模拟模块端口可用，但如果安装了数字传感器和两个模块，则控制器只能检测到三台设备中的两台。
- 保留拆下的数字连接器以供日后使用。
- 确保将所有传感器接地/屏蔽线连接到控制器的外壳接地螺丝。

注： 如果传感器线缆太短，无法连接至控制器，则使用连接线缆和接线盒以延长距离。


图 2 电流分析模块插槽

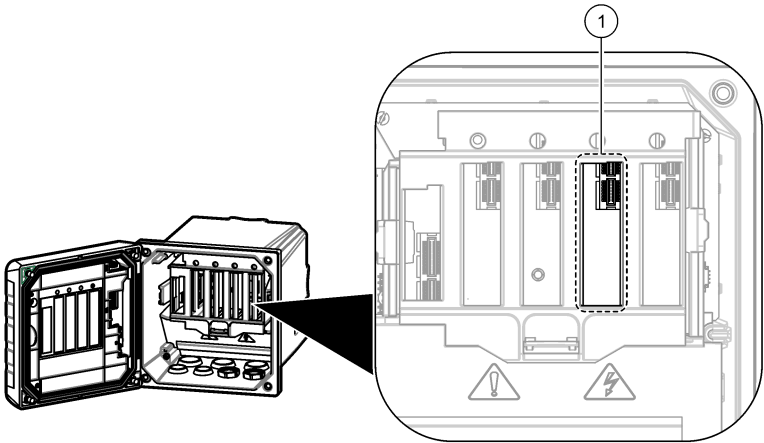


1 模拟模块插槽 — 通道 1

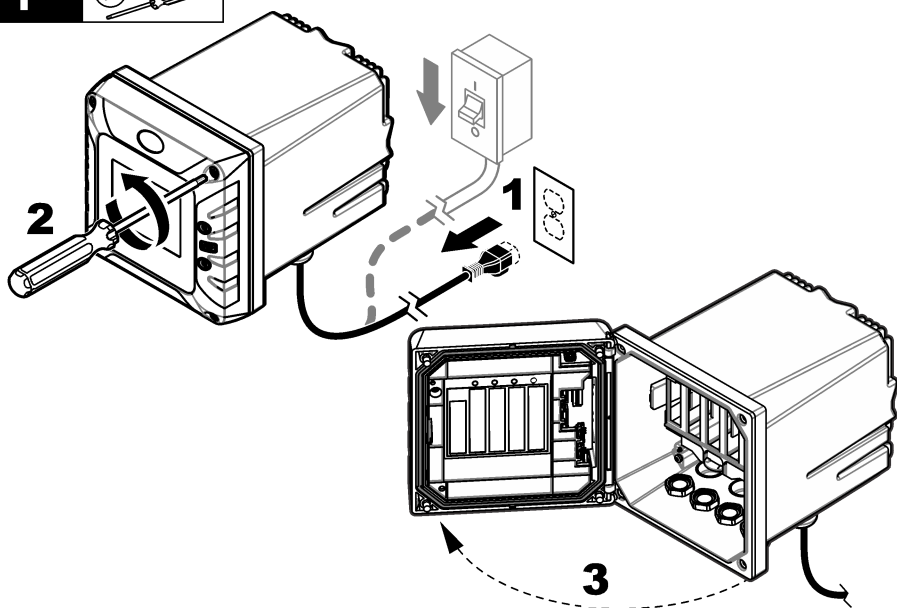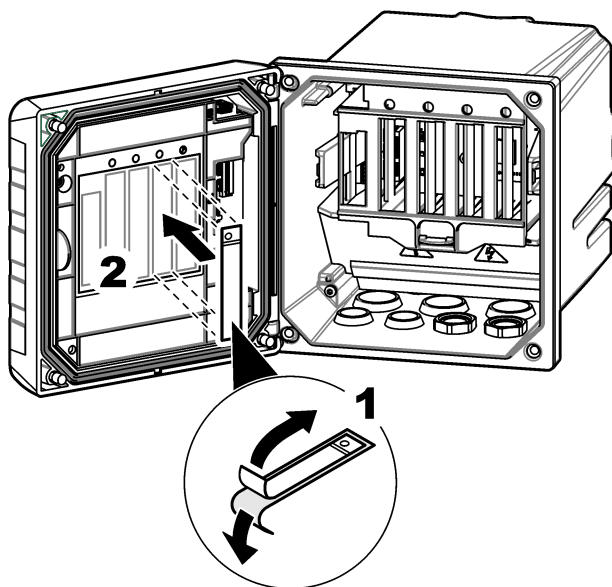1**2**

3

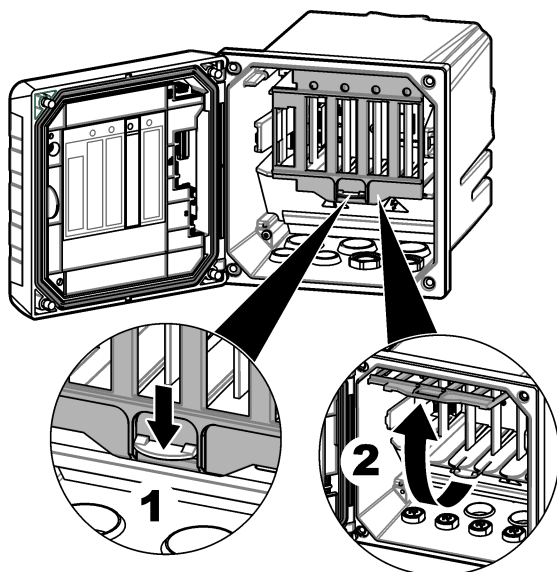



4

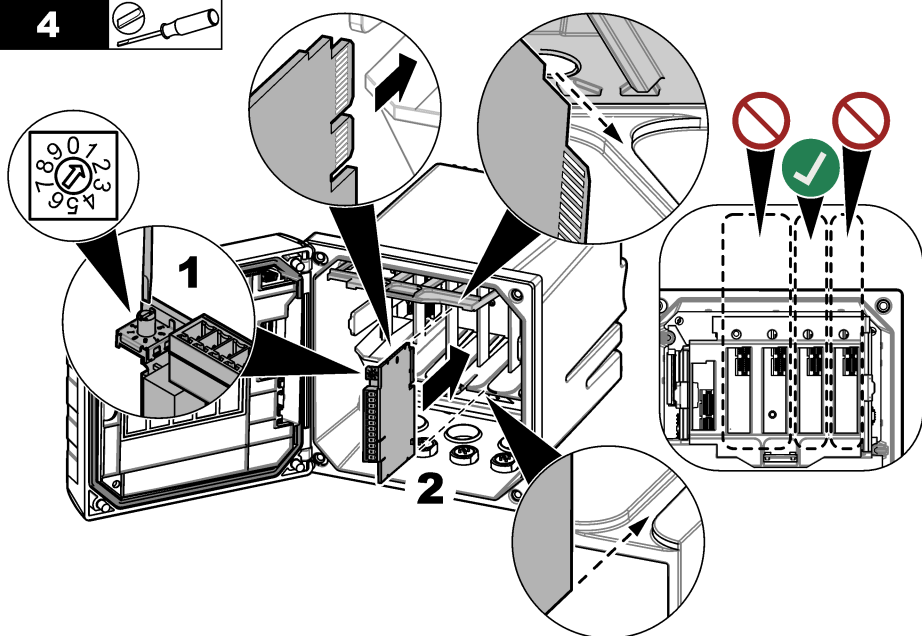


转动模块的旋转开关，根据适用的传感器配置模块。请参阅 [表 1](#)。

表 1 模块配置


开关位置	传感器类型
1	溶解氧传感器
2	氧气清除剂电极

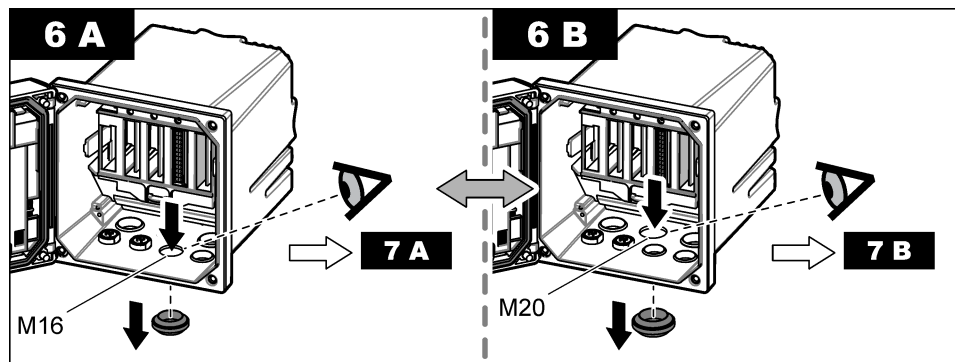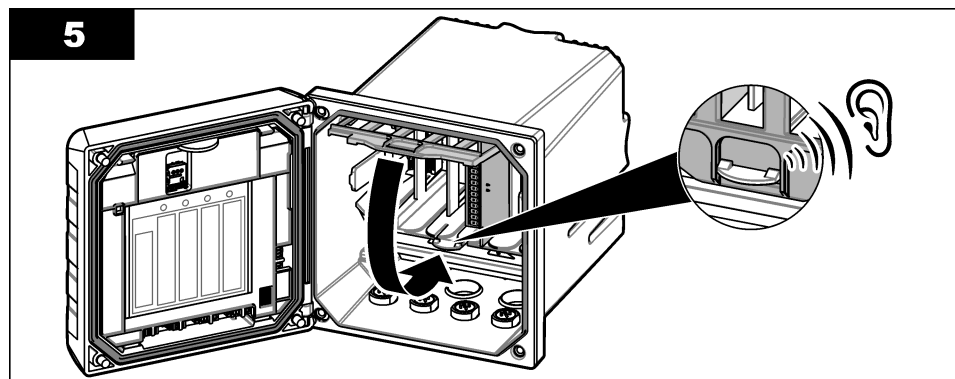

7 A

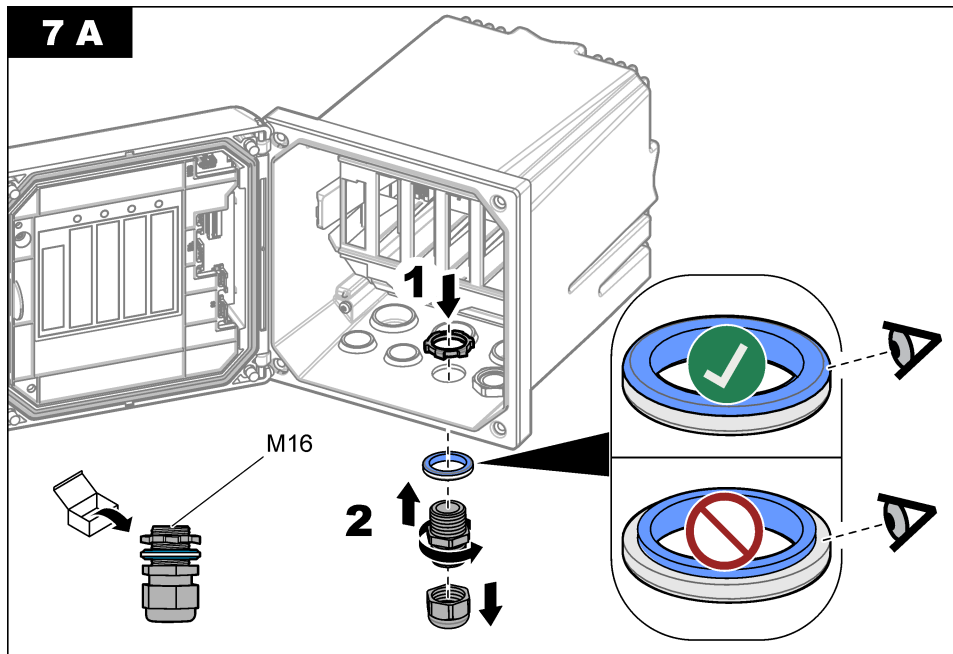

7 B

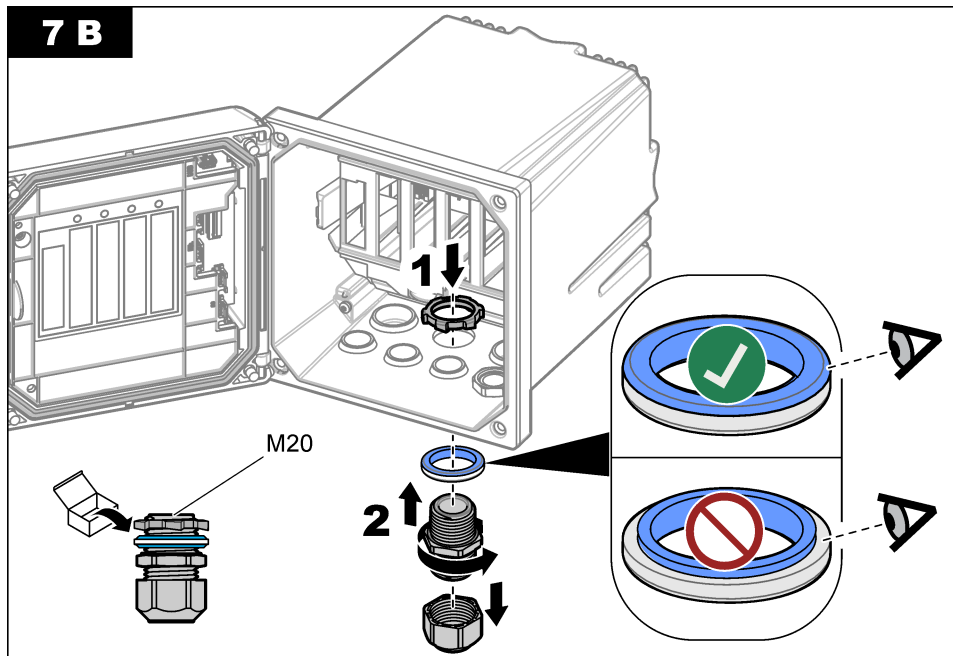



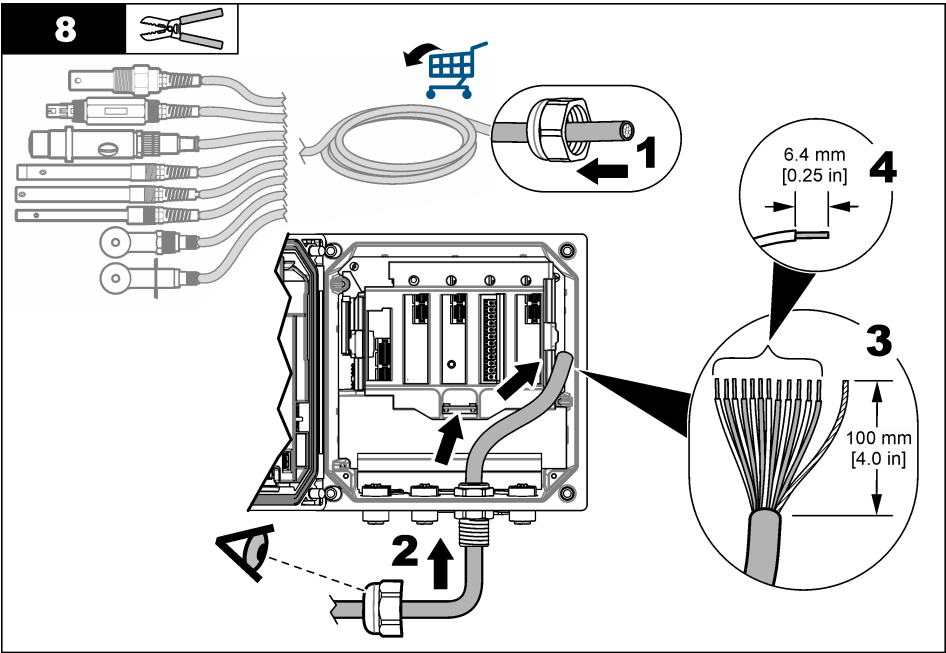



表 2 溶解氧传感器和氧气清除器电极接线


端子	说明	溶解氧	除氧剂
1	温度 +	黑色	黑色
2	温度 -	蓝色	蓝色
3	—	—	—
4	—	—	—
5	接地	绿色	绿色
6	接地	黄色	黄色
7	—	—	—
8	—	—	—
9	工作电极	白色	白色
10	对电极	红色	灰色
11	—	—	透明
12	—	—	—

9

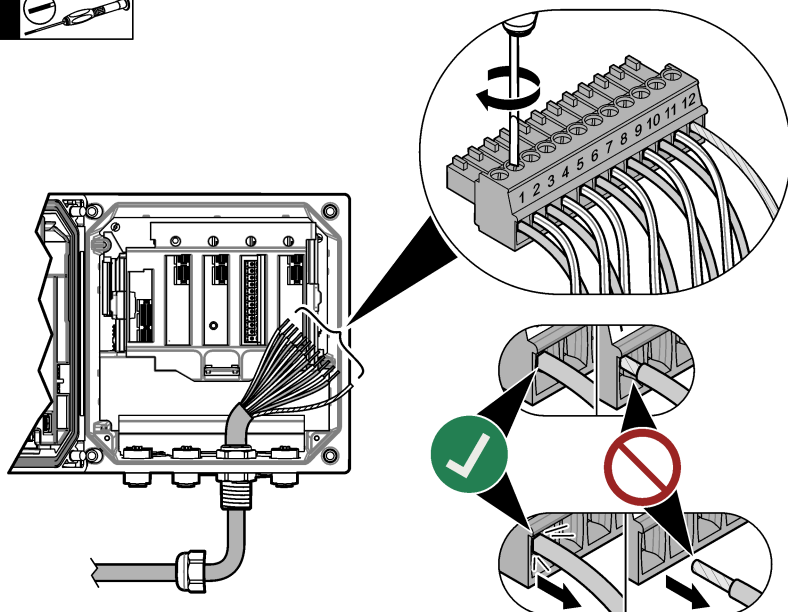

10

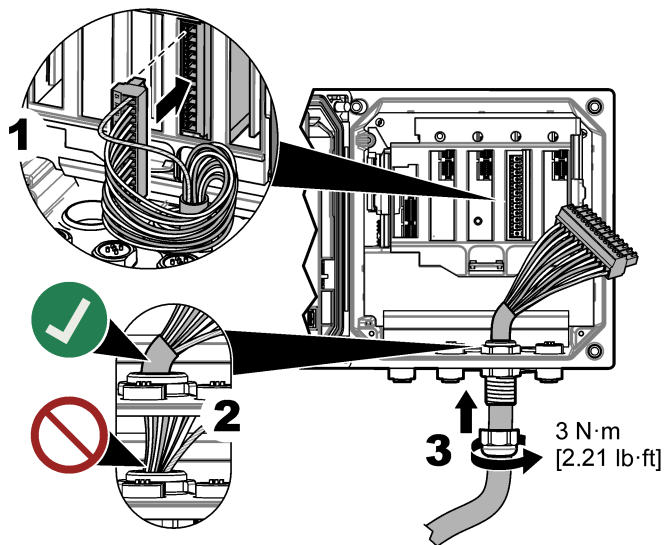

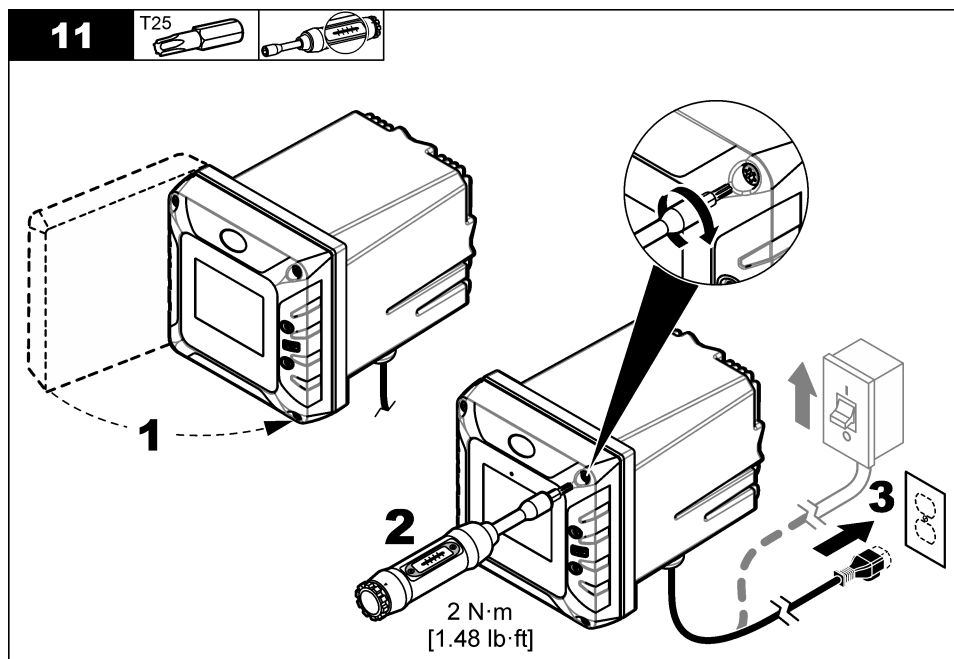

第 5 节 配置

有关说明，请参阅仪器和/或控制器文档。

目次

1 仕様	58 ページ
2 一般情報	58 ページ
3 Modbus レジスタ	60 ページ

4 設置	60 ページ
5 構成	68 ページ

第 1 章 仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

1.1 溶存酸素センサ

仕様	詳細
測定範囲	0 ～ 2 ppm
分解能	< ±0.5 ppb
繰り返し性	測定値の ± 0.5 ppb または ± 2% のいずれか大きい値
検出限界	≤ 1 ppb
応答時間	1 ～ 40 ppb: < 30 秒
サンプル温度測定範囲	0～45 °C (32～113 °F)

1.2 脱酸素剤電極

仕様	詳細
測定範囲	0～500 ppb ヒドラジン、0～100 ppb カルボヒドラジド
分解能	< 0.2 ppb
繰り返し性	測定値の ± 1 ppb または ± 2% のいずれか大きい値
検出限界	≤ 1 ppb
応答速度	< 60 秒
サンプル温度測定範囲	5 ～ 45 °C (41 ～ 113 °F)

第 2 章 一般情報

いかなる場合も、製造元は、製品の不適切な使用またはマニュアルの指示に従わなかったことに起因する損害について責任を負いません。製造元は、通知または義務なしに、随時本マニュアルおよび製品において、その記載を変更する権利を有します。改訂版は、製造元の Web サイト上にあります。

2.1 安全情報

メーカーは、本製品の目的外使用または誤用に起因する直接損害、偶発的損害、結果的損害を含むあらゆる損害に対して、適用法で認められている範囲で一切責任を負わないものとします。ユーザーは、適用に伴う危険性を特定したり、装置が誤作動した場合にプロセスを保護するための適切な機構を設けることに関して、全責任を負うものとします。

この機器の開梱、設定または操作を行う前に、このマニュアルをすべてよく読んでください。危険、警告、注意に記載されている内容をよく読み、遵守してください。これを怠ると、使用者が重傷を負う可能性、あるいは機器が損傷を受ける可能性があります。

この機器による保護機能が損なわれていないことを確認してください。この装置は本マニュアルで指定されている方法以外の方法で使用したり、取り付けたりしないでください。

2.1.1 危険情報

▲ 危険
回避しないと死亡または重傷につながる潜在的または切迫した危険な状況を示します。
▲ 警告
回避しなければ、死亡または重傷につながるおそれのある潜在的または切迫した危険な状況を示します。
▲ 注意
軽傷または中程度のけがをする事故の原因となる可能性のある危険な状況を示します。
告知
回避しなければ、本製品を損傷する可能性のある状況や、特に強調したい情報を示します。特に強調する必要がある情報。

2.1.2 予防ラベル

測定器上に貼付されたラベルや注意書きを全てお読みください。これに従わない場合、人身傷害や装置の損傷につながるおそれがあります。測定器に記載されたシンボルは、使用上の注意と共にマニュアルを参照してください。

	これは安全警報シンボルです。潜在的な障害を避けるためにこのシンボルのすべて安全メッセージに従ってください。装置上では、作業または安全情報に関しては取り扱い説明書を参照してください。
	このシンボルは感電の危険があり、場合によっては感電死の原因となる恐れのあることを示しています。
	このシンボルは、静電気放電 (ESD) に敏感なデバイスがあることと、機器の破損を防止する措置をとる必要があることを示しています。
	このシンボルは、印の付いたアイテムに保護アース接続が必要であることを示します。装置付属のコードに接地プラグがない場合は、保護導体端子に保護アースを接続してください。
	この記号が製品に付いている場合、装置が交流電源に接続していることを示しています。
	このシンボルが付いている電気機器は、ヨーロッパ域内または公共の廃棄処理システムで処分できません。古くなったり耐用年数を経た機器は、廃棄するためにメーカーに無償返却してください。
	この記号がついている製品は、製品が毒性または有害の物質または成分を含むことを示しています。記号の中にある数字は、環境保護使用期間 (年) を示します。

2.2 イラストで使用されているアイコン

				
メーカー 供給部品	ユーザー準備部品	見る	聞く	これらの一つを実行する

2.3 製品概要


超純水アンペロメトリーモジュールにより SC4500 変換器をアナログ検出器に接続します。変換器でモジュールをスロット 3 に接続します。

検出器の校正および操作については、装置の取扱説明書および SC 変換器の関連資料を参照します。

2.4 構成部品

すべての構成部品が届いていることを確認してください。図 1 を参照してください。構成部品に不足や損傷がある場合は、直ちに取扱い販売代理店にお問い合わせください。

図 1 製品構成部品

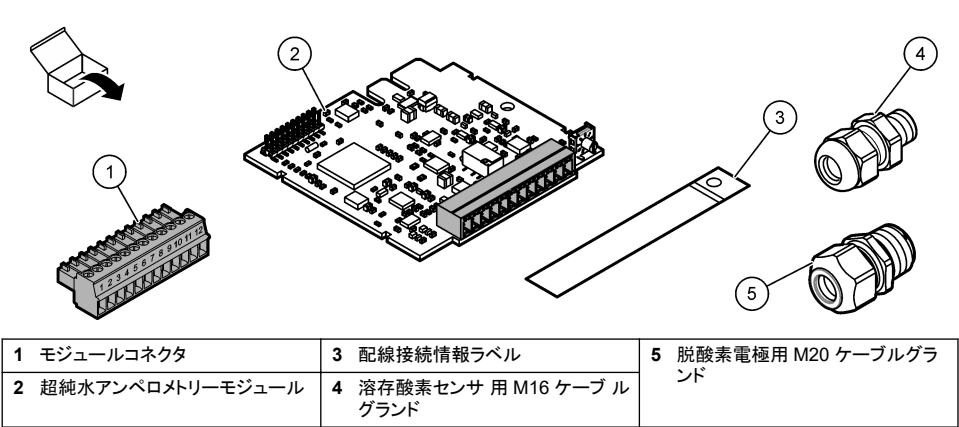

第 3 章 Modbus レジスタ

ネットワーク通信用に Modbus レジスタのリストを用意しています。詳細は、メーカーの Web サイトを参照してください。

第 4 章 設置

▲ 危険	
	複合的な危険。本書のこのセクションに記載されている作業は、必ず資格のある作業員が行う必要があります。
▲ 危険	
	感電死の危険。この手順を開始する前に、装置の電源を切ってください。

⚠ 危険



感電死の危険。変換器の高電圧配線は、変換器筐体の高電圧防護壁の後ろに施されます。この防護壁は、資格のある取り付け技術者が電源、アラーム、接点出力ための配線を取り付けていない限り同じ場所に置いておいてください。

⚠ 警告



電気ショックの危険。外部接続された機器には、該当する国の安全標準評価が必要です。

告知

地域、地方および国の要件に従って機器が装置に接続されていることを確認してください。

4.1 静電気放電(ESD)への配慮

告知



装置の損傷の可能性。静電気による装置内部の精密な電子部品の破損により、装置の性能低下や故障を招く恐れがあります。

以下の手順を参照して、ESD による装置の損傷を回避してください。

- 機器のシャーシ、金属製導管/パイプなど、接地された金属の表面を触り、体から静電気を放電します。
- 過度な移動を避けます。静電気に敏感なコンポーネントは静電気防止コンテナや包装材料内に入れて運搬してください。
- 接地線で接続したリストストラップを身に付けます。
- 静電気防止フロアパッドおよび作業台パッドを用意し、静電気が発生しない場所で作業します。

4.2 モジュールの取り付け


モジュールの取付およびセンサ接続方法は、図に示したステップ [図 2](#) および [表 2](#) を参照します。

注:


- 変換器がアンペロメトリーモジュールと互換性があることを確認します。技術サポートにお問い合わせください。
- センサケーブルは、強い電磁界(トランスミッター、モーター、スイッチング装置など)へのばく露を避けるように配線してください。電磁界へのばく露は精度に影響を与えることがあります。
- 保護等級を維持するために、使用していないすべての電気アクセスホールがアクセスホールカバーで閉じられていることを確認してください。
- 装置の筐体保護等級を維持するには、未使用のケーブルグラウンドにプラグの取り付けが必要です。
- スロット 3 にモジュールを接続します。 [図 2](#) を参照してください。2 ヶ所のアナログモジュールスロット (3 および 4) があります。アナログモジュールスロットは、検出器チャンネルに内部接続されています。いずれかに差し込み取付けます。
注: 検出器 2 つのみが変換器に接続されていることを確認してください。1 つのデジタル検出器と 2 つのモジュールが接続された場合は、2 つの検出器の測定値しか表示されません。
- 取り外したデジタルコネクタは、デジタル検出器使用時のために保管しておいてください。
- すべてのセンサ接地/シールドワイヤを変換器筐体の接地ねじに接続してください。



注: 検出器ケーブルの長さが足りず変換器に接続できない場合は、接続ケーブルおよび接続ボックスを使用して延長してください。

図 2 アンペロメトリーモジュールスロット

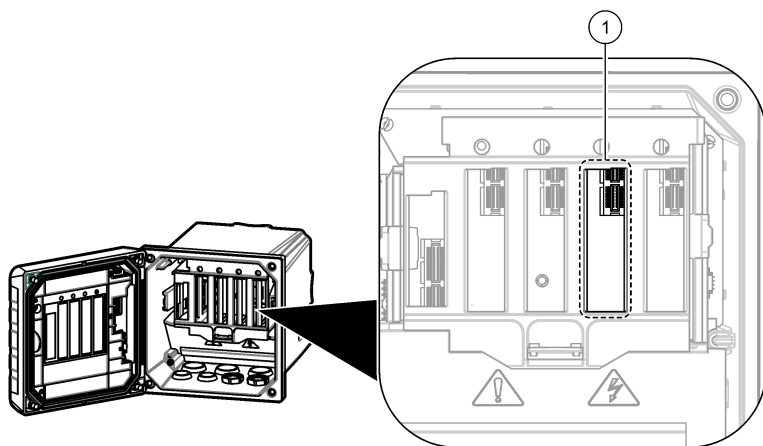


1 アナログモジュールスロット—チャンネル 1

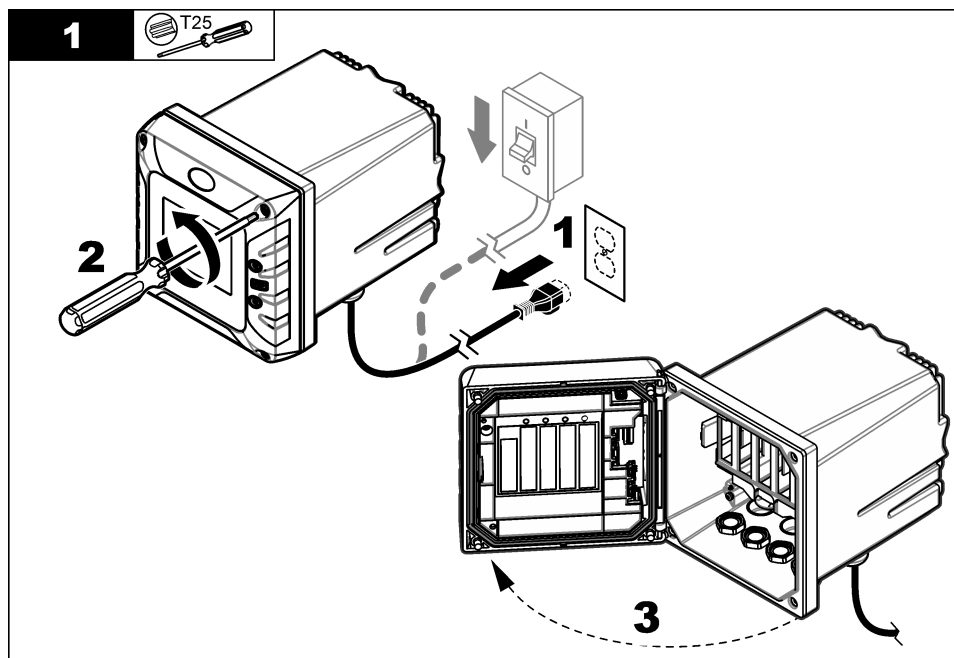

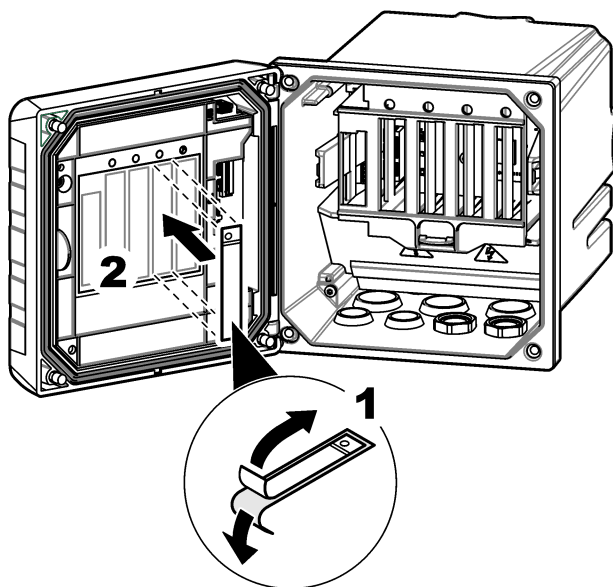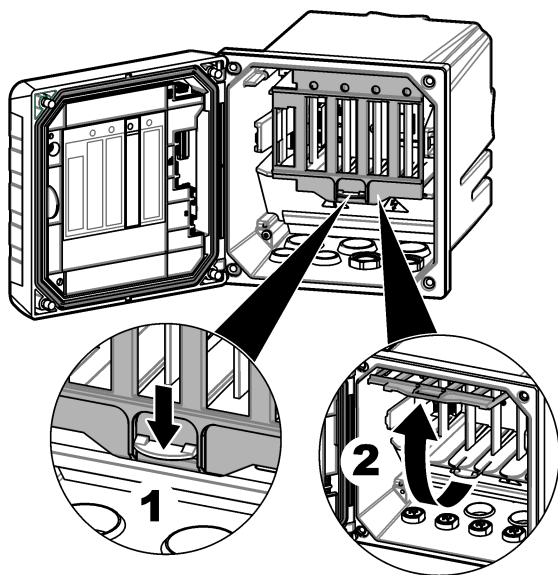2**3**

4

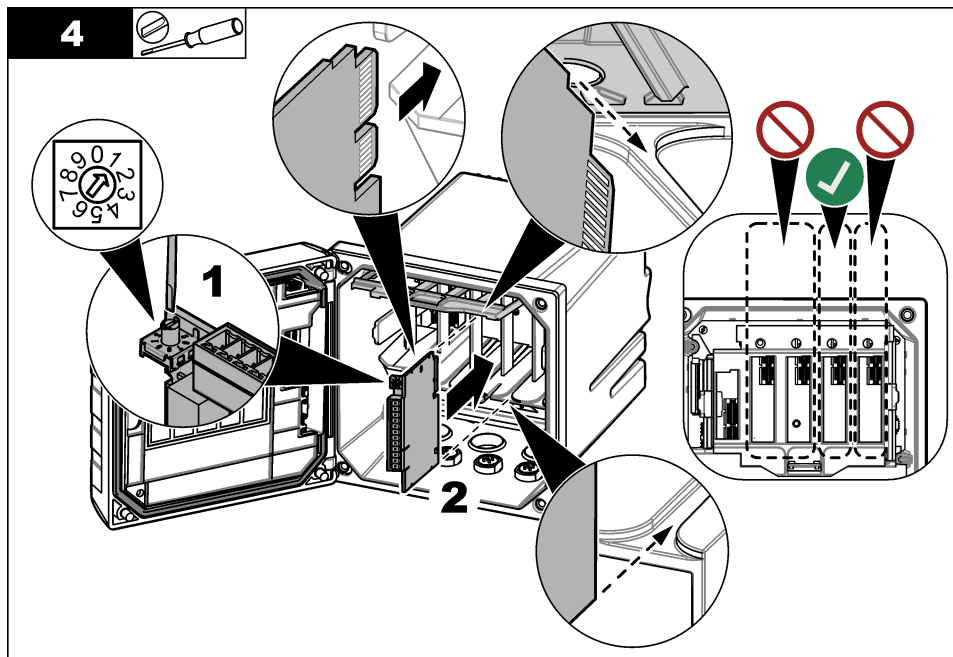




接続する検出器に合わせてモジュールの回転スイッチを設定します。表 1 を参照してください。

表 1 モジュールの構成


位置の切り替え	センサの種類
1	溶存酸素センサ
2	脱酸素剤電極

5

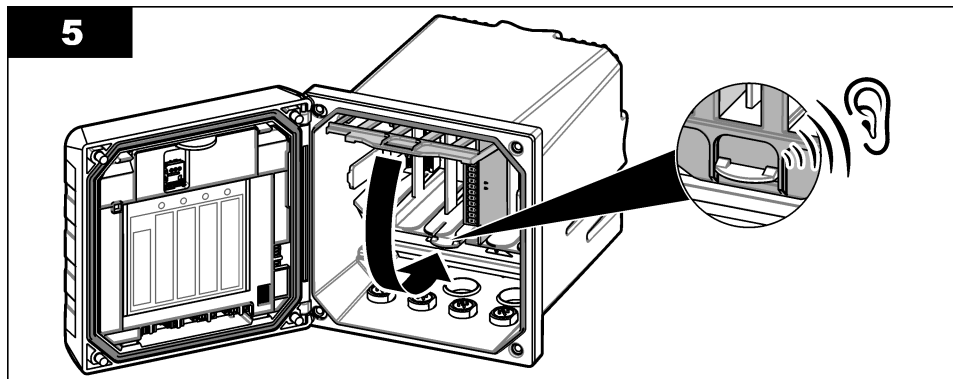

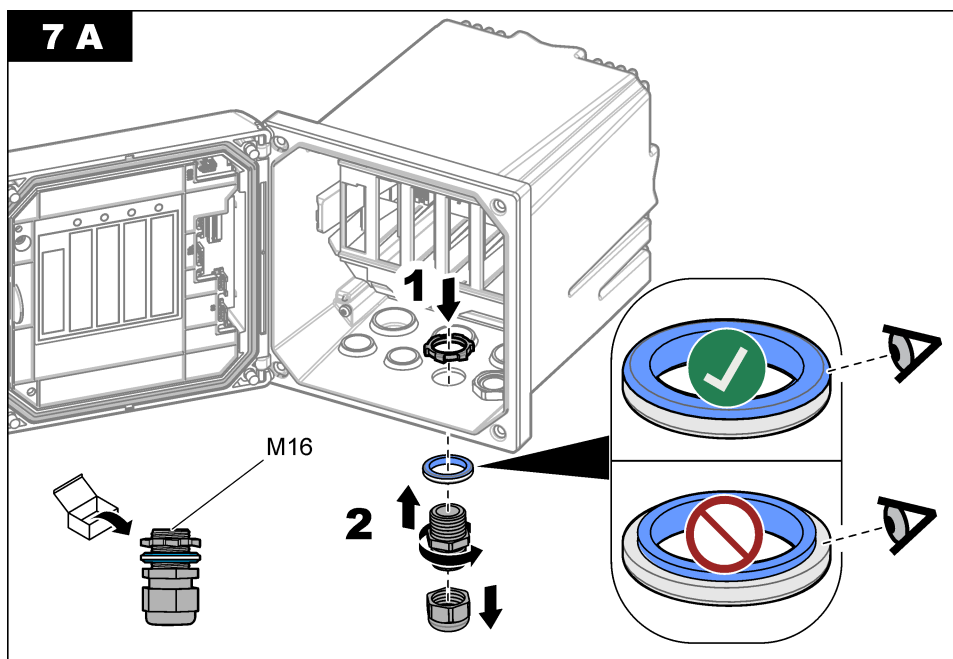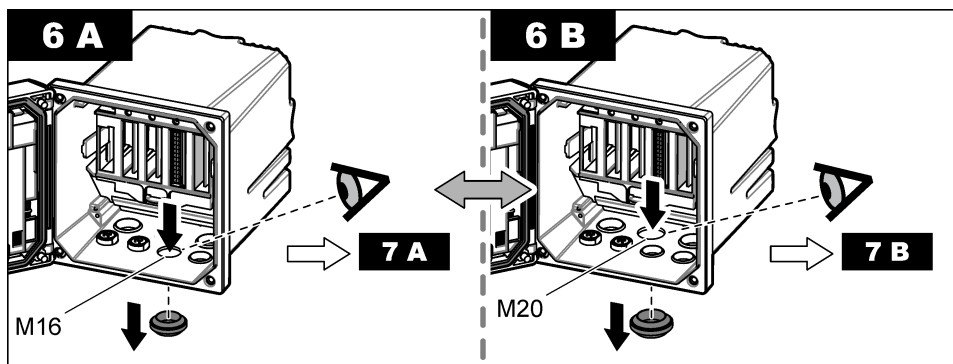

7 B

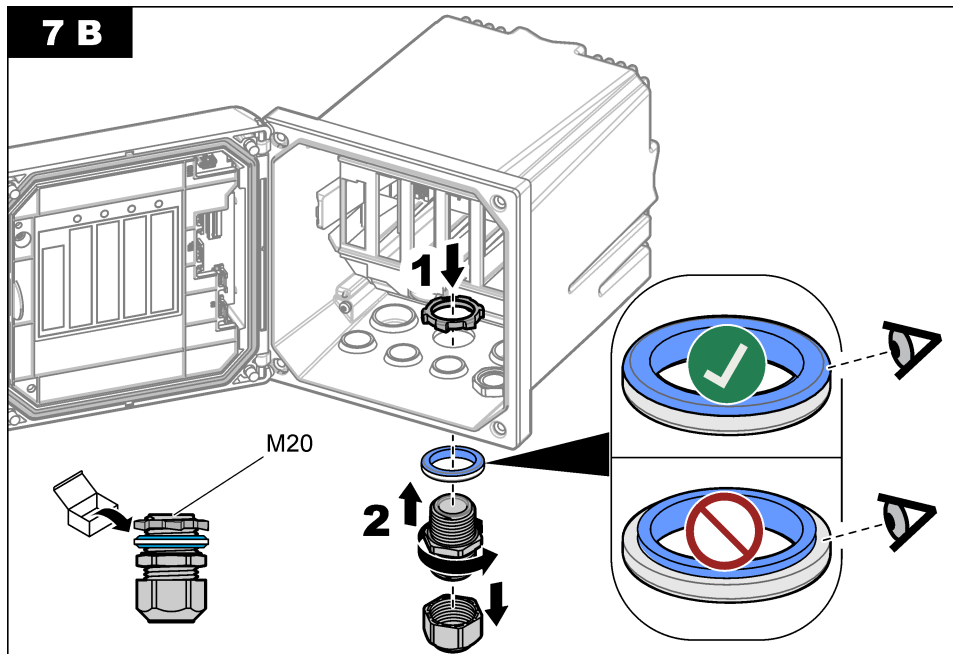

8






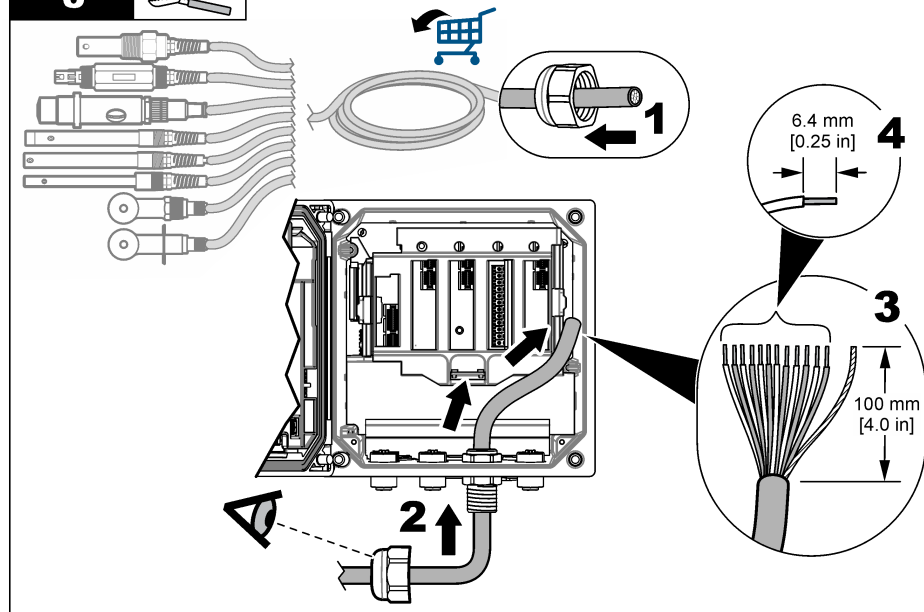


表 2 溶存酸素センサと脱酸素電極の配線


端子	説明	溶存酸素	脱酸素剤
1	温度 +	黒	黒
2	温度 -	青	青
3	—	—	—
4	—	—	—
5	アース	緑	緑
6	アース	黄	黄
7	—	—	—
8	—	—	—
9	作動中の電極	白	白
10	補助電極	赤	灰
11	—	—	透明
12	—	—	—

9

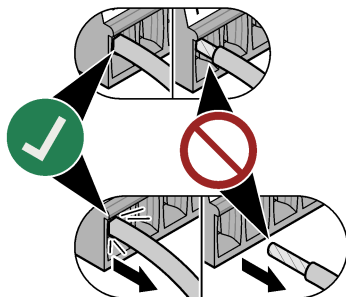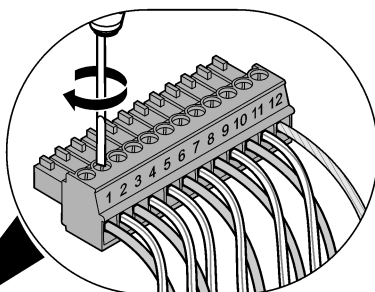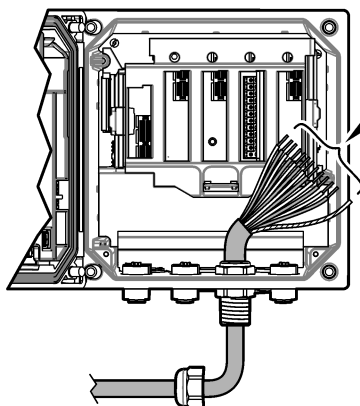

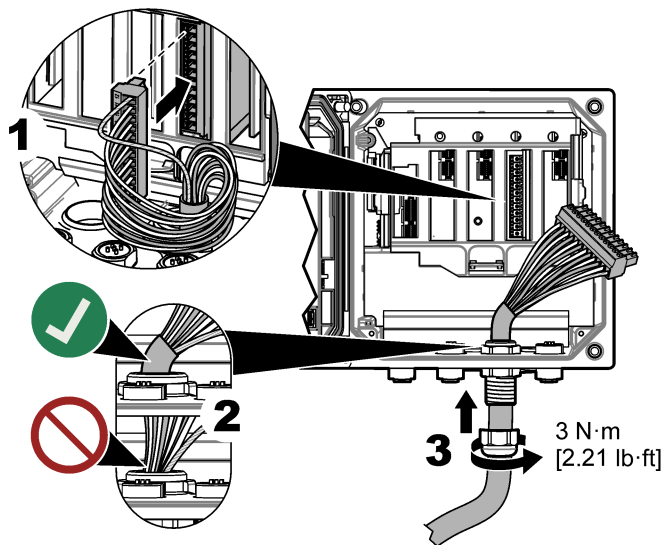

T25

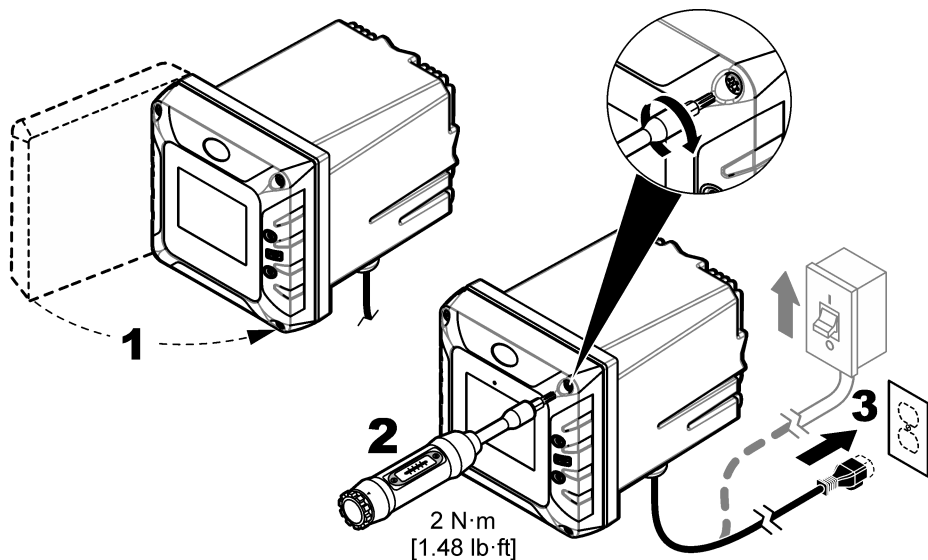

第5章 構成

手順については、装置および/またはコントローラの説明書を参照してください。

목차

1 사양 69 페이지	4 설치 71 페이지
2 일반 정보 69 페이지	5 설정 79 페이지
3 Modbus 레지스터 71 페이지	

섹션 1 사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

1.1 용존 산소 센서

사양	세부 사항
측정 범위	0~2 ppm
민감도	0.5 ppb 미만
재현성	± 0.5 ppb 또는 측정값의 ± 2% 중 더 큰 값
검출 한계	1 ppb 이하
응답 시간	1~40 ppb: 30초 미만
샘플 온도 측정 범위	0~45°C (0~113°F)

1.2 산소 제거 전극

사양	세부 사항
측정 범위	0~500 ppb 히드라진, 0~100 ppb 카보히드라자이드
민감도	< 0.2ppb
재현성	± 1 ppb 또는 측정값의 ± 2% 중 더 큰 값
검출 한계	1 ppb 이하
응답 시간	< 60초
샘플 온도 측정 범위	5~45°C(41~113°F)

섹션 2 일반 정보

어떠한 경우에도 제조업체는 제품의 부적절한 사용 또는 설명서의 지침을 준수하지 않아 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 제조업체는 본 설명서와 여기에 설명된 제품을 언제라도 통지나 추가 가격 책임 없이 변경할 수 있습니다. 개정본은 제조업체 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

2.1 안전 정보

제조사는 본 제품의 잘못된 적용 또는 잘못된 사용으로 인한 직접, 우발적 또는 간접적 손해에 국한하지 않는 모든 손해에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며, 관계 법령이 최대한 허용하는 손해에 관한 면책이 있습니다. 사용자는 사용상 중대한 위험을 인지하고 장치 오작동이 발생할 경우에 대비하여 적절한 보호 장치를 설치하여야 합니다.

장치 포장을 풀거나 설치하거나 작동하기 전에 본 설명서를 모두 읽으십시오. 모든 위험 및 주의사항 설명에 유의하시기 바랍니다. 이를 지키지 않으면 사용자가 중상을 입거나 장치가 손상될 수 있습니다.

이 장비가 제공하는 보호 기능이 손상되지 않았는지 확인하세요. 본 설명서에서 설명하는 방법이 아닌 다른 방법으로 본 장비를 사용하거나 설치하지 마십시오.

2.1.1 위험 정보 표시


▲ 위험
지키지 않을 경우 사망하거나 또는 심각한 부상을 초래하는 잠재적 위험이나 긴급한 위험 상황을 뜻합니다.
▲ 경고
피하지 않을 경우에 사망이나 심각한 부상을 유발할 수 있는 잠재적 위험이나 긴급한 위험 상황을 나타냅니다.
▲ 주의
경미하거나 심하지 않은 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 뜻합니다.
주의사항
지키지 않으면 기기에 손상을 일으킬 수 있는 상황을 나타냅니다. 특별히 강조할 필요가 있는 정보.

2.1.2 주의 라벨

본 기기에 부착된 모든 라벨 및 태그를 참조하시기 바랍니다. 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 기기 손상이 발생할 수 있습니다. 기기에 있는 기호는 주의사항에 대한 설명과 함께 설명서에서 참조합니다.

	이는 안전 경고 심볼입니다. 잠재적인 부상 위험을 방지할 수 있도록 이 기호를 따라 모든 안전 메시지를 준수하십시오. 기기에 안전 기호가 부착되어 있는 경우 작동 및 안전 정보에 대해서는 작동 설명서를 참조하십시오.
	본 심볼은 감전 및/또는 전기쇼크의 위험이 있음을 나타냅니다.
	본 심볼은 정전기 방출(ESD)에 민감한 장치가 있으므로 장치 손상을 방지하기 위해 세심한 주의가 필요함을 나타냅니다.
	이 심볼은 표시된 부품에 보호 접지를 연결해야 함을 나타냅니다. 코드의 접지 플러그로 기기에 전원 이 공급되지 않는 경우 보호 접지 단자에 보호 접지를 연결하십시오.
	이 심볼이 제품에 표시된 경우 기기가 교류에 연결되었음을 나타냅니다.
	이 심볼이 표시된 전기 장비는 유럽 내 공공 폐기 시스템에 따라 폐기할 수 없습니다.
	이 심볼이 표시된 제품은 제품에 독성 또는 유독 물질이나 요소가 포함되어 있음을 나타냅니다. 심볼 안의 숫자는 환경 보호 사용 기간(년)을 나타냅니다.

2.2 일러스트에 사용 된 아이콘

				
제조업체 공급 부품	사용자 공급 부품	보기	듣기	옵션 중 하나를 수행하십시오

2.3 제품 개요


초순수 전류 측정 모듈을 통해 SC4500 컨트롤러를 아날로그 센서에 연결할 수 있습니다. 모듈을 컨트롤러의 슬롯 3에 연결합니다.

센서의 조정과 작동은 기기 사용 설명서와 SC 컨트롤러 문서를 참조하십시오.

2.4 제품 구성품

모든 구성품을 수령했는지 확인하십시오. **그림 1**의 내용을 참조하십시오. 품목이 누락되었거나 손상된 경우에는 제조업체 또는 판매 담당자에게 즉시 연락하시기 바랍니다.

그림 1 제품 구성품

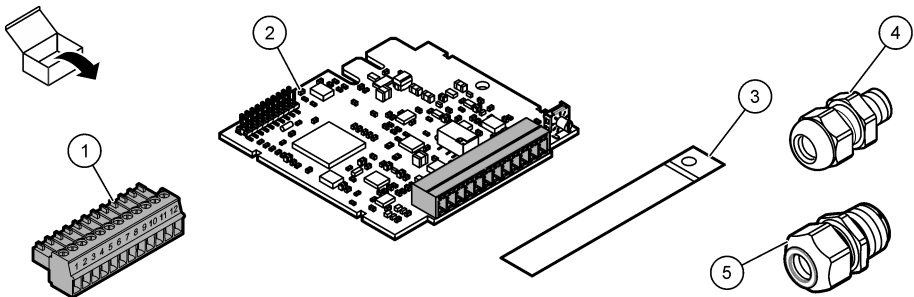

1 모듈 커넥터	3 배선 정보가 있는 라벨	5 산소 제거기 전극용 M20 케이블 글랜드
2 초순수 전류 측정 모듈	4 용존 산소 센서용 M16 케이블 글랜드	

섹션 3 Modbus 레지스터

Modbus 레지스터 목록을 네트워크 통신에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조업체의 웹 사이트를 참조하십시오.

섹션 4 설치

⚠ 위험	
	여러 가지 위험이 존재합니다. 자격을 부여받은 담당자만 본 문서에 의거하여 작업을 수행해야 합니다.

⚠ 위험



전기쇼크 위험. 이 절차를 시작하기 전에 기기에서 전원을 분리하십시오.

⚠ 위험



감전 위험. 컨트롤러의 고전압 배선은 컨트롤러의 고전압 배리어 뒤에서 수행합니다. 전문 설치 기사가 전원, 경보, 또는 릴레이의 배선을 설치 중이 아니라면 배리어를 원래 위치에 두어야 합니다.

⚠ 경고



전기쇼크 위험. 외부 연결된 장비는 해당하는 국가 안전 표준에 따라 평가를 받은 상태여야 합니다.

주의사항

장비가 규정된 지역 및 국가별 요건에 따라 기기에 연결되어야 합니다.

4.1 정전기 방전(ESD) 문제

주의사항



잠재적인 장치 손상. 정교한 내부 전자 부품이 정전기에 의해 손상되어 장치 성능이 저하되거나 고장이 날 수 있습니다.

기기의 ESD 손상을 방지하려면 이 절차의 단계를 참조하십시오.

- 기기의 새시, 금속 도관 또는 파이프 같은 어스 접지된 금속 표면을 만져 정전기를 방전시키십시오.
- 너무 많이 움직이지 마십시오. 정전기에 민감한 부품은 정전기 방지 용기나 포장재에 넣어 운반하십시오.
- 전선을 통해 접지된 손목 스트랩을 착용하십시오.
- 정전기로부터 안전한 구역에서 정전기 방지 바닥 패드와 작업대 패드를 사용하여 작업하십시오.


4.2 모듈 설치

모듈을 설치하고 센서를 연결하려면 아래의 그림 단계, [그림 2](#) 및 [표 2](#)(을)를 참조하십시오.


참고사항:

- 컨트롤러가 전류 측정 모듈과 호환되는지 확인하십시오. 기술 지원부에 문의하십시오.
- 센서 케이블의 라우팅이 높은 전자기장(예: 트랜스미터, 모터 및 스위칭 장비)에 대한 노출을 방지하도록 하십시오. 이러한 전자기장에 노출되면 부정확한 결과가 발생할 수 있습니다.
- 외함의 보호 등급을 유지하려면 사용하지 않는 모든 전기 액세스 홀이 액세스 홀 커버로 밀폐되었는지 확인하십시오.
- 기기의 보호 등급을 유지관리하려면 사용하지 않은 케이블 글랜드를 연결해야 합니다.
- 모듈을 슬롯 3에 연결합니다. [그림 2](#)의 내용을 참조하십시오. 컨트롤러에는 두 개의 아날로그 모듈 슬롯(3 및 4)이 있습니다. 아날로그 모듈 슬롯은 센서 채널에 내부적으로 연결됩니다. 아날로그 모듈과 디지털 센서가 동일한 채널에 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
참고: 컨트롤러에 센서가 두 개만 연결되어 있는지 확인하십시오. 두 개의 아날로그 모듈 포트만 사용할 수 있지만 디지털 센서 1개와 아날로그 모듈 2개를 설치하는 경우, 컨트롤러가 3개 장치 중 2개만 인식합니다.
- 제거한 디지털 커넥터는 나중에 사용할 수 있도록 보관합니다.
- 모든 센서 접지/차폐 배선을 컨트롤러 인클로저 접지 나사에 연결합니다.


참고: 센서 케이블이 너무 짧아 컨트롤러에 연결할 수 없는 경우, 연결 케이블과 정션 박스를 사용하여 거리를 연장합니다.

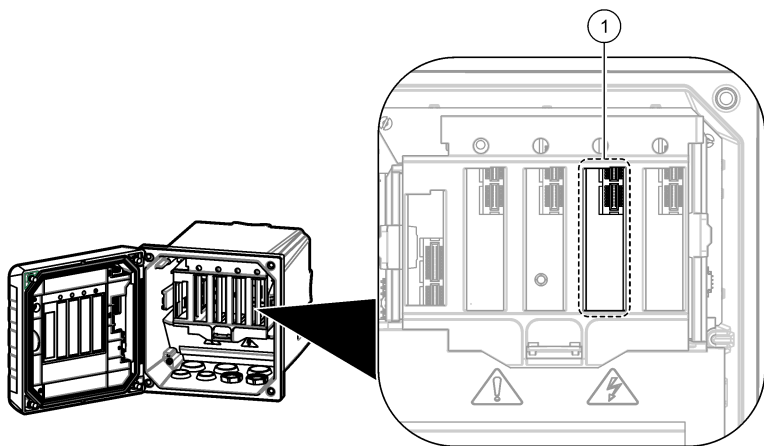


1 아날로그 모듈 슬롯—채널 1

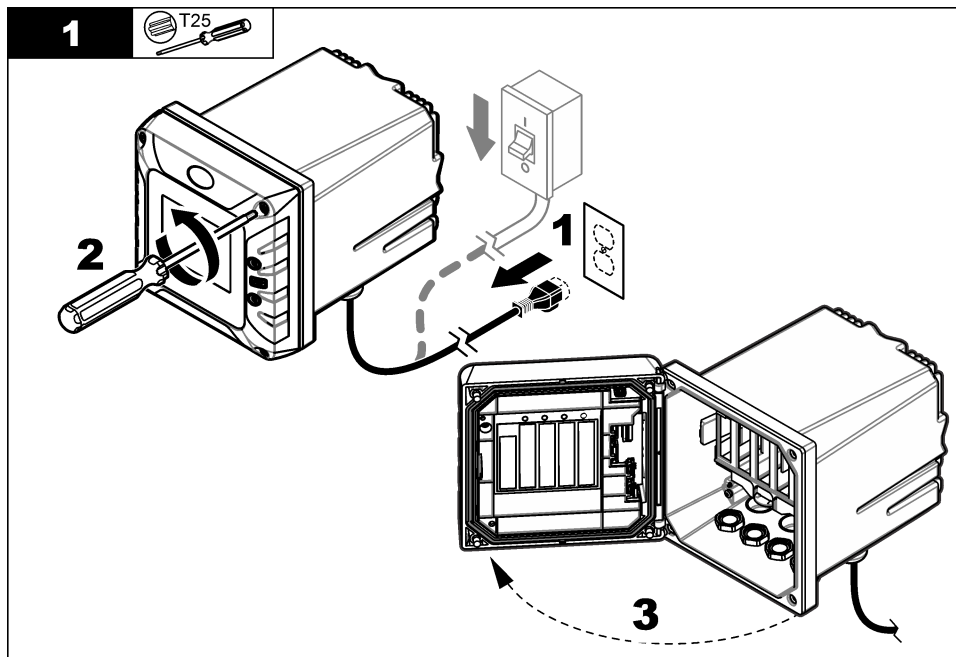


2

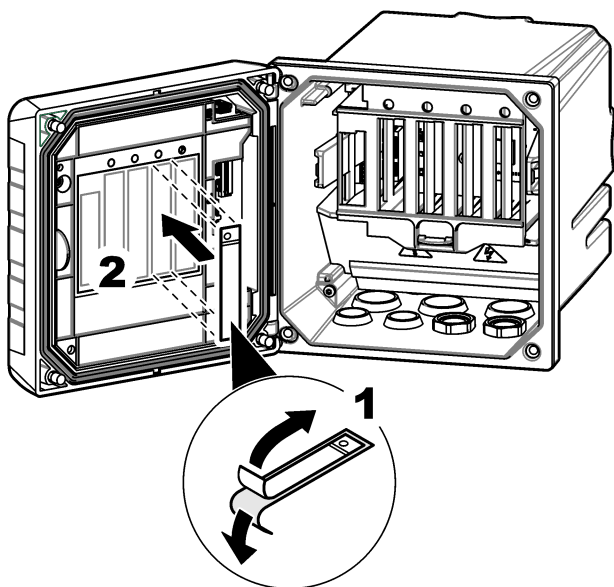

3

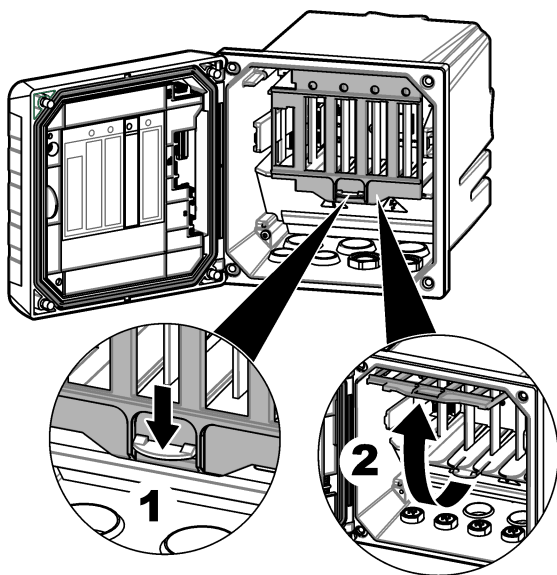



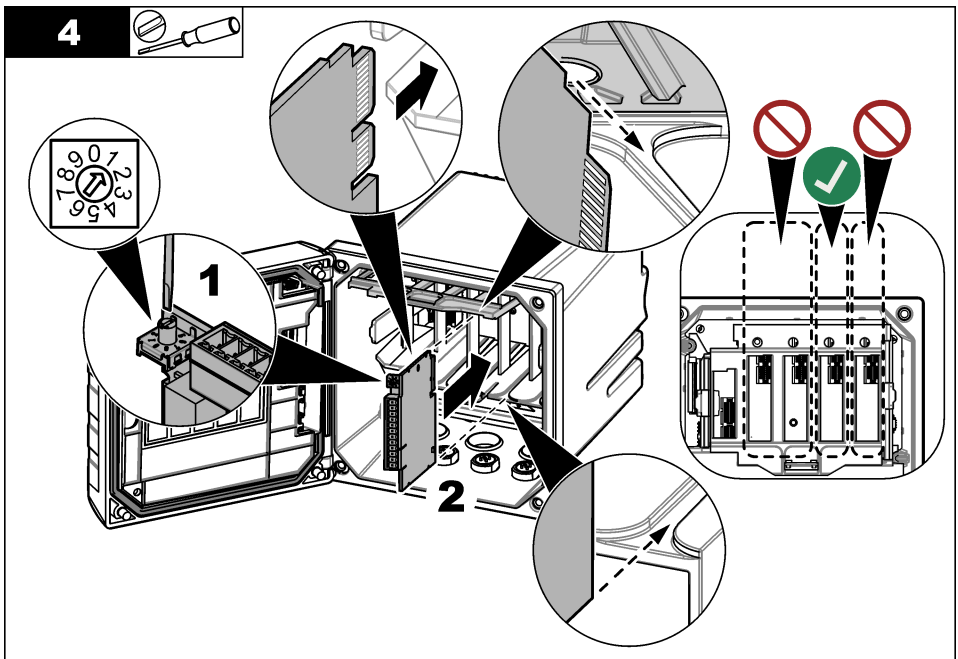


모듈의 회전식 스위치를 돌려 해당 센서의 모듈을 설정합니다. 표 1을(를) 참조하십시오.


표 1 모듈 구성

스위치 위치	센서 유형
1	용존 산소 센서
2	산소 제거 전극

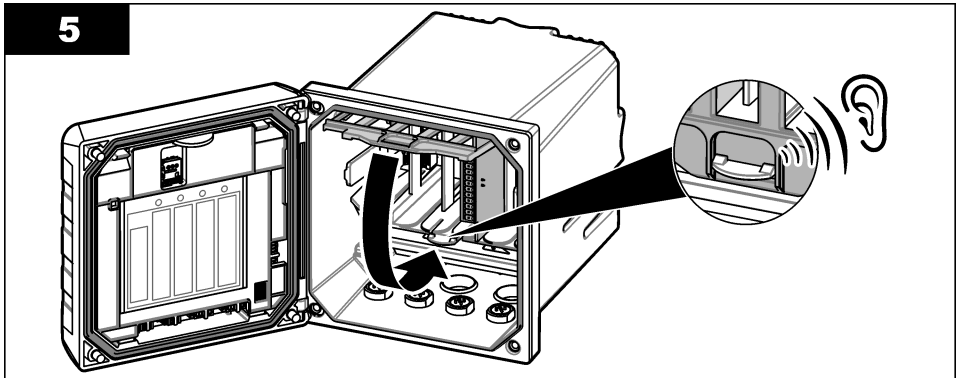

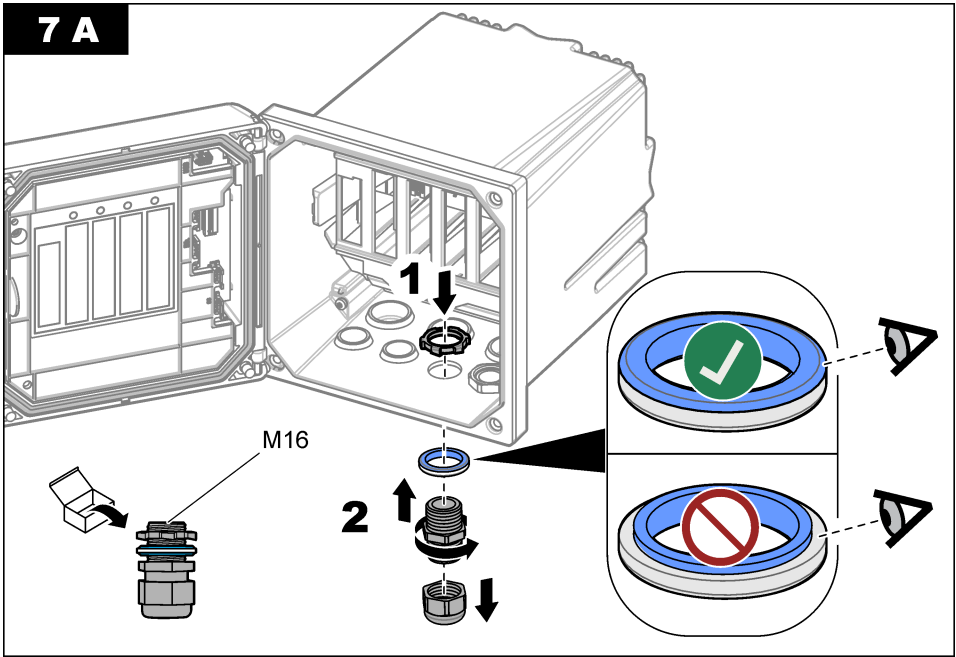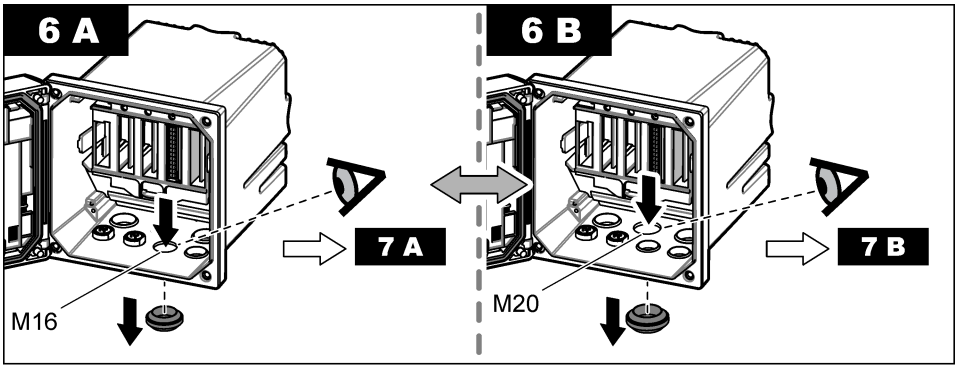

7 B

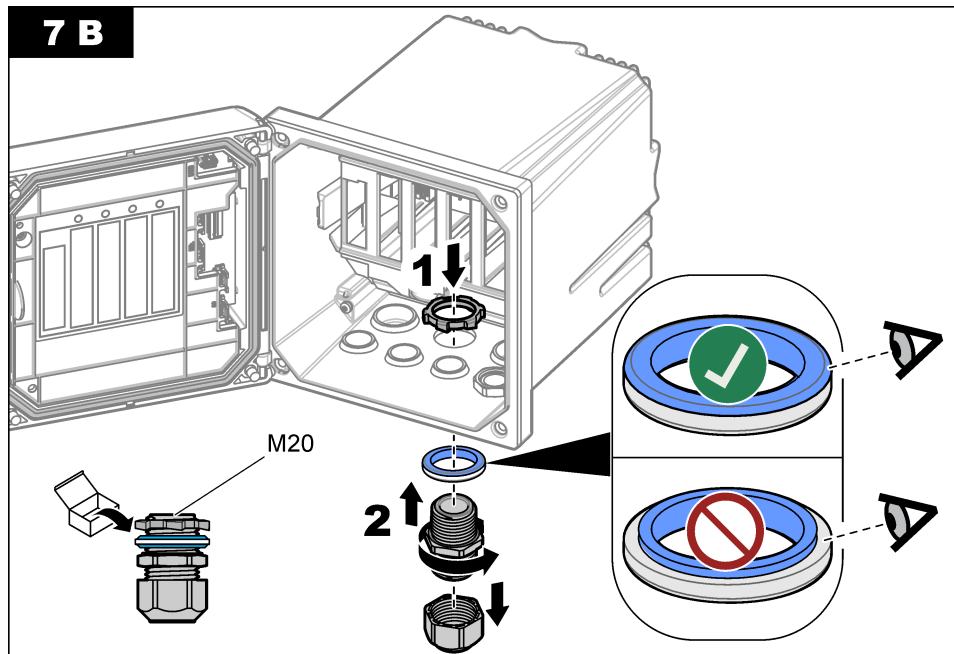

8




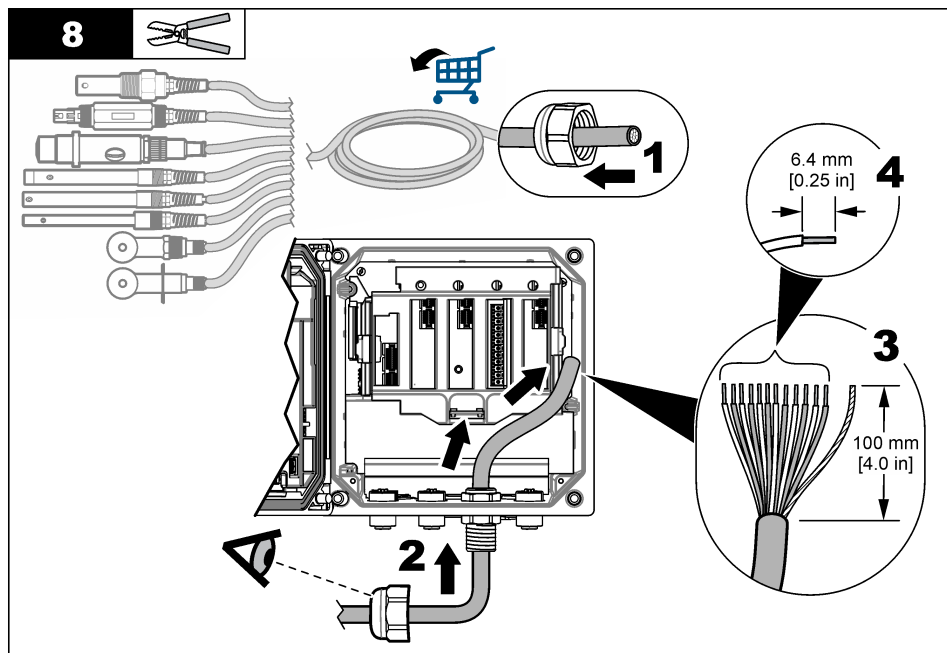



표 2 용존 산소 센서 및 산소 제거기 전극 배선

종단	설명	용존 산소	산소 제거기
1	온도 +	검은색	검은색
2	온도 -	파란색	파란색
3	—	—	—
4	—	—	—
5	접지	녹색	녹색
6	접지	노란색	노란색
7	—	—	—
8	—	—	—
9	작동 전극	흰색	흰색
10	카운터 전극	빨간색	회색
11	—	—	투명
12	—	—	—

9

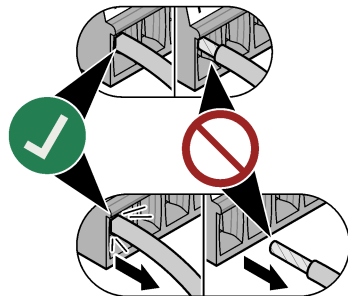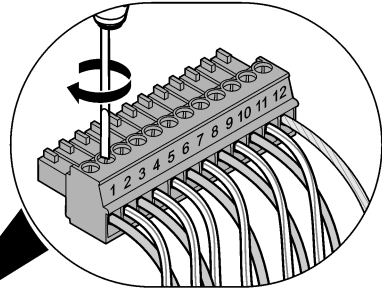
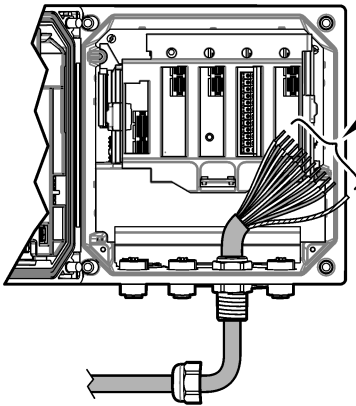


10

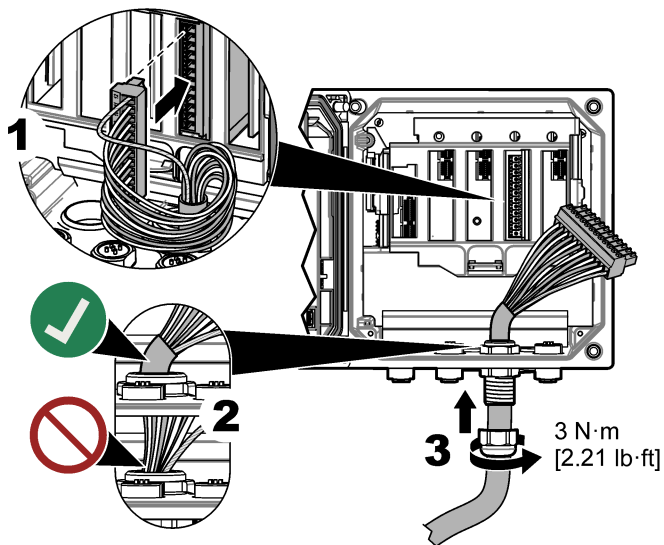

11

T25

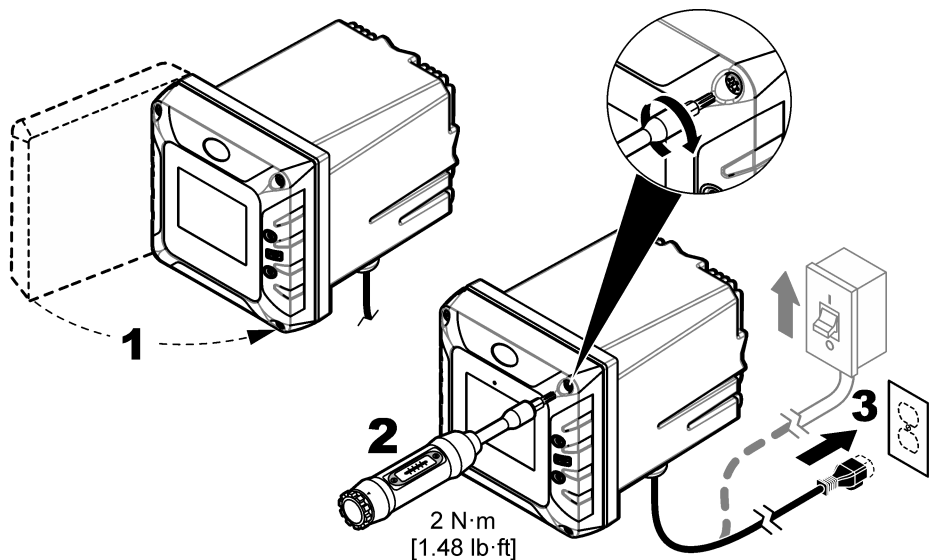

섹션 5 설정

지침은 기기 및/또는 컨트롤러 설명서를 참조하세요.

สารบัญ

- 1 รายละเอียดทางเทคนิค ในหน้า 80
- 2 ข้อมูลทั่วไป ในหน้า 80
- 3 MODBUS รีจิสเตอร์ ในหน้า 82
- 4 การติดตั้ง ในหน้า 82
- 5 การกำหนดค่า ในหน้า 90

หัวข้อที่ 1 รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.1 เซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ

รายละเอียดทางเทคนิค	รายละเอียด
ช่วงการตรวจวัด	0 ถึง 2 ppm
ความไว	< 0.5 ppb
ความสามารถในการทวนซ้ำ	การวัด ± 0.5 ppb หรือ ± 2% แล้วแต่จำนวนโดจะสูงกว่า
ค่าต่ำสุดที่ตรวจจับได้	≤ 1 ppb
เวลาในการตอบสนอง	1 ถึง 40 ppb: < 30 วินาที
ช่วงการตรวจวัดอุณหภูมิตัวอย่าง	0 ถึง 45 °C (32 ถึง 113 °F)

1.2 อิเล็กทรอนิกส์กำจัดออกซิเจน

รายละเอียดทางเทคนิค	รายละเอียด
ช่วงการตรวจวัด	ไฮดรารซิน 0 ถึง 500 ppb; คาร์โบไฮเดรไรซ์ 0 ถึง 100 พีพีบี
ความไว	< 0.2 ppb
ความสามารถในการทวนซ้ำ	1 ppb หรือ ± 2% ของการวัด แล้วแต่จำนวนโดจะมากกว่า
ค่าต่ำสุดที่ตรวจจับได้	≤ 1 ppb
เวลาในการตอบสนอง	< 60 วินาที
ช่วงการตรวจวัดอุณหภูมิตัวอย่าง	5 ถึง 45 °C (41 ถึง 113 °F)

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

ไม่ว่าจะในกรณีใด ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ ผู้ผลิตสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคู่มือและเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่อธิบายได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือข้อผูกพันใดๆ ข้อมูลฉบับแก้ไขจะมีให้บนเว็บไซต์ของผู้ผลิต

2.1 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้หรือการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรง ความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจ และความเสียหายที่ต่อเนื่องตามมา และขอปฏิเสธในการรับผิดชอบต่อความเสียหายเหล่านี้ในระดับสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการระบุถึงความเสี่ยงในการนำไปใช้งานที่สำคัญ และการติดตั้งกลไกที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกระบวนการต่างๆ ที่เป็นไปได้ในกรณีอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด

กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียดก่อนเปิดกล่อง ติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์นี้ ศึกษาอันตรายและข้อควรระวังต่าง ๆ ที่แจ้งให้ทราบให้ครบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อผู้ใช้หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการป้องกันที่ได้รับจากอุปกรณ์นี้ไม่บกพร่อง ห้ามใช้หรือติดตั้งอุปกรณ์นี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

2.1.1 การใช้ข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตราย

 อันตราย
ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้
 คำเตือน
ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้
 ข้อควรระวัง
ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง
หมายเหตุ
ข้อควรทราบระบุกรณีที่หากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายได้ ข้อมูลที่ห้องมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษ

2.1.2 ผลการระบุข้อควรระวัง

อ่านฉลากและป้ายระบุทั้งหมดที่มีมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ อาจเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ หากไม่ปฏิบัติตาม คู่มืออ้างอิงสัญลักษณ์ที่ตัวอุปกรณ์พร้อมข้อความเพื่อเสารวังเบื้องต้น

	นี่เป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อความแจ้งเพื่อความปลอดภัยที่ระบุต่อจากสัญลักษณ์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ดูคู่มือเพื่อรับทราบข้อมูลการใช้งานและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์
	สัญลักษณ์นี้ระบุว่ามีความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตและอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
	เครื่องหมายนี้แสดงว่ามีอุปกรณ์ที่ไวต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) และแสดงว่าต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ดังกล่าว
	สัญลักษณ์นี้ระบุว่ารายการที่ถูกทำเครื่องหมายนี้ต้องการการเชื่อมต่อสายดินป้องกัน หากเครื่องมือไม่มีปลั๊กสายดินที่สายไฟ โปรดเชื่อมต่อขั้วสายดินเข้ากับขั้วเหนี่ยวนำไฟฟ้าป้องกัน
	สัญลักษณ์นี้เมื่อระบุไว้ที่ผลิตภัณฑ์บ่งบอกว่าเครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าสลับ
	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่องหมายนี้ไม่สามารถทิ้งแบบขยะปกติในเขตยุโรปหรือระบบกำจัดขยะสาธารณะได้ ส่งคืนอุปกรณ์เก่าหรือที่หมดอายุการใช้งานให้กับผู้ผลิตเพื่อการกำจัด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้ใช้
	ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์มีสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือมีอันตราย หมายเลขภายในสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการใช้งานที่ป้องกันจากสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาหลายปี

2.2 สัญลักษณ์

ชั้นส่วนจัดหา โดยผู้ผลิต	ชั้นส่วนจัดหาโดยผู้ใช้	ดู	ฟัง	ทำตามตัวเลือกใด ตัวเลือกหนึ่ง

2.3 ภาพรวมผลิตภัณฑ์

โมดูลแอมแปร์โรเมตรบริสุทธิ์สูงช่วยให้แผงควบคุม SC4500 เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์อะนาล็อกได้ โมดูลจะเชื่อมต่อเข้ากับสล็อต 3 ในแผงควบคุม

สำหรับการสอบเทียบและการทำงานของเซ็นเซอร์ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์และเอกสารอ้างอิงแผงควบคุม SC

2.4 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับส่วนประกอบทั้งหมดแล้ว โปรดดูรายละเอียดใน [รูปที่ 1](#) หากพบว่าชิ้นส่วนใดสูญหายหรือชำรุด โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายขายทันที

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

1 ขั้วต่อโมดูล

2 โมดูลแอมแปร์โรเมตรบริสุทธิ์สูง

3 พริ้มแถบข้อมูลการต่อสาย

4 เกล็ดเกลนค M16 สำหรับเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ

5 เกล็ดเกลนค M20 สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ตัวจ่าย

หัวข้อที่ 3 MODBUS รีจิสเตอร์

รายการรีจิสเตอร์ Modbus สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน CD

หัวข้อที่ 4 การติดตั้ง

⚠️ อันตราย

อันตรายหลายประการ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ควรดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารส่วนนี้

⚠️ อันตราย	
	อันตรายที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้า ปลดระบบไฟฟ้าจากอุปกรณ์ก่อนเริ่มต้นขึ้นคอนนี้
⚠️ อันตราย	
	อันตรายที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้า การต่อระบบไฟแรงสูงกับคอนโทรลเลอร์จะต้องดำเนินการโดยมีแผนกกันแรงดันไฟสูงอยู่ในเคสของคอนโทรลเลอร์เท่านั้น ถ้าแกว่งจะต้องติดตั้งอยู่กับที่ ยกเว้นในกรณีที่มีช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทำการติดตั้งสายไฟ สัญญาณเตือนหรือรีเลย์ต่างๆ
⚠️ คำเตือน	
	อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากภายนอกจะต้องมีการประเมินตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของประเทศที่ใช้บังคับ
หมายเหตุ	
ต้องต่อพ่วงอุปกรณ์กับเครื่องมือตามข้อกำหนดในท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ	

4.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)

หมายเหตุ	
	กรณีที่ต้องทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่มีความบอบบาง อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากประจุไฟฟ้าสถิต ทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือการทำงานมีข้อบกพร่อง

โปรดดูขั้นตอนต่างๆ ในขั้นตอนนี้เพื่อป้องกันความเสียหายจาก ESD ที่เกิดกับเครื่องวัด:

- แตะพื้นผิวโลหะที่มีการต่อกราวด์ดิน เช่น ตัวถังของเครื่องวัด รงหรือท่อโลหะ เพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกาย
- หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายที่มากเกินไป ลำเลียงส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- สวมสายรัดข้อมือที่เชื่อมต่อกับสายกับกราวด์ดิน
- ทำงานในบริเวณที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตซึ่งมีแผ่นรองพื้นและแผ่นรองโต๊ะทำงานแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

4.2 ติดตั้งโมดูล


ติดตั้งโมดูลและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์โดยดูขั้นตอนพร้อมภาพประกอบต่อไปนี้ รูปที่ 2 และ ตาราง 2

หมายเหตุ:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงควบคุมใช้งานร่วมกับโมดูลแอมแปร์เมตรได้ ติดต่อย้ายให้บริการทางเทคนิค
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดเส้นทางของสายเซ็นเซอร์มีการป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (เช่น ตัวส่ง มอเตอร์ หรือ อุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ (Switching Equipment)) การสัมผัสกับฟิลด์เหล่านี้อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ขาดความแม่นยำ
 - เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการป้องกัน ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เข้าสู่สายไฟที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดด้วยฝาปิดรูเข้า
 - เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการป้องกันของเครื่องมือ หัวข้อสายไฟที่ไม่ได้ใช้จะต้องเสียบเอาไว้
 - เชื่อมต่อโมดูลเข้ากับสล็อต 3 โปรดดูรายละเอียดใน รูปที่ 2 แผงควบคุมมีสล็อตโมดูลอะนาล็อกสองสล็อต (3 และ 4) สล็อตโมดูลอะนาล็อกเชื่อมต่อกับภายในกับช่องเซ็นเซอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลอะนาล็อกและเซ็นเซอร์ดิจิทัลไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับช่องเดียวกัน
- บันทึก:** ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่ขงสองตัวเท่านั้นที่แผงควบคุม แม้ว่าจะมีพอร์ตอะนาล็อกสองพอร์ต แต่หากติดตั้งเซ็นเซอร์ดิจิทัลหนึ่งตัวและโมดูลสองตัว แผงควบคุมจะเห็นอุปกรณ์ได้เพียงสองจากสามตัวเท่านั้น
- เก็บขั้วต่อดิจิทัลที่ถอดออกไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายกราวด์/สายหุ้มเซ็นเซอร์ทั้งหมดเข้ากับสกรูต่อกราวด์เลขของแผงควบคุม



บันทึก: หากสายสั้นเกินไปที่จะเชื่อมต่อเข้ากับแผงควบคุม ให้ใช้สายเชื่อมต่อและกล่องต่อเพื่อขยายระยะทาง

รูปที่ 2 สล็อตโมดูลแอมแปร์โรเมตร

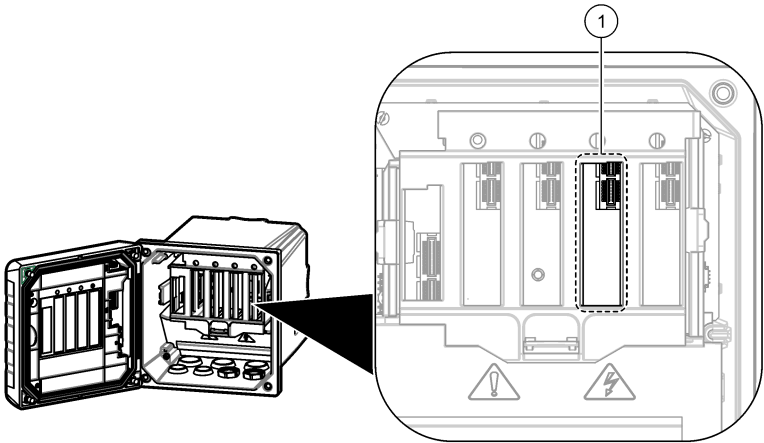


1 สล็อตโมดูลอะนาล็อก—ช่อง 1

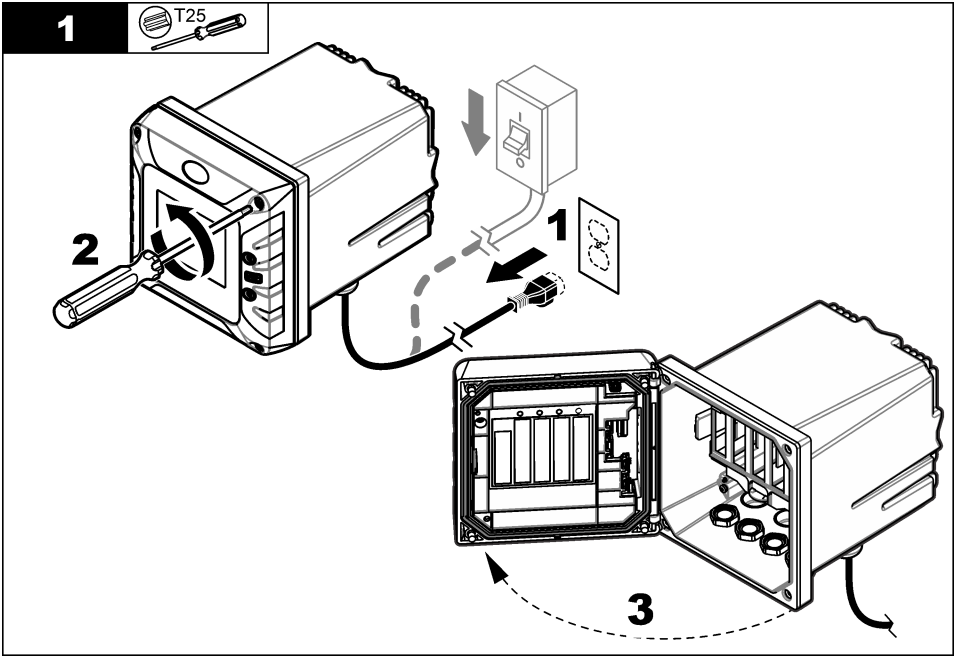

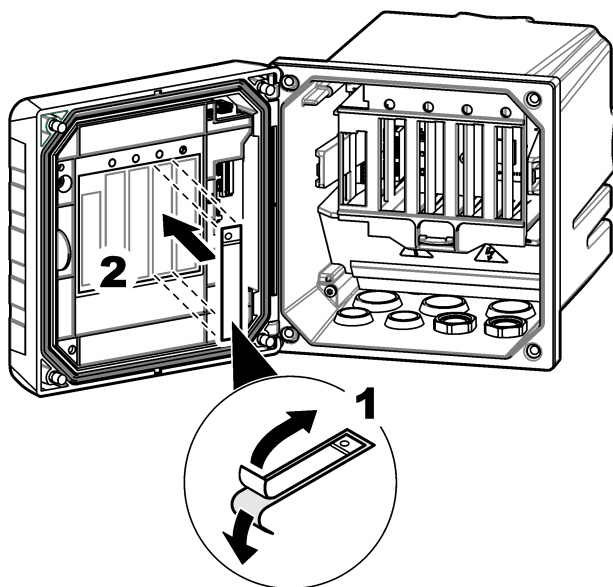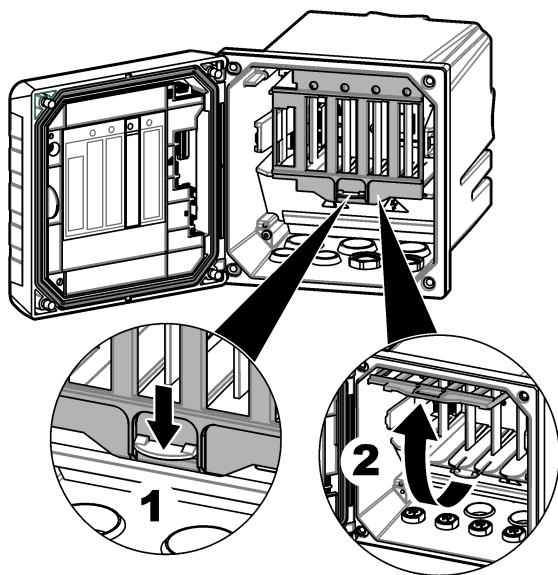2**3**

4

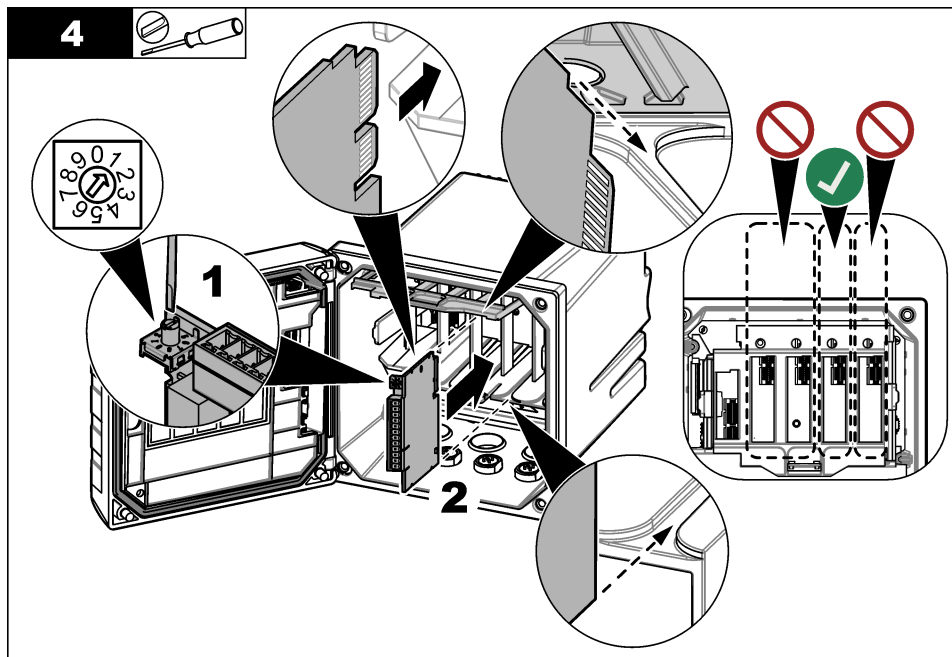




ปรับสวิตช์หมุนของโมดูลเพื่อกำหนดค่าโมดูลตามเซ็นเซอร์ที่ใช้งานได้ ดูรายละเอียดใน ตาราง 1

ตาราง 1 การกำหนดค่าโมดูล


ลำดับตำแหน่ง	ประเภทเซ็นเซอร์
1	เซ็นเซอร์ออกซิเจนหลายน้ำ
2	อิเล็กโทรดกำจัดออกซิเจน

5

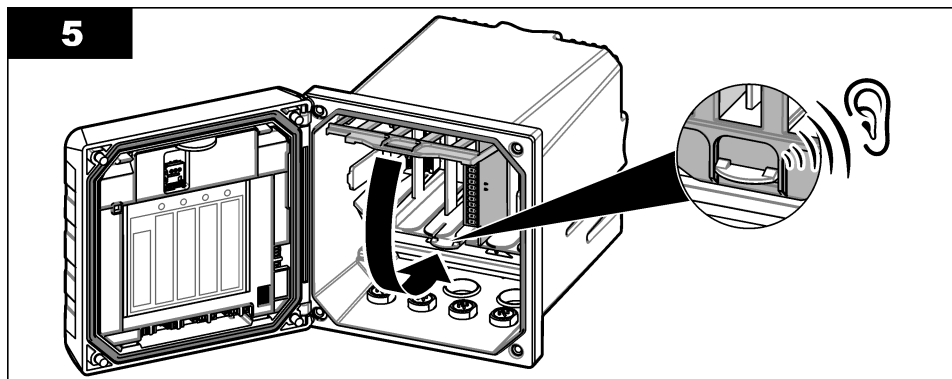


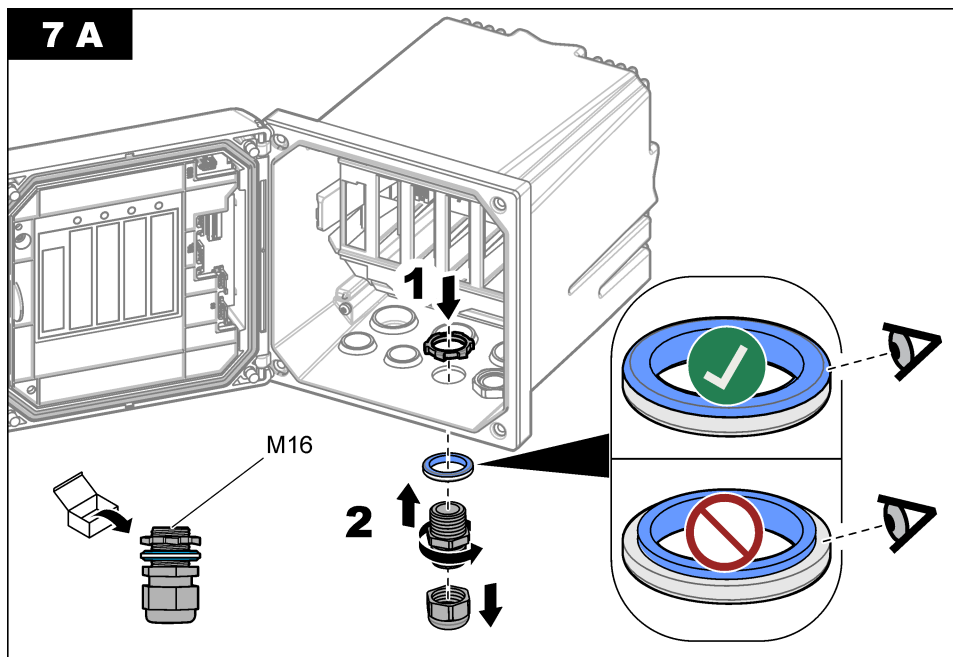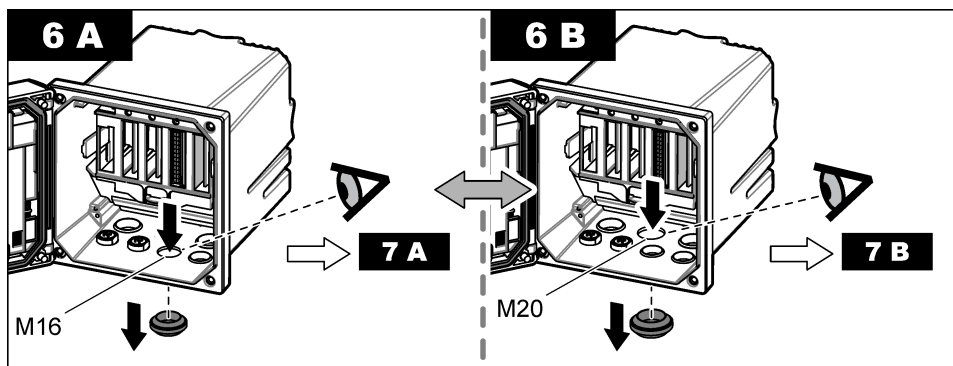

7 B

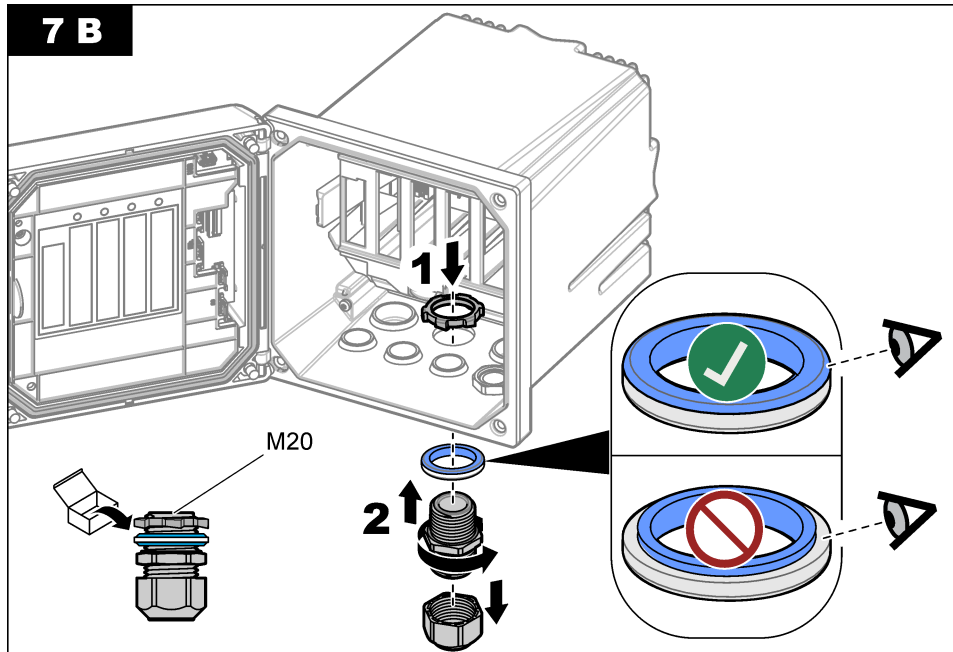



8

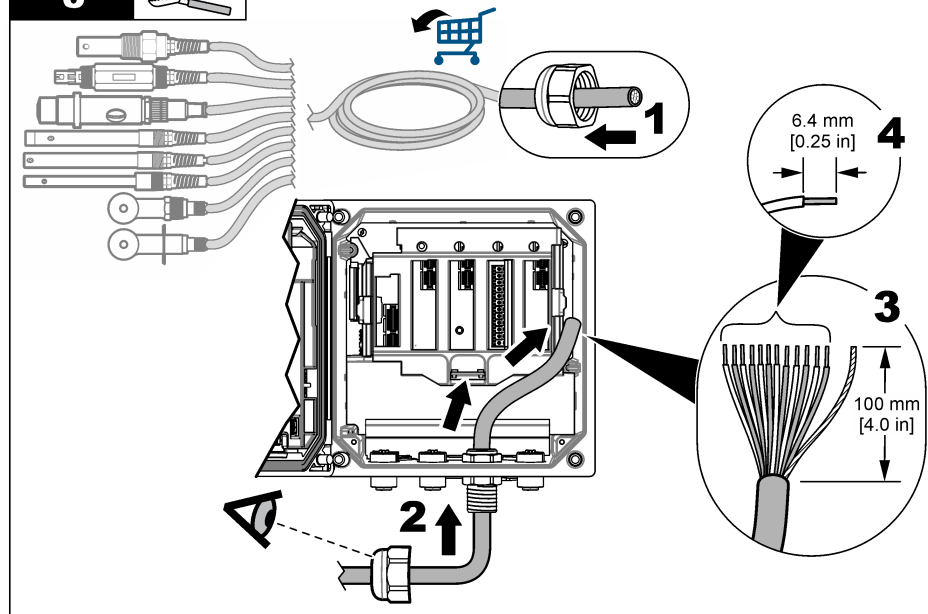

ตาราง 2 เส้นเซอร์ออกซิเจนละลายน้และสายไฟอิเล็กทรอนิกส์กับออกซิเจน

ข้อ	คำอธิบาย	ออกซิเจนละลายน้	คนเก็บขยะออกซิเจน
1	อุณหภูมิ +	สีน้ำตาล	สีน้ำตาล
2	อุณหภูมิ -	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน
3	—	—	—
4	—	—	—
5	กราวด์	สีเขียว	สีเขียว
6	สายดิน	สีเหลือง	สีเหลือง
7	—	—	—
8	—	—	—
9	เวอร์คคิงอิเล็กทรอนิกส์	สีขาว	สีขาว
10	เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์	สีแดง	สีเทา
11	—	—	โปร่งใส
12	—	—	—

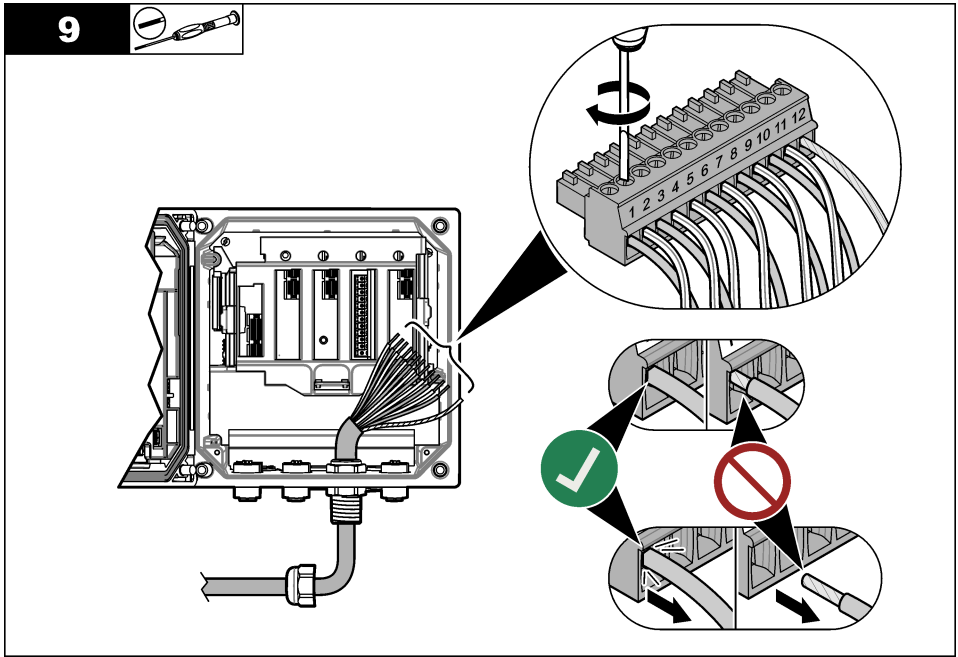

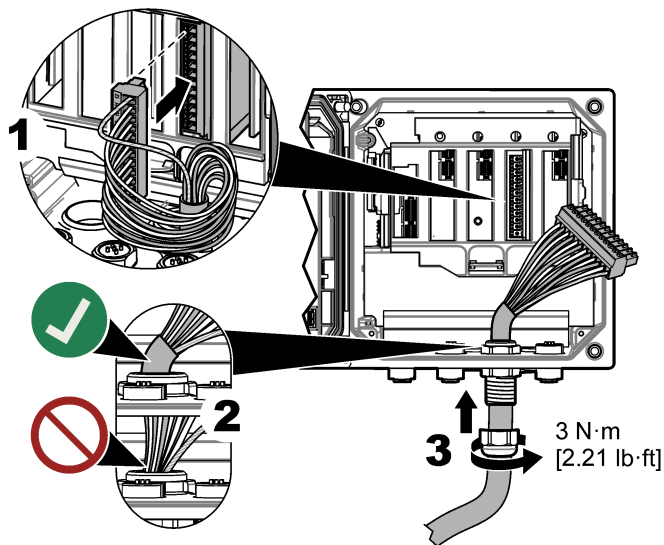

T25



หัวข้อที่ 5 การกำหนดค่า

โปรดดูคำแนะนำในเอกสารประกอบของอุปกรณ์และ/หรือตัวควบคุม

جدول المحتويات

- 1 المواصفات في صفحة 91
2 معلومات عامة في صفحة 91
3 سجلات Modbus في صفحة 93
4 التركيب في صفحة 93
5 التكوين في صفحة 101

القسم 1 المواصفات

تخضع المواصفات للتغيير من دون إخطار بذلك.

1.1 أجهزة استشعار الأكسجين المذاب

المواصفات	التفاصيل
نطاق القياس	من 0 إلى 2 جزء من المليون
الحساسية	$> 0,5$ جزء من المليار
التكرار	$\pm 0,5$ جزء من المليار أو $\pm 2\%$ من القياس، أيهما أكبر
حد الاكتشاف	≥ 1 جزء من المليار
زمن الاستجابة	من 1 إلى 40 جزءًا من المليار: > 30 ثانية
نطاق قياس درجات حرارة العينة	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)

1.2 أقطاب كاسحة الأكسجين

المواصفات	التفاصيل
نطاق القياس	0 إلى 500 جزء في البليون هيدرازين؛ 0 إلى 100 جزء في المليون كربوهيدرازيد
الحساسية	$> 0,2$ جزء من المليار
التكرار	± 1 جزء من المليار أو $\pm 2\%$ من القياس، أيهما أكبر
حد الاكتشاف	≥ 1 جزء من المليار
زمن الاستجابة	> 60 ثانية
نطاق قياس درجات حرارة العينة	5 إلى 45 درجة مئوية (41 إلى 113 درجة فهرنهايت)

القسم 2 معلومات عامة

لن تتحمل الشركة المصنعة بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أي استخدام غير لائق للمنتج أو عدم الامتثال للتعليمات الواردة في الدليل. وتحفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تغييرات على هذا الدليل والمنتجات الموضحة به في أي وقت، دون إشعار أو التزام مسبق. يمكن العثور على الإصدارات التي تمت مراجعتها على موقع الشركة المصنعة على الويب.

2.1 معلومات السلامة

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أية أضرار تنتج عن سوء استخدام هذا المنتج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة والعرضية واللاحقة، وتخلي مسؤوليتها عن مثل هذه الأضرار إلى الحد الكامل المسموح به وفق القانون المعمول به. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة عن تحديد مخاطر الاستخدام الحرجة وتركيب الآليات المناسبة لحماية العمليات أثناء أي قصور محتمل في تشغيل الجهاز. يُرجى قراءة هذا الدليل بالكامل قبل تفريغ محتويات العبوة أو إعداد هذا الجهاز أو تشغيله. انتبه جيدًا لجميع بيانات الخطر والتنبيه. فإن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى إصابة خطيرة تلحق بالمشغل أو تلف بالجهاز.

تأكد أن الحماية التي يوفرها هذا الجهاز لم تضعف. تجنب استخدام هذا الجهاز أو تركيبه بأية طريقة بخلاف الموضحة في هذا الدليل.

2.1.1 استخدام معلومات الخطر

⚠ خطر
يشير إلى موقف خطير محتمل أو وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه، فسوف يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

⚠ تحذير

يشير إلى موقف خطير محتمل أو وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه، فسوف يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

⚠ تنبيه

يشير إلى موقف خطير محتمل يمكن أن يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

إشعار

يشير إلى موقف، إذا لم يتم تجنبه، يمكن أن يؤدي إلى تلف الجهاز. معلومات تتطلب تأكيدًا خاصًا.

2.1.2 الملصقات الوقائية

اقرأ جميع الملصقات والعلامات المرفقة بالجهاز. فمن الممكن أن تحدث إصابة شخصية أو يتعرض الجهاز للتلف في حالة عدم الانتباه لها. لاحظ أن كل رمز على الجهاز يُشار إليه في الدليل من خلال بيان وقائي.

هذا هو رمز تنبيه السلامة. التزم بجميع رسائل السلامة التي تتبع هذا الرمز لتجنب الإصابة المحتملة. إذا كان موجودًا على الجهاز، فراجع دليل الإرشادات لمعرفة كيفية التشغيل أو معلومات السلامة.	
يشير هذا الرمز إلى وجود خطر يتعلق بصدمة كهربائية و/أو الوفاة بسبب صدمة كهربائية.	
يشير هذا الرمز إلى وجود أجهزة حساسة للتفريغ الإلكتروستاتيكي (ESD) كما يشير إلى أنه يجب توخي الحذر لمنع تلف الجهاز.	
يشير هذا الرمز إلى أن العنصر المميز به يتطلب توصيلاً مانعاً للتسرب الأرضي. إذا كان الجهاز غير مزود بقباس أرضي على السلك، فصل مانع التسرب الأرضي بطرف موصل الحماية.	
يشير هذا الرمز، عند ملاحظته على المنتج، إلى أن الجهاز متصل بتيار متردد.	
لا يمكن التخلص من الأجهزة الكهربائية التي تحمل هذا الرمز في الأنظمة الأوروبية للتخلص من النفايات المحلية أو العامة. لكن يتم إرجاع الجهاز القديم أو منتهى الصلاحية إلى الشركة المصنعة للتخلص منه بدون أن يتحمل المستخدم أي رسوم.	
تشير المنتجات التي تحمل هذا الرمز إلى أن المنتج يحتوي على مواد أو عناصر سامة أو خطيرة. يشير العدد الموجود داخل هذا الرمز إلى فترة استخدام الحماية البيئية بالسنوات.	

2.2 الرموز المستخدمة في الرسوم التوضيحية

قم بأحد هذه الخيارات	استماع	نظرة	القطع التي يوفرها المستخدم	القطع التي توفرها الشركة المصنعة

2.3 نظرة عامة على المنتج


تساعد وحدة مقياس التيار الكهربائي فائقة النقاء في توصيل وحدة تحكم SC4500 بجهاز استشعار تناظري. يتم توصيل الوحدة بالفتحة 3 في وحدة التحكم.

لمعايرة جهاز الاستشعار وتشغيله، يرجى مراجعة دليل مستخدم الجهاز ووثائق وحدة تحكم SC.

2.4 مكونات المنتج

تأكد من استلام جميع المكونات. راجع الشكل 1. في حال فقد أي عناصر أو تلفها، اتصل بالشركة المصنعة أو مندوب المبيعات على الفور.

الشكل 1 مكونات المنتج

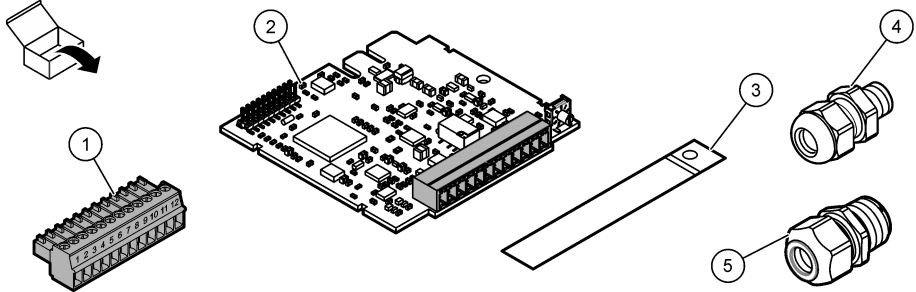

1	موصل الوحدة	3	ملصق به معلومات الأسلاك	5	غدة كابل M20 لأقطاب زبال الأكسجين
2	وحدة مقياس التيار الكهربائي فائقة النقاء	4	غدة كابل M16 لمستشعر الأكسجين المذاب		

القسم 3 سجلات Modbus

تتوفر قائمة بسجلات Modbus لاتصالات الشبكة. راجع موقع الويب للشركة المصنعة للاطلاع على مزيد من المعلومات.

القسم 4 التركيب

⚠ خطر	
مخاطر متعددة. يجب عدم إجراء المهام الموضحة في هذا القسم من المستند إلا بواسطة الموظفين المؤهلين لذلك فقط.	
⚠ خطر	
خطر الصعقات الكهربائية. افصل الطاقة عن الجهاز قبل البدء في هذا الإجراء.	
⚠ خطر	
خطر الصعقات الكهربائية. يتم توصيل أسلاك الجهد العالي الخاصة بوحدة التحكم خلف حاجز الجهد العالي في حاوية وحدة التحكم. يجب أن يظل الحاجز في مكانه ما لم يتم فني تركيب مؤهل بتركيب أسلاك الطاقة أو المنبهات أو المرحلات.	
⚠ تحذير	
خطر التعرض لصدمة كهربائية. يجب أن يشتمل الجهاز الذي يتم توصيله خارجيًا على تقييم معايير السلامة المعمول به داخل البلد.	
إشعار	
تأكد من توصيل المعدات بالجهاز وفقًا للمتطلبات المحلية والإقليمية والوطنية.	

4.1 اعتبارات التفريغ الإلكتروني الساكني (ESD)

إشعار

التلف المحتمل للجهاز. يمكن أن تتلف المكونات الإلكترونية الداخلية الحساسة بواسطة الكهرباء الساكنة؛ مما يؤدي إلى قصور في الأداء أو عطل تام.



راجع الخطوات الواردة في هذا الإجراء لمنع الضرر الناتج عن التفريغ الإلكتروني الساكني للجهاز:


- المس سطحاً معدنياً تم تفريغه من الشحنات، مثل هيكل الجهاز أو قناة أنبوب معدنية لتفريغ الكهرباء الساكنة من الجسم.
- تجنب الحركة المفرطة. انقل العناصر الحساسة للكهرباء الساكنة في حاويات أو طرود مضادة للكهرباء الساكنة.
- ارتد رباط معصم متصلاً بسلك التفريغ من الشحنات.
- اعمل في منطقة آمنة من الكهرباء الساكنة ومزودة ببطانات أرضية وبطانات طاولات عمل مضادة للكهرباء الساكنة.

4.2 تركيب الوحدة



لتركيب الوحدة وتوصيل جهاز الاستشعار، راجع الخطوات الموضحة الآتية، **الشكل 2 والجدول 2**.
ملحوظات:

- تأكد من توافق وحدة التحكم مع وحدة مقياس التيار الكهربائي. اتصل بالدعم الفني.
- تأكد من أن توجيه كابل جهاز الاستشعار يمنع التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية المرتفعة (مثل أجهزة الإرسال والمحركات ومعدات التحويل). حيث إن التعرض لهذه المجالات قد يتسبب في الحصول على نتائج غير دقيقة.
- للحفاظ على تصنيف الحاوية، تأكد من إحكام غلق جميع فتحات الوصول الكهربائية غير المستخدمة بغطاء فتحة الوصول.
- للحفاظ على تصنيف حاوية الجهاز، يجب توصيل جلب الكابلات غير المستخدمة.
- قم بتوصيل الوحدة بالفتحة 3. راجع **الشكل 2**. تحتوي وحدة التحكم على فتحتين للوحدة التناظرية (3 و 4). ويتم توصيلهما داخلياً بقناة جهاز الاستشعار. تأكد من أن الوحدة التناظرية وأداة الاستشعار الرقمية غير متصلتين بالقناة نفسها.
- **ملاحظة:** تأكد من توصيل جهازي استشعار فقط بوحدة التحكم. بالرغم من توفر منفذَي وحدتي التناظريين، فإذا تم تركيب أداة استشعار رقمية وحدتين، فلن تتم رؤية سوى جهازين من الثلاثة بواسطة جهاز التحكم.
- احتفظ بالموصل الرقمي الذي تمت إزالته لاستخدامه مستقبلاً عند الضرورة.
- تأكد من توصيل كل أسلاك تأريض/تغليف جهاز الاستشعار بمسامير تأريض وعاء وحدة التحكم.
- **ملاحظة:** إذا كان كبل جهاز الاستشعار قصيراً جداً بحيث لا يمكن توصيله بوحدة التحكم، فاستخدم كبل توصيل وعلبة توصيل لتمديد المسافة.


الشكل 2 فتحة وحدة مقياس التيار الكهربائي

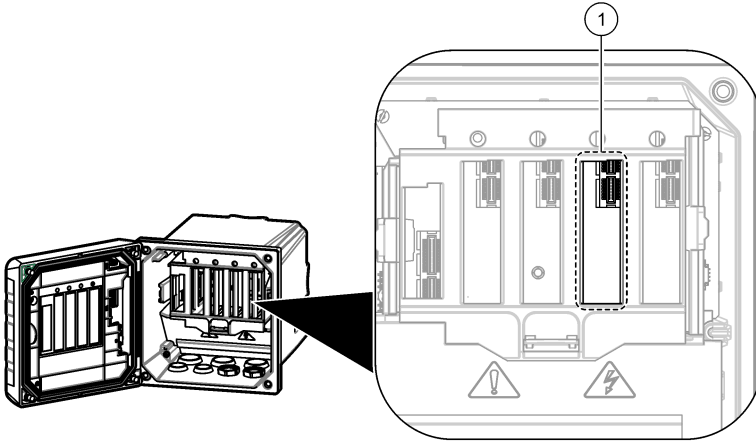


1 فتحة الوحدة التناظرية-القناة 1

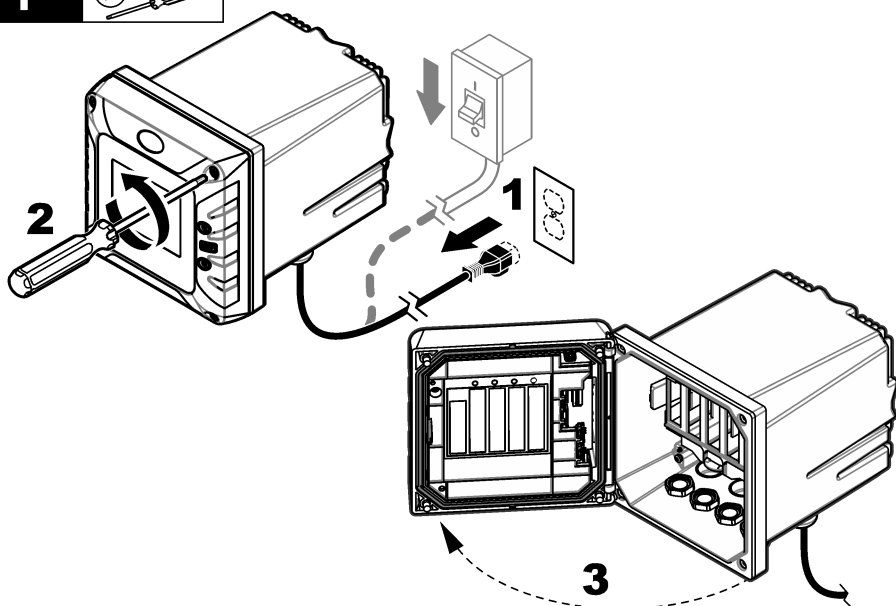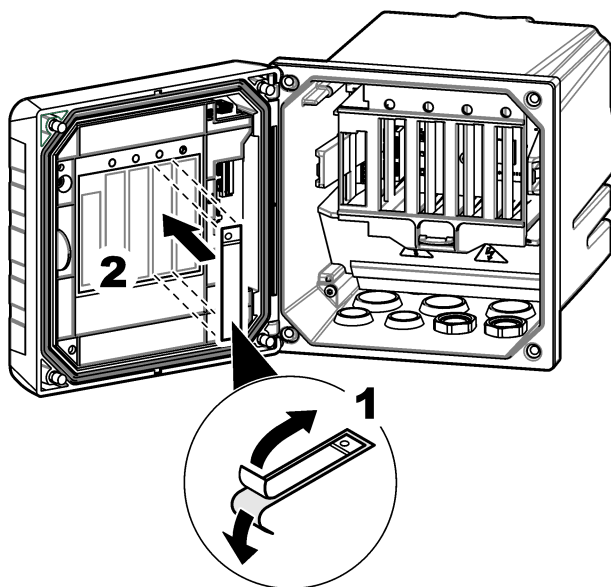1**2**

3

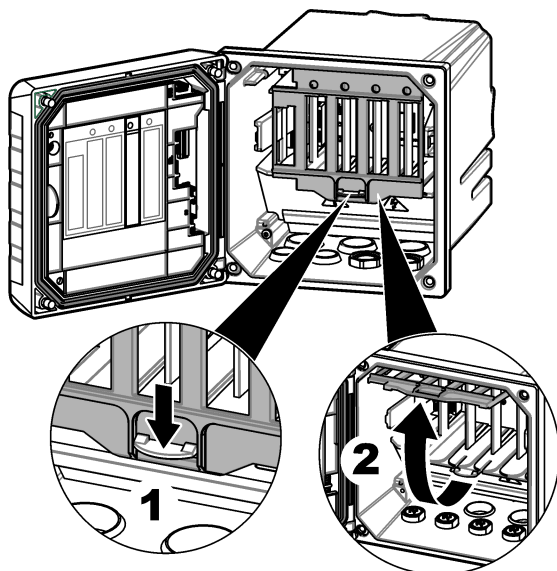



4

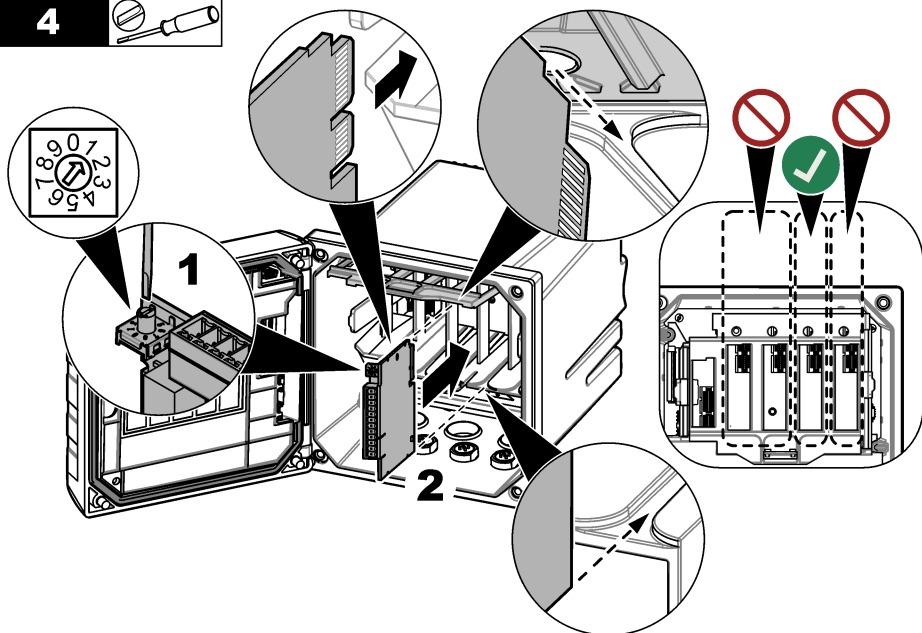


أدر المفتاح الدوار للوحدة لتكوينها استنادًا إلى جهاز الاستشعار المناسب. راجع الجدول 1.

الجدول 1 تكوين الوحدة


موضع المفتاح	نوع جهاز الاستشعار
1	مستشعر الأكسجين المذاب
2	أقطاب كاسحة الأكسجين

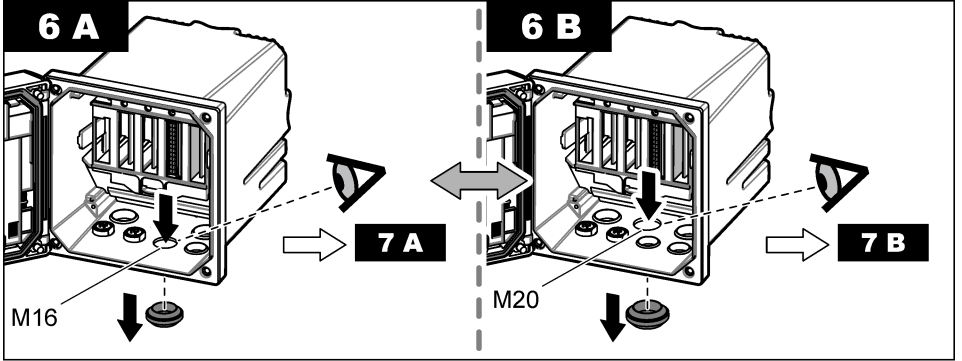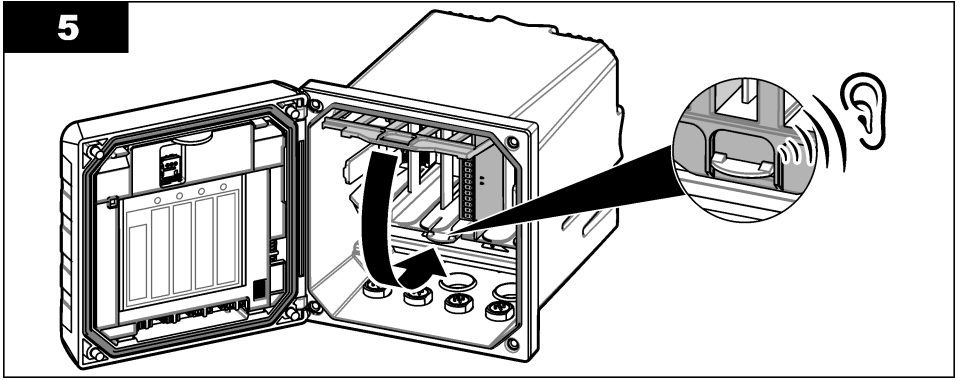


7 A

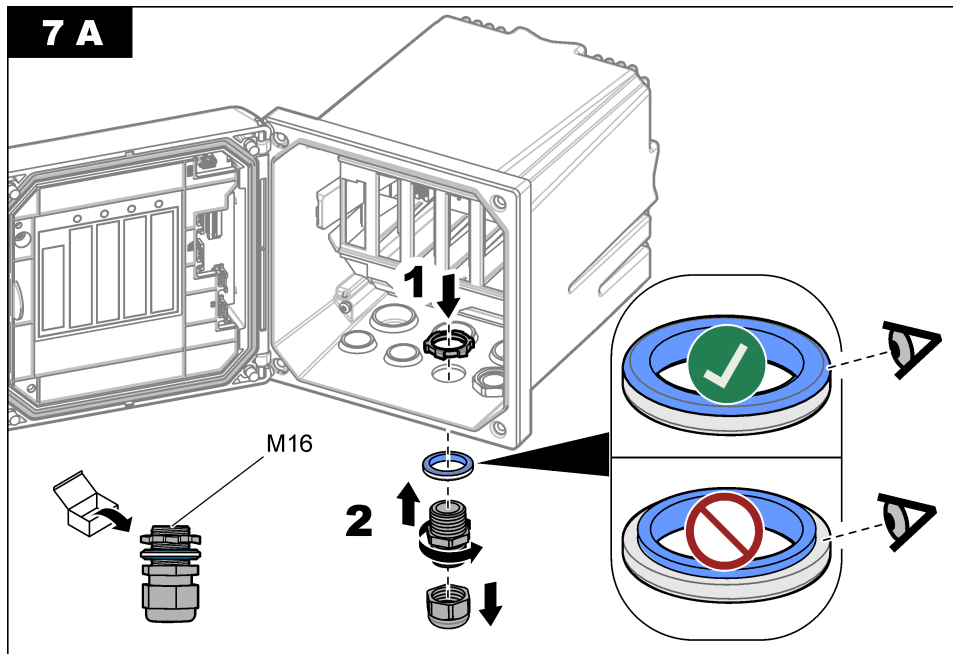

7 B


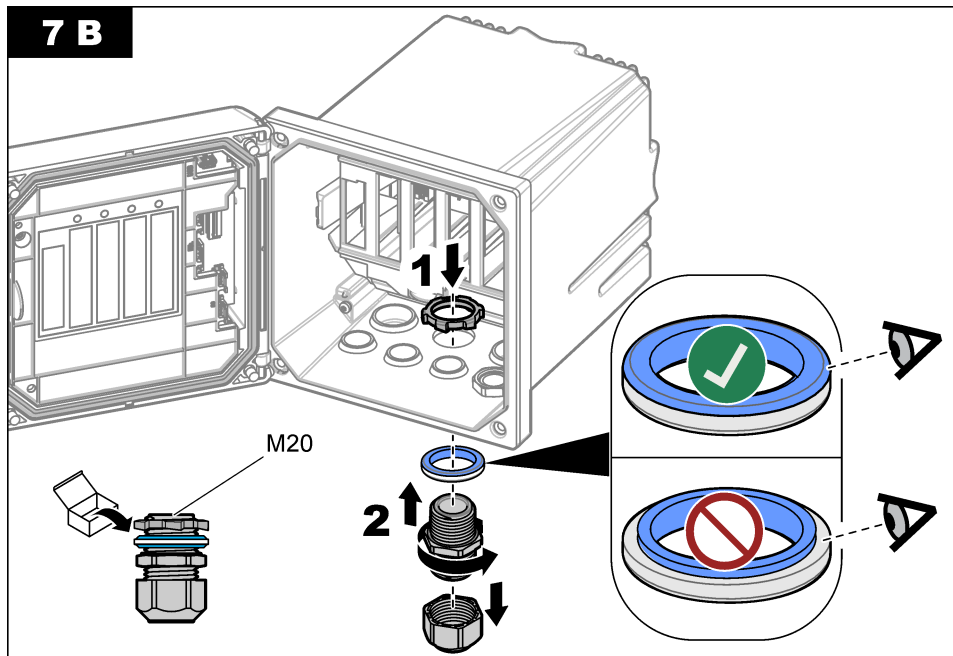


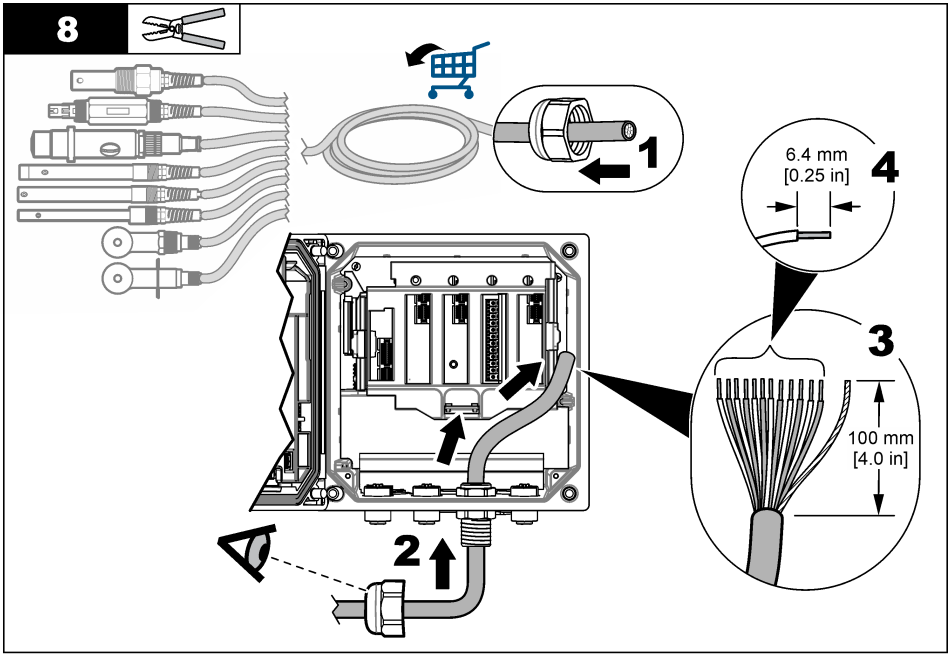


الجدول 2 مستشعر الأكسجين المذاب وأسلاك أقطاب الأكسجين

المحطة الطرفية	الوصف	الأكسجين المذاب	كاسح الأكسجين
1	درجة الحرارة +	أسود	أسود
2	درجة الحرارة -	أزرق	أزرق
3	—	—	—
4	—	—	—
5	تأريض	أخضر	أخضر
6	أرضي	أصفر	أصفر
7	—	—	—
8	—	—	—
9	قطب فاعل	أبيض	أبيض
10	قطب مساعد	أحمر	رمادي
11	—	—	شفاف
12	—	—	—

9

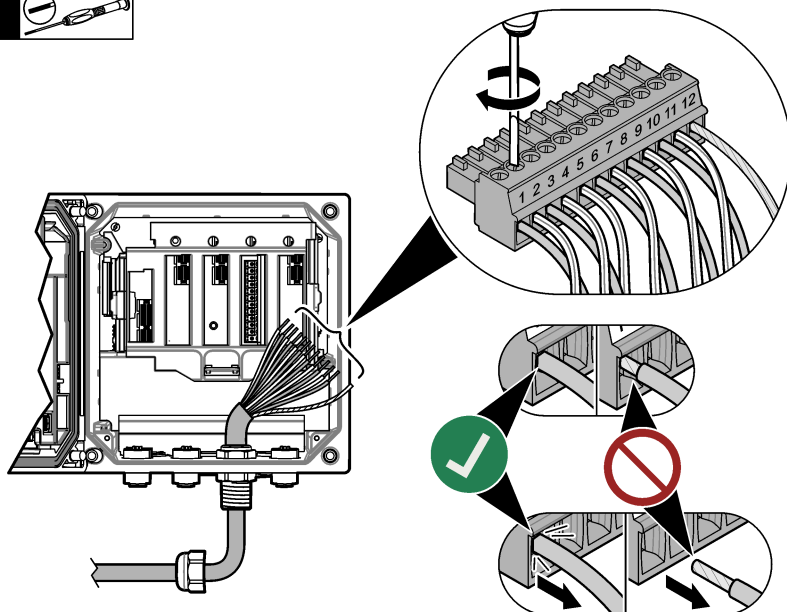


10

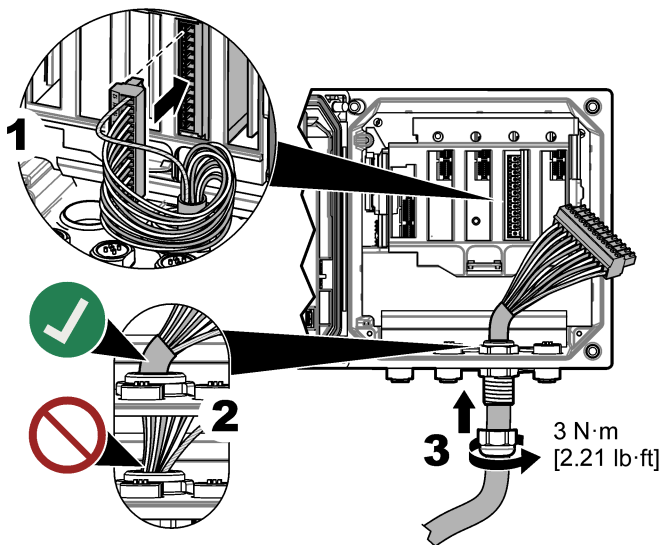

11

T25

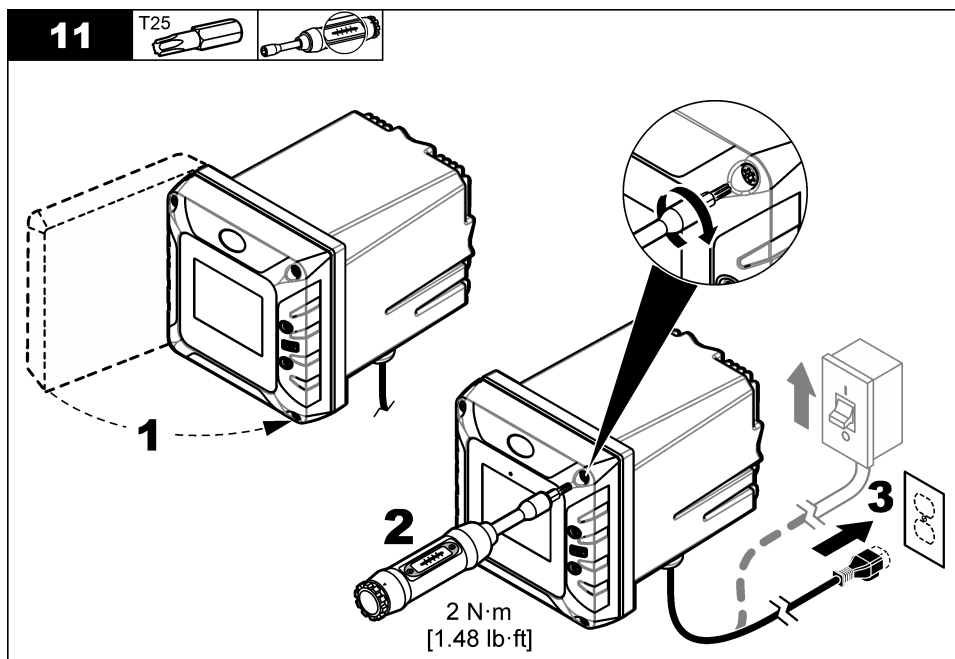

القسم 5 التكوين

راجع وثائق الأداة و/أو وحدة التحكم للحصول على التعليمات.

**HACH COMPANY World Headquarters**

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.

Tel. (970) 669-3050

(800) 227-4224 (U.S.A. only)

Fax (970) 669-2932

orders@hach.com

www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11

D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320

Fax +49 (0) 2 11 52 88-210

info-de@hach.com

www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl

6, route de Compois

1222 Vézenaz

SWITZERLAND

Tel. +41 22 594 6400

Fax +41 22 594 6499